



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021m. kovo mėn. 9 d. Nr. LS- 46 /KC-142/JS

Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, kurios registruota buveinė yra Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir UAB „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050, kurio registruota buveinė yra V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai, pirkimo Nr.488978 (toliau – Prekės) pirkti, įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.

4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su (21%) PVM yra 9 131,87 EUR (devyni tūkstančiai šimtas trisdešimt vienas EUR 87 ct), tame skaičiuje PVM 1584,87 EUR. Sutarties kaina be PVM yra 7547,00 EUR (septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR).

6. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT257044060001645641, AB SEB bankas. Kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-319, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras mokestiniu pavedimu per banką:

6.1. -ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

6.2. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

6.3. Apmokėjimo terminai gali būti pakeisti, tačiau jie negali būti ilgesni nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremaliosios situacijos paskelbimu.

7. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

9.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.

10. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

11. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

13. Tiekėjas įsipareigoja:

13.1. pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka; pristatant prekes pateikti CE sertifikatą.

13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

13.3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu

14. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

15. Vykdam Sutartį *subtiekejai nepasitelkiami*.

16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

17. Subtiekimu sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

18. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiekejo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

18.1. subtiekejas yra bankrutavęs;

18.2. subtiekejas yra likviduojamas;

18.3. subtiekejui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

18.4. subtiekejui yra iškelta bankroto byla;

18.5. subtiekejui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

18.6. subtiekejui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

18.7. subtiekejas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

18.8. subtiekejas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

18.9. subtiekejas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

18.10. subtiekejas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

18.11. kitos aplinkybės.

19. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiekejo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

19.1. subtiekejo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;

19.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant

Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiekęjas;

19.3. kitos aplinkybės.

20. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekęją ir / ar pasitelkti naują subtiekęją, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subtiekęjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekęjas privalo atitikti visus subtiekęjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekęjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiekęjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju.

21. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalis nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalis nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalis susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

22. Pirkėjas įsipareigoja:

22.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

22.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

23. Pirkėjas turi teisę:

23.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

23.2. reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

24. Tiekėjas Prekes pristato adresu: Ligoninės g.12, Alytus, savo transportu ir savo lėšomis per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo raštiško pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui.

25. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

25.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

25.2. Prekės išpakuotos;

25.3. instaliuota visa būtina techninė ir programinė įranga (*jeigu taikoma*);

25.4. įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje (*jeigu taikoma*);

25.5. perduota Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

25.6. apmokytas ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis) (*jeigu taikoma*).

25.7. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

26. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

27. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

28. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

29. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas nurodytas parduodamų prekių techninėje specifikacijoje (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2 priede).

30. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

31. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga vadybininkė Irina Sivačiova, tel. 8 5 264 9702, faks. 8 5 260 2055 el. paštas: irina.sivaciova@limeta.lt.

32. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Giedrius Maskoliūnas, inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui, tel. 8 315 56371, el. paštas: maskoliunas@ligonine.lt.

33. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų organizatorė Janina Šileikienė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių Sutartyje ar Sutarties 43 punkte numatytaame papildomame Susitarime numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą nepateikus visų ar dalies prekių Pirkėjas taikys Sutarties 35 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

35. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, vieną kartą praleistas Sutartyje (o jei buvo Šalių pasirašytas papildomas susitarimas, tai susitarime) Šalių sutartas prekių pristatymo terminas, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

36. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

37. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

38. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

39. Šalims nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

40. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

41. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

42. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutarties trukmė 12 mėn.

43. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

44. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių (gamintojas bankrutuoja, nutraukta/sustabdyta gamyba ir pan.) Tiekėjas negali laiku pristatyti Prekių, Sutarties Šalims susitarus Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėnesiui. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

45. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

46. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

47. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir esant šios sutarties 44 punkte numatytoms aplinkybėms.

48. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

49. Vykdam Sutartį, turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

50. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

51. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

52. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme.

53. Sutarties priedai:

53.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas);

53.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

PIRKĖJAS:

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/s LT737300010091752982

AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

A. V.

TIEKĖJAS:

UAB „Limeta“
V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Telefonas 8 5 264 9696; Faksas 8 5 260 2055
Įmonės kodas 221906050
PVM mokėtojo kodas LT219060515
AB SEB bankas
a/s LT257044060001645641

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

A.V.



Parduodamų prekių sąrašas

2021 m. kovo mėn. 9 d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas, modelis	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra suma EUR be PVM	Bendra suma EUR su PVM
4	Gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema	vnt.	1	Edan Instruments Inc. X12	9013,29	7449,00	9013,29
15	Odos klostės matuoklis (kaliperis)	vnt.	1	Gima 27349 FAT-2	118,58	98,00	118,58


PIRKĖJAS

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

A.V.

TIEKĖJAS

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

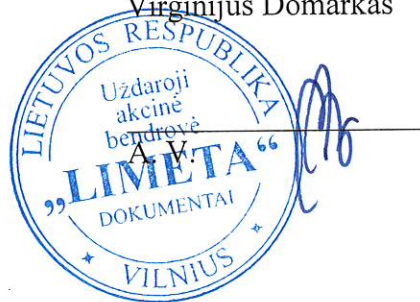

Techninė specifikacija

4 pirkimo dalis Gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema – 1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
	Gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema	1 vnt.	Modelis X12. Gamintojas Edan Instruments, Inc.
I.	Paciento monitorius	3 vnt.	3 vnt.
1.	Paciento monitoriaus paskirtis	Įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių parametų monitoravimas	Įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių parametų monitoravimas; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 1</i>
2.	Monitoriaus ekranas	Spalvotas skystųjų kristalų su sensoriniu valdymu („touch screen“), įstrižainė ≥ 30 cm	Spalvotas skystųjų kristalų su sensoriniu valdymu („touch screen“), įstrižainė 30,7 cm (12,1“). <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 154</i>
3.	Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius	≥ 12	Maksimalus vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius 13; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 154</i>
4.	Monitoruojami parametrai	1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimo dažnis 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Aritmijų/ST segmento analizė 5. SpO ₂ 6. AKS 7. Temperatūra	1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimo dažnis 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Aritmijų/ST segmento analizė 5. SpO ₂ 6. AKS 7. Temperatūra <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 157, 159, 161, 162, 163, 164</i>
5.	Naktinis ir privatus vaizdavimo režimai	Būtina	Naktinis ir privatus vaizdavimo režimai; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 20, 21</i>
6.	Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametų, hemodinaminių parametų inkstų klinikinių parametų skaičiavimas	Būtina	Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametų, hemodinaminių parametų inkstų klinikinių parametų skaičiavimas; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 115</i>
7.	Oksikardiorespirogramos vaizdavimas	Būtinai	Oksikardiorespirogramos vaizdavimas; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 54</i>
8.	Periferinių prietaisų pajungimas	1. LAN jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. USB jungtis, ne mažiau dviejų 3. Bevielio tinklo sąsaja 4. Jungtis personalo iškvietimui	1. LAN jungtis (RJ45), leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. dvi USB jungtys 3. Bevielio tinklo sąsaja 4. Jungtis personalo iškvietimui <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 129, 170, 171</i>
9.	Konstrukcija be ventiliatorių	Būtina	Konstrukcija be ventiliatorių <i>Brošiūra 1</i>
10.	Funkcijų nustatymas tiesioginio pasirinkimo	Būtina	Funkcijų nustatymas tiesioginio pasirinkimo mygtukams ekrane;

	mygtukams ekrane		<i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 18</i>
11.	Reikalavimai EKG registracijos kanalui 1. EKG kabelis 2. Signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogiau 3. Automatinis nukritusio elektrodo nustatymas 4. Stimulatoriaus detekcija 5. Aritmijų klasifikacija 6. Galimybė vaizduoti 12 derivacijų ir atlikti jų ST segmento analizę 7. ŠSD matavimo diapazonas 8. Ekstrasistolių nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 9. Diagnozės rezultatai	1. Trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis 2. 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis 3. Būtinai 4. Būtina 5. Nustatomos ≥ 30 tipų aritmijos 6. Būtina 7. Nuo 15 iki 350 k/min. 8. Nuo 0 iki 300 per minutę 9. ≥ 200	1. penkių elektrodų EKG kabelis (gali veikti ir kaip trijų laidų kabelis) 2. Signalo stiprinimo pasirinkimai 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis 3. Automatinis nukritusio elektrodo nustatymas 4. Stimulatoriaus detekcija 5. Nustatomos 32 tipų aritmijos 6. Galimybė vaizduoti 12 derivacijų ir atlikti jų ST segmento analizę 7. ŠSD matavimo diapazonas Nuo 15 iki 350 k/min. 8. Nuo 0 iki 350 per minutę 9. Diagnozės rezultatai 200 <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 69, 70, 156, 157, 158, 159, 161</i>
12.	Kvėpavimo matavimas 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Keičiamas apnėja aliarmo nustatymo intervalas	1. Nuo 0 iki 150 k/min. 2. Būtinai	1. Matavimo diapazonas nuo 0 iki 150 k/min. 2. Keičiamas apnėja aliarmo nustatymo intervalas – 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s. <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 162</i>
13.	Reikalavimai SpO2 kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Skiriamoji geba 3. ŠSD matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 4. Aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės	1. Nuo 1 iki 100 % 2. $\leq 1\%$ 3. Nuo 25 iki 300 k/min. 4. Būtina	1. Matavimo diapazonas nuo 0 iki 100% 2. Skiriamoji geba 1% 3. ŠSD matavimo diapazonas nuo 25 iki 300 k/min. 4. Aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 85, 163, 165</i>
14.	Reikalavimai AKS kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime (ne siauresnis už nurodytą)	1. Nuo 10 iki 290 mmHg 2. Nuo 1 iki 480 min. 3. ≤ 1 mmHg 4. Būtinai	1. Matavimo diapazonas 10-290 mmHg 2. Pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime nuo 1 iki 480 min. 3. Skiriamoji geba 1 mmHg 4. AKS sistemos valymo režimas <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 92, 162, 163</i>

	3. Skiriamoji geba 4. AKS sistemos valymo režimas		
15.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Kanalų skaičius 3. Diferencinės temperatūros matavimas	1. Nuo 0 iki 50°C 2. ≥ 2 3. Būtina	1. Matavimo diapazonas nuo 0 iki 50°C 2. Kanalų skaičius 2 3. Diferencinės temperatūros matavimas <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 164</i>
16.	Aliarmai asistolijos, apnėjos, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais	Būtina	Aliarmai asistolijos, apnėjos, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 31, 33</i>
17.	Duomenų atmintis	1. ≥ 240 val. tendencijų „trend“ atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele 2. ≥ 1000 AKS matavimų 3. ≥ 48 val. pilna kreivių išsklotinė 4. ≥ 200 aritmijų peržiūra	1. 240 val. tendencijų „trend“ atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele 2. 1200 AKS matavimų 3. 48 val. pilna kreivių išsklotinė 4. 200 aritmijų peržiūra <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 156</i>
18.	Maitinimo šaltiniai	1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ≥ 8 val.	1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą 8 val. <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 154, 155</i>
19.	Prie kiekvieno siūlomo monitoriaus komplektuojama	1. EKG kabelis - 1 vnt. 2. Daugkartinis pirštinis SpO2 daviklis 1 vnt. 3. Manžėčių komplektas 3 dydžių – 1 vnt. 4. Temperatūrinis daviklis odos – 1 vnt. 5. Temperatūrinis daviklis perstemplinis – 1 vnt.	1. EKG kabelis - 1 vnt. 2. Daugkartinis pirštinis SpO2 daviklis 1 vnt. 3. Manžėčių komplektas 3 dydžių – 1 vnt. 4. Temperatūrinis daviklis odos – 1 vnt. 5. Temperatūrinis daviklis perstemplinis – 1 vnt.
II.	Centrinė stebėjimo stotis	Orientacinis kiekis 1 vnt.	Centrinė stebėjimo stotis MFM-CMS central monitoring system, Edan Instruments, Inc. 1 vnt.
20.	Turi apjungti į bendrą tinklą paciento monitorius (I p.)	Galimybė plėsti iki 12 paciento stebėjimo monitorių bendrame tinkle	Apjungia į tinkle paciento monitorius (I p.) Galimybė plėsti iki 64 paciento stebėjimo monitorių bendrame tinkle <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 7</i>
21.	Stebimos kreivės	EKG, pletizmograma, kvėpavimo kreivė	EKG, pletizmograma, kvėpavimo kreivė; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 7</i>
22.	Stebimi parametrai	ŠSD, ST matavimai, ekstrasistolės, kvėpavimo dažnis, AKS matavimai, SpO2, perfuzijos indeksas, temperatūra, temperatūros skirtumas	ŠSD, ST matavimai, ekstrasistolės, kvėpavimo dažnis, AKS matavimai, SpO2, perfuzijos indeksas, temperatūra, temperatūros skirtumas <i>MFM-CMS Vartotojo vadovas psl. 7, 8</i>
23.	Monitoravimo duomenų	Viename vaizduojami visų	Viename vaizduojami visų stebimų

	vaizdavimas dviejuose monitoriuose	stebimų pacientų duomenys, kitame pasirinkto paciento	pacientų duomenys, kitame pasirinkto paciento; <i>MFM-CMS Vartotojo vadovas psl.16</i>
24.	Paciento registruojamų parametrų dinaminiai trendai	≥ 12 val.	Paciento registruojamų parametrų dinaminiai trendai 12 val. Kiekvienam pacientui <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 9</i>
25.	AKS matavimo aktyvavimas iš centrinės stebėjimo stoties	Būtina	AKS matavimo aktyvavimas iš centrinės stebėjimo stoties; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 10</i>
26.	Aliarmų ribų gyvybinams parametrų nustatymas iš centrinės stebėjimo stoties	Būtina	Aliarmų ribų gyvybinams parametrų nustatymas iš centrinės stebėjimo stoties; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 10</i>
27.	Kardiorespirogramos vaizdavimas	Būtina	Kardiorespirogramos vaizdavimas <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 33</i>
28.	Kreivių „užšaldymo“ funkcija	Būtina	Kreivių „užšaldymo“ funkcija; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 33</i>
29.	Stebimų duomenų peržiūrėjimas prisijungus prie ligoninės tinklo esančio kompiuterio	Būtina	Stebimų duomenų peržiūrėjimas prisijungus prie ligoninės tinklo esančio kompiuterio; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 63</i>
30.	Automatinis prijungto prie centrinės stebėjimo stoties paciento monitoriaus laiko sinchronizavimas	Būtina	Automatinis prijungto prie centrinės stebėjimo stoties paciento monitoriaus laiko sinchronizavimas <i>EDAN X12 vartotojo vadovas psl. 52</i>
31.	Peržiūros prieš spausdinant funkcija, spausdinamų duomenų ir kreivių pasirinkimas	Būtina	Peržiūros prieš spausdinant funkcija, spausdinamų duomenų ir kreivių pasirinkimas; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 40, 53</i>
32.	Galimybė matyti monitoravimo duomenis ir aliarmus kitame paciento monitoriuje įjungtame į tinklą	Būtina	Galimybė matyti monitoravimo duomenis ir aliarmus kitame paciento monitoriuje įjungtame į tinklą; <i>EDAN X12 Vartotojo vadovas psl. 55</i>
33.	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus tendencijų „trend“ trukmė peržiūrėjimui	≥ 240 valandų	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus tendencijų „trend“ trukmė peržiūrėjimui 240 valandų; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 9</i>
34.	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus pilna kreivių išsklotinė peržiūrėjimui	≥ 240 valandų	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus pilna kreivių išsklotinė peržiūrėjimui 240 valandų; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 9</i>
35.	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui	≥ 20000	Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui 20000; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 9</i>
36.	Visų vieno paciento monitoruojamų parametrų tendencijų ir	Būtina	Visų vieno paciento monitoruojamų parametrų tendencijų ir histogramos vaizdavimas;

	histogramos vaizdavimas		<i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 69</i>
37.	Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas	Būtina	Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas; <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 9, 10</i>
38.	Aliarmai	1. Naudotojo nustatomi; 2. Trijų lygių garsiniai ir vizualiniai aliarmai	1. Naudotojo nustatomi; 2. Trijų lygių garsiniai ir vizualiniai aliarmai <i>MFM-CMS vartotojo vadovas psl. 35, 51, 52</i>
39.	Centrinės stebėjimo stoties komplektacija	Kompiuterizuota darbo vieta - 1 vnt., klaviatūra - 1 vnt., „pelė“ - 1 vnt., lazerinis spausdintuvas - 1 vnt., LCD monitorius, įstrižainė ≥ 60 cm - 1 vnt.	Kompiuterizuota darbo vieta (kompiuteris, stalas su spintele ir kėdė) - 1 vnt., klaviatūra - 1 vnt., „pelė“ - 1 vnt., lazerinis spausdintuvas - 1 vnt., LCD monitorius, įstrižainė 60 cm (24") - 1 vnt.
40.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėnesiai

15 pirkimo dalis Odos klostės matuoklis (kaliperis) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
	Odos klostės matuoklis (kaliperis)	1 vnt.	Modelis 27349 FAT-2. Gamintojas Gima.
1.	Paskirtis	Matuoja paodinį ar riebalinį audinį bendrai kūno riebalų masei įvertinti	Matuoja paodinį ar riebalinį audinį bendrai kūno riebalų masei įvertinti <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
2.	Pagaminta iš aliuminio	Būtina	Pagaminta iš aliuminio <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
3.	Spyruokliniai spaustukai	Būtina	Spyruokliniai spaustukai <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
4.	Skalė	Ne mažiau kaip iki 60 mm	Iki 67mm <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
5.	Rankena patogiam laikymui	Būtina	Rankena patogiam laikymui <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
6.	Komplekte	Nešiojimo dėklas, instrukcija lietuvių kalba.	Nešiojimo dėklas, instrukcija lietuvių kalba. <i>Gima brošiūra, 67psl.</i>
7.	Garantinis laikotarpis	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn