

**Viešoji istaiga Jonavos pūminės sveikatos priežiūros centro
(Adresatas (Pretkančioji organizacija))**

PASŪLYMAS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMUI
2021-08-24, Nr. 558160

2021-08-24, Nr. 558160

Tieklojo pavadinimas /jeigu dalyvuoja ūkio subjektų grupė, surinkti visi dalyviai pavadinimai/ Tieklojo adresas /jeigu dalyvuoja ūkio subjektų grupė, surinkti visi dalyviai adresu/ monės kodas, PVM mokesčio kodas Aristotelionomusis steigėtojas numeris, bankas, banko kodas	VAB „Limed“ V.A. Grankinaitis g. 4, LT-02224, Vilnius Įk.: 22.96760580, PVM LN19060515 ASGLLTJ57046049001945641„ AB „SEB bankas“, banko kodas 70400 Gyvenamasis steigėtojas Virginijus Domackas Vadovaujančieji Julija Keršlinskā (8 3) 26496960 (8 3) 2620355 vilnius@limeta.lt Autra stipikienė
Aukšto lygio verticijos atitiktą vykti	EI

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirktinio sąlygomis, nustatytomis: 1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

- | Sistēmas nosaukums | Veidots | Izstrādāts | Veidots | Pasūtītijs | Pasūtītijs |
|------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| 1) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 2) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 3) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 4) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 5) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 6) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 7) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 8) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 9) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 10) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 11) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 12) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 13) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 14) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 15) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 16) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 17) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 18) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 19) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 20) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 21) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 22) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 23) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 24) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 25) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 26) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 27) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 28) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 29) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 30) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 31) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 32) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 33) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 34) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 35) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 36) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 37) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 38) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 39) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 40) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 41) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 42) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 43) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 44) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 45) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 46) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 47) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 48) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 49) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 50) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 51) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 52) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 53) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 54) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 55) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 56) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 57) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 58) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 59) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 60) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 61) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 62) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 63) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 64) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 65) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 66) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 67) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 68) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 69) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 70) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 71) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 72) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 73) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 74) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 75) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 76) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 77) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 78) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 79) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 80) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 81) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 82) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 83) sistēmas nosaukums | | | | | |
| 84) sistēmas nosaukums | | | | | |

	Aksts	Krievs	Vienots	Vienots
kopijas ir elektroniskais pieteikums pacienti ar slimību - kopjoties ir elektroniskais pieteikums pacienti ar slimību -				
Sīkumos preces visādi atitinka pirktos dokumentus turdu tās reikalavimus.				
Sīkumos šīs preces:				

[illegible]

Moje siŕiome garantuojamą išparėjŕojimų užtikrinimo pratesimà (po privalomų 24 mėn.):

Tiekėjo techninis pasiūlymas*:

Tiekėjo teisinis pasiūlymas*:	
Pirkimo dalies Nr. ir paraišymas	Tiekėjo siūloma papildoma garantija
1. Odontologinė įranga	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo patalose (1) 24 mėn

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikšlavimai

[illegible]

		2009Next Bukletas, 2 psl.
1.1.10	Kodės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojinių pedalu	Kodės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojinių pedalu Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1 2009Next Naudojimo instrukcija, 38 psl.
1.1.11	Galvos atlošo artikuliuojamas ne mažiau kaip 2 ašimis.	Galvos atlošo artikuliuojamas 3 ašimis. 2009Next Bukletas, 1 psl.
1.1.12	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampų arba nulenkiamas.	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas. 2009Next Bukletas, 2 psl.
1.1.13	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustungo galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1750 mm.	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustungo galvos atlošo bendras ilgis 1750 mm. 2009Next Naudojimo instrukcija, 33 psl.
1.1.14	Kojųgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plevę.	Kojųgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plevę. 2009Next Gamintojo patvirtinimo laiškas
1.1.15	Visos įrangos darbai reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsibimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.	Visos įrangos darbai reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsibimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.2.	Gydytojo instrumentų dalis:	Gydytojo instrumentų dalis: Modelis: Stomadent NEO Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.2.1	Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbiniui su pašvietimu; 3) rankovė mikrovirakliui su pašvietimu; 4) vieta ultragarsiniam skaleriui; 5) vieta polimerizacinei lempai	Gydytojo instrumentai: 1) 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbiniui su pašvietimu; 3) rankovė mikrovirakliui su pašvietimu; 4) vieta ultragarsiniam skaleriui; 5) vieta polimerizacinei lempai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.: Luzzani MINI MATE Naudojimo instrukcija; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2
1.2.2	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spaudyklės bloko.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spaudyklės bloko. Stomadent NEO plikats-neuotrauka
1.2.3	Instrumentų staloio aukščio reguliavimas automatiniai stabdžiai.	Instrumentų staloio aukščio reguliavimas automatiniai stabdžiai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.
1.2.4	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/jungiantis elektros, vaders ir suspausto oro maitinimą.	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/jungiantis elektros, vaders ir suspausto oro maitinimą. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1

[illegible]

instalavimui ir techninės priežiūros darbus. Pateikti gamintojo išduotos dokumentacijos (įrangos instaliavimo instrukcija, garantinis akto kopija).
serviso inžinierų apmokymo sertifikatus, pateikiama kasmetinė dokumento kopija)
4. Su įranga teiktinių paslaugų pobūdis: tiekiame savo prekėmis turimi patalynės ir baldų montavimo bei demontavimo darbus.
personala (toliau – prekių pristatymas). Tiekiame kartu su prekėmis turi pateikti perkantįjai organizacijai įrangos vartotojo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, techninę
CFR sertifikatą ar lygiavertę dokumentus.

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas	Situolimi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar lygiavercius dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą
1. Odontologinė įranga:		
1.1.	Paciento kėdė:	Paciento kėdė Modelis: 2009Next Gamintojas: Tecnodent S.r.l., Italija Stomacent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.1.1	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. 2009Next Naudojimo instrukcija, 32 psl.
1.1.2	Kėdė netvirtinama prie grindų.	Kėdė netvirtinama prie grindų. 2009Next Naudojimo instrukcija, 28 psl.; 32 psl.; 35 psl.
1.1.3	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 135 kg (paciento svoris).	Kėdės keliamoji galia – 135 kg (paciento svoris). 2009Next Naudojimo instrukcija, 33 psl.
1.1.4	Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leisti intervalu: apatinė pozicija ne aukščiau 45 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 74 cm nuo grindų	Kėdės sėdimoji dalis kyla/leidžiasi intervalu: apatinė pozicija 39,5 cm, viršutinė pozicija 84,5 cm nuo grindų. 2009Next Naudojimo instrukcija, 32 psl.
1.1.5	Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis	Kėdės valdymas elektrinis – mechaninis 2009Next Naudojimo instrukcija, 31 psl.
1.1.6	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėdę.	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėdę. 2009Next Naudojimo instrukcija, 37 psl.
1.1.7	Paciento kėdės apmušalo dangą turi būti besiūlė.	Paciento kėdės apmušalo dangą yra besiūlė. 2009Next Bukletas, 2 psl.
1.1.8	Kėdės sėdimą dalį turi būti pasukama apie vortikalią ašį ne mažiau kaip po 30° ir abi puses nuo centrinės ašies (padėties)	Kėdės sėdimą dalį pasukama apie vertikalią ašį po 30° ir abi puses nuo centrinės ašies (padėties). 2009Next Naudojimo instrukcija, 33 psl.
1.1.9	Ne mažiau 2 individualiai programuojamas paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.	3 individualiai programuojamas paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. 2009Next Naudojimo instrukcija, 38 psl.;

1.3.4	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.	Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2 Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.
1.3.5	Svaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiktai į antgalius (indo talpa 1,5 litras).	Svaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiktai į antgalius (indo talpa 1,5 litro). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 20 psl.; 36 psl.
1.3.6	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 11 psl.; 12 psl.; 13 psl.
1.3.7	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai.	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 12 psl.; 11 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.3.8	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 11 psl.
1.3.9	Integruotas į spjaudyklės bloką skysčių separatorius	Integruotas į spjaudyklės bloką skysčių separatorius Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 7 psl.
1.4	Apšvietimo sistema:	Apšvietimo sistema: Modelis: LOOK Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.4.1	Bešėlėlinis šviestuvus su ne mažiau 2 LED šviesos šaltinių	Bešėlėlinis šviestuvus su 2 LED šviesos šaltinių Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.4.2	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.4.3	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.
1.4.4	Spalvos temperatūra ne mažiau 4900 K +/- 100 K.	Spalvos temperatūra 4900 K +/- 100 K. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl.
1.4.5	Plombavimo režimas	Plombavimo režimas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.4.6	Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 25000 Lux	Maksimalus šviesos intensyvumas 35000 Lux Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; 36 psl.
1.4.7	Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90	Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90 Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1

1.7.4	Su pašvietimu	Su pašvietimu. Brošiūra, 13 psl.
1.7.5	Sterilizuojamas	Sterilizuojamas. Brošiūra, 13 psl.
1.8	Turbiniinis antgalis su pašvietimu:	Turbiniinis antgalis su pašvietimu: Modelis: HC 22 KL Gamintojas: MK-dent, Yokietija
1.8.1	Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 3 taškų	Su vandens – oro aušinimu iš 3 taškų MK-dent katalogas, 51 psl.; Patvirtinimo laiškas
1.8.2	Sūkiui: ne mažiau kaip 380.000 rpm.	Sūkiui: 420.000 rpm. MK-dent katalogas, 51 psl.
1.8.3	Maksimali galia: ne mažiau 18 W.	Maksimali galia: 18 W. MK-dent katalogas, 51 psl.
1.8.4	LED tipo pašvietimas.	LED tipo pašvietimas. MK-dent katalogas, 51 psl.
1.8.5	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį.	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį. Patvirtinimo laiškas
1.8.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas. Naudojimo instrukcija, 1 psl.
1.9	Ultragarinis skaleric:	Ultragarinis skaleric: Modelis: Compact Piezo LED Gamintojas: Mectron, Italija
1.9.1	Piezokeraminis su LED pašvietimu	Piezokeraminis su LED pašvietimu Katalogas, 54 psl.
1.9.2	Veikimo dažnis ne mažesnis ribose kaip 28 kHz – 36 kHz.	Veikimo dažnis ribose 24 kHz – 36 kHz. Katalogas, 54 psl.
1.9.3	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai.	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai. Internetinis puslapis: www.dental.mectron.com
1.9.4	Komplekte ne mažiau 4 instrumentų, instrumentų priveržimo raktas.	Komplekte 4 instrumentai, instrumentų priveržimo raktas. Katalogas, 55 psl.
1.10	Polimerizuojanti lempa:	Polimerizuojanti lempa: Modelis: Built-IN C Gamintojas: Gullin Woodpecker Medical Instrument Co., LTD, Kinija
1.10.1	Šviesos intensyvumas - ne mažiau kaip 1.200 mW/cm²;	Šviesos intensyvumas - 1.200mW/cm²;

1.2.5	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; 17 psl.
1.2.6	Gydytojo instrumentai yra įstatomi:	Gydytojo instrumentai yra įstatomi: 
1.2.7	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai.	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.
1.2.8	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija.	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.2.9	Mobilus padėklas.	Mobilus padėklas. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1 (Mobilus padėkliukas sumontuotas gydytojo instrumentų stalyje)
1.2.10	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 12 psl.; 11 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.3	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis:	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: Modelis: Stomadent NEO Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.3.1	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kėlinojasi su kėde arba kėlinojasi su kėde	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kėlinojasi su kėde Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.3.2	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis	4-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.
1.3.3	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.;

1.4.8	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; 18 psl.
1.5	Kėdutė gydytoji	Kėdutė gydytoji Modelis: DENTAL Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.5.1	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.	Laisvai stumdoma ant 5 ratukų. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL.
1.5.2	Atlošas nugarai.	Atlošas nugarai. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL.
1.5.3	Reguliuojamas kėdutės aukštis.	Reguliuojamas kėdutės aukštis. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL.
1.6	Elektrinis mikrovariklis:	Elektrinis mikrovariklis: Modelis: NLX Gamintojas: NSK, Japonija
1.6.1	Bešepetėlinis.	Bešepetėlinis. Katalogas, 90 psl.
1.6.2	Maksimalus sukimas ne mažiau 40 000 aps/min.	Maksimalus sukimas 40 000 aps/min. Katalogas, 90 psl.
1.6.3	Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm	Sūkimo momentas 4 Ncm. Katalogas, 90 psl.
1.6.4	Su vidiniu oro/vandens aušinimu.	Su vidiniu oro/vandens aušinimu. Katalogas, 90 psl.
1.6.5	Su LED šviesos šaltiniu.	Su LED šviesos šaltiniu. Katalogas, 90 psl.
1.6.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas. Katalogas, 90 psl.
1.7	Kampinis antgalis mikrovarikliui:	Kampinis antgalis mikrovarikliui: Modelis: CA 1:1 L Gamintojas: Bien-Air, Šveicarija
1.7.1	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau 3 taškų.	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš 3 taškų. Brošiūra, 5 psl.; Internetinis puslapis
1.7.2	Perdavimo santykis 1:1.	Perdavimo santykis 1:1. Brošiūra, 13 psl.
1.7.3	Gražto fiksacija mygtuku.	Gražto fiksacija mygtuku. Brošiūra, 13 psl.

		Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.2	Bangos ilgis – ne mažiau kaip diapazone 440-465 nm.	Bangos ilgis – diapazone 420-480 nm. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.3	Skaidrus šviesolaidis, ne mažiau kaip 8mm skersmens	Skaidrus šviesolaidis, 8mm skersmens. Woodpecker katalogas, 74 psl.
1.10.4	Ne mažiau kaip 2 skirtingos kietinimo programos	3 skirtingos kietinimo programos. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.5	Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis	Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.11.	Vakuuminis siurblys	Vakuuminis siurblys Modelis: UNI – JET Gamintojas: Cattani Air Technology, Italija
1.11.1	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. UNI – JET Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.2	Galingumas ne daugiau 0,5 kW	Galingumas 0,4 kW UNI – JET Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.3	Srautas ne mažiau 1200 l/min	Srautas 1250 l/min UNI – JET Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.4	Vakuomo gylys ne mažiau 1260 mm H ₂ O	Vakuomo gylys 1300 mm H ₂ O UNI – JET Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.5	Komplektuojamas garų slopinančioje dėžėje	Komplektuojamas garų slopinančioje dėžėje UNI – JET Naudojimo instrukcija, viršelis
1.11.6	Triukšmingumas ne daugiau 60 dB	Triukšmingumas 58 dB UNI – JET Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.12.	Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai	Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms 24 mėnesiai

Vykstant sumai, patikslinti šios subjektai*.

Kiti subjektai	Straipsniai (įrašyti, jei yra, straipsniai, kuriuose yra šios informacijos)	Kiti subjektai
Kiti subjektai	Straipsniai (įrašyti, jei yra, straipsniai, kuriuose yra šios informacijos)	Kiti subjektai
Kiti subjektai	Straipsniai (įrašyti, jei yra, straipsniai, kuriuose yra šios informacijos)	Kiti subjektai

*Pildyti tuomet, jei yra straipsniai, kuriuose yra šios informacijos.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įrašyti atskirai)*

/perduoti organizacijai šios informacijos negali atskirti ir pateikti asmeniškai.

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
558160

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
Odontologinė įranga
Trumpas aprašymas:
Pirkimo objektas - odontologinės įrangos 4 komplektai
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
LIAB Limeta
Gatvė ir namo numeris:
V. A. Graičiūno g. 4

Pašto kodas:

02241

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.limeta.lt

E. paštas:

vilnius@limeta.lt

Telefonas:

852649696

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Aušra Silickienė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

L219060515

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

● Taip

○ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgalųjų socialinė (monė), socialinė (monė) Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgalųjų socialinių (monių) užimtumo programas?

○ Taip

● Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas (trauktas iš oficialių patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkami „ne“

○ Taip

● Ne

Be to, užpildykite trūkstantią informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei tai reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui į gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

● Taip

○ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite: www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

○ Taip

● Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinį atstovą #1

Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamą kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojų šio pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Aušra

Pavardė

Silickienė

Gimimo data

1976-01-10

Vilnius

Gatvė ir namo numeris:

V. A. Graičiūno g. 4

Pašto kodas:

02241

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

vilnius@limeta.lt

Telefonas:

852649696

Pareigos arba statusas:

Viešųjų pirkimų specialistė

Prieinkus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (forma, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

○ Taip

● Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

Skirsnis reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas kotina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

○ Taip

● Ne

Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54), į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsiniams ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

-7-

žmonėmis formos, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pateičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

Socialinio draudimo [mokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.]

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo [mokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
○ Taip

-8-

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusizengimais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekiama iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas
○ Taip

● Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusizengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusizengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atsakomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsisteigimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

-9-

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsisteigimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsisteigimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintis) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsisteigimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
○ Taip

● Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesus konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
○ Taip

● Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkanciąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

-10-

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkanciuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skutos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų išskiepimo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis:

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindu pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėsne pateikti patvirtinamusius dokumentus, kurių reikalavo perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas;

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
○ Taip

● Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

-11-

a) jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40^o straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šlurkštų profesinį pažeidimą;

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
○ Taip
● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

● Taip

○ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tikslis ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

-12-

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atliktinamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (Interneto adresu, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai nurodant, kur padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų. Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai subinka perkančiąją organizaciją ar perkančiąjį subjektą, nurodant I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.


Data, vieta ir, jei reikia, parašas (-ai):

Data
23-08-2021
Vieta
Vilnius
Parašas

[Signature]

2009new & 2009Next

ISTRUZIONI PER L'USO
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

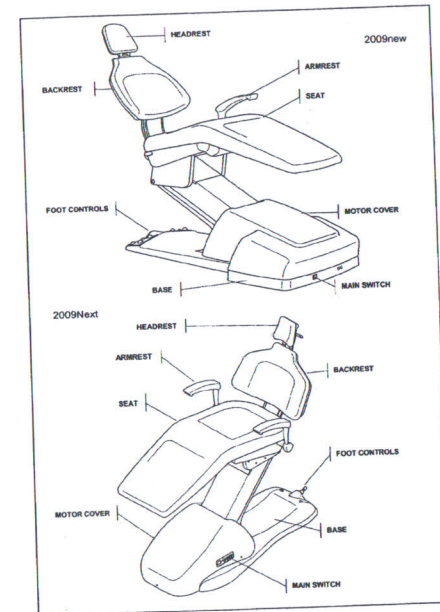

- 28 -



V.A. Giedžio g. 4 LT-02241 Vilnius, tel. 8 (7) 200 7076, faksas 8 (7) 200 7075, el. paštas: vilnius@limeta.lt
Kodas 12796255, PVM mokymo kodas: LT12796255, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Nr. 12796255

Suinteresuotiesiems skelbiama

ĮGAUJOJIMAS

2021 m. balandžio 29 d. Nr. I-0170
Vilnius

UAB „Limeta“, adresas: V.A. Giedžio g. 4, LT-02241 Vilnius, įstatinio asmens kodas 221906050, bendrovės būstinės adresas V.A. Giedžio g. 4, LT-02241 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiantis pagal bendrovės įstatus.

įgačioja

Aušra Silickienė, UAB „Limeta“ vardu pasirašyti viešųjų pirkimų dokumentus ir vėliau kitus dokumentus, pateiktus pirkimų dokumentacijoje, tvirtinti pirkimams teiktumų dokumentų nuostatas, dalykus ir afekt: vėliau kitus su viešaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

[paštas] Vilnius iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

[Signature]

Virginijus Domarkas

INDEX

1. Introduction	29
1.1. Definitions	29
1.2. General warning	29
1.3. Purpose of the information contained in this document	30
1.4. Document handling	30
1.5. Limitation of responsibility	30
1.6. Transport and storage	30
1.7. Packing disposal	30
1.8. End-of-life equipment disposal information	31
2. Equipment description	31
2.1. Intended use	31
2.2. General features	31
2.3. Warranty	32
2.4. Identification and labeling	32
2.5. Technical specifications	35
3. Installation	35
3.1. Unpacking	35
3.2. Supply status	36
3.3. Handling	36
3.4. Installation	37
4. Using the product	37
4.1. Typical use	37
4.2. Controls	38
4.3. Chair operation	41
5. Maintenance	41
5.1. General information	41
5.2. Cleaning	41
5.3. Main frame replacement	42
5.4. Upholstery replacement	42
6. Troubleshooting	43
6.1. Procedures	43
6.2. Acoustic signals	45
7. Accessories	45
7.1. Headrests	46
7.2. Armrests	46
7.3. Backrests	47
7.4. Rotation	47
7.5. Programs	47
7.6. Trendelenburg position	47
7.7. Backrest controls	47

Quaisquer alterações técnicas, alterações de design, alterações de especificações técnicas e alterações de materiais, sem aviso prévio, poderão ser feitas sem que isso afete a validade das informações aqui contidas. A TECN DENT não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido dos produtos aqui descritos.

Para obter mais informações, consulte o site: www.tecn-dent.com.br

Visto conforme data, assinatura e rubrica, em

HCFC / Be

CE
Ficha técnica
Modelo 2009new e 2009Next
versão 1.0/2010

2

MODELUS


2009new
2009Next

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



TECN DENT
ERGONOMIC INNOVATION

1

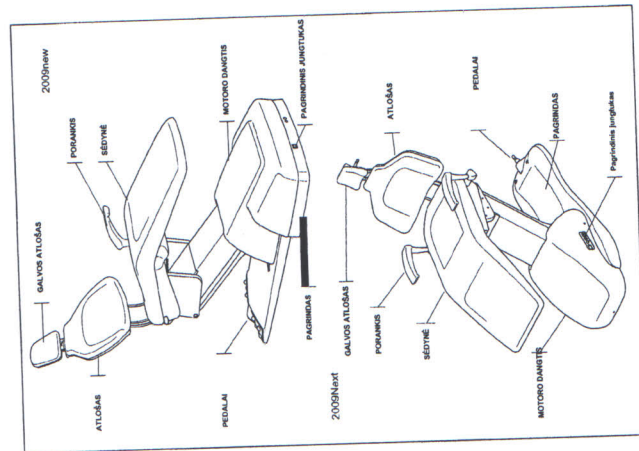

Tecnodent talio nudačinio produkto tobulinimo politiką. Tecnodent patiekia visas teises keisti technines ir estetiškes produkto charakteristikas bei kurio metu.



Tecnodent S.r.l.
Via 63^a Brigata Bolero - 24 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) - Italia
Tel. +39 051 613 11 43 - Fax +39 051 575 402 - P.IVA 02807791203
http://www.tecnodent.com - E-mail: info@tecnodent.com

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ CE Declaration of Conformity

Il fabbricante
The manufacturer

TECNODENT S.r.l.
Via 63^a Brigata Bolero, 24
40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALY

dichiara sotto la propria totale responsabilità che il seguente prodotto
declares under its own exclusive responsibility that the following product

Modello Product Name 2009new, 2009Next
Destinazione d'uso Intended use Poltrona per paziente a uso dentale Dental patient chair

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e alle prescrizioni della direttiva comunitaria
93/42/CEE sui dispositivi medici (recepiata in Italia con D.Lgs. n° 46/97 del 24/02/97) e
successive modificazioni.
Complies to the essential safety requirements and prescriptions of Medical Device Directive 93/42/EEC and
subsequent modifications.



Classe del dispositivo medico Medical device class I (art. 20, 20/93/CEE, Annex IX, rule 12)
Procedura di certificazione Certification procedure Allegato VII, Annex VII

casalecchio di Reno

IT 2009new, 11 Rev. 08 - Dichiarazione di conformità



TECNODENT S.r.l. Società Unipersonale
Via 63^a Brigata Bolero, 24
40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA
Tel. +39 051 613 11 43 - Fax +39 051 575 402
E-mail: info@tecnodent.com - E-mail: info@tecnodent.com

Casalecchio di Reno, 11 Rev. 08, 11/08/2009
P.IVA 02807791203
Dist. Prod. e Rep. Imp. di Bo N. 02807791203

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

We, company TECNODENT S.r.l., located in Casalecchio di Reno (Bologna) Italy, Via 63^a
Brigata Bolero 24, as manufacturer of dental/ medical chairs and stools we hereby authorize
our partner LIMETA Jsc. Graiciune str. 4, LT-02241 Vilnius, Lithuania (Company code:
221906050 - VAT code: LT219060505) to supply our production range and provide after sale
and warranty services on Tecnodent products in its territory of competence.

Best regards,

Casalecchio di Reno, July 21st 2020



TECNODENT S.r.l.
Via 63^a Brigata Bolero, 24
40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA
Tel. +39 051 613 11 43
Fax +39 051 575 402



Internet: <http://www.tecnodent.com>
E-mail: info@tecnodent.com
Capital social: € 100.000,00 int. vers.
P.IVA 02807791203
Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Bo N. 02807791203

We, company TECNO DENT S.r.l. located in Gussago (BS) Italy, Via S.22
Bregate Bolero 24, as manufacturer of dental/ medical chairs and stools we hereby certify
that our patient chair model 2009Next is equipped with transparent upholstery foam
protection cover daily to remove and clean.

Best regards,

TECNO DENT S.r.l.
Via S.22 Bregate Bolero 24
20090 Gussago (BS) Italy
Tel. +39 030 414131 (4)
Fax +39 030 414131 (4)
E-mail: info@tecnodent.it
Web: www.tecnodent.it





Il logo TECNO DENT

Mrs. Monica TECNO DENT S.r.l. Address: Gussago (BS) Italy, Via S.22 Bregate Bolero
24, odontologia e medicina (dentistry and medicine) profession, her firm is not a
medical 2009Next for all patients (dental and medical) chairs and stools.

Prin. 6.12.13

Model	Material	Weight	Dimensions	Features
2009Next	Stainless Steel	150 kg	1200 x 600 x 1800 mm	Adjustable, Ergonomic, Transparent Upholstery

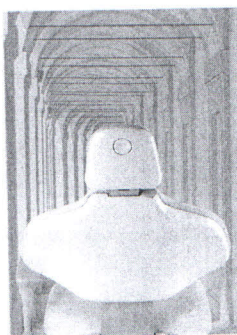
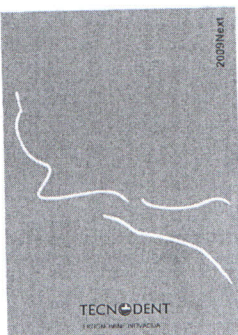


Prin. 6.12.13

Model	Material	Weight	Dimensions	Features
2009Next	Stainless Steel	150 kg	1200 x 600 x 1800 mm	Adjustable, Ergonomic, Transparent Upholstery

Prin. 6.12.13

Model	Material	Weight	Dimensions	Features
2009Next	Stainless Steel	150 kg	1200 x 600 x 1800 mm	Adjustable, Ergonomic, Transparent Upholstery

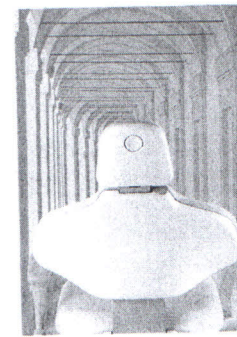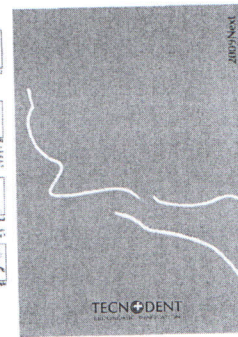

Prin. 6.12.13

Model	Material	Weight	Dimensions	Features
2009Next	Stainless Steel	150 kg	1200 x 600 x 1800 mm	Adjustable, Ergonomic, Transparent Upholstery



DENTAL UNIT STOMADENT NEO



OPERATING INSTRUCTIONS

A4D-0100-EN
2021 - 01
V1



3. DESCRIPTION OF THE PRODUCT

STOMADENT NEO dental unit is designed for use mounted on dental chair with ergonomic placed control panel. The dental unit is possible to mount on the dental chair with ergonomic placed control panel. The dental unit is possible to mount on the dental chair with ergonomic placed control panel. The dental unit is possible to mount on the dental chair with ergonomic placed control panel.

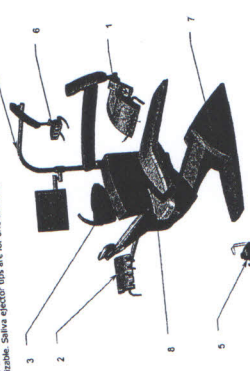


Fig. 1

1. Dentist table
2. Assistant table
3. Operating light
4. Emergency stop
5. Foot control
6. Operating light
7. Emergency stop
8. Dentist chair

Dentist table can be equipped with up to 5 or 6 instruments (all can be coded) from following options:

- 1. Syringe
- 2. max. 4 rotating instruments
- 3. max. 2 brush/brushless micro-motors
- 4. max. 2 ultrasonic scaler
- 5. 1x curing lamp
- 6. 1x ultrasonic scaler
- 7. 1x ultrasonic scaler
- 8. 1x ultrasonic scaler
- 9. 1x ultrasonic scaler
- 10. 1x ultrasonic scaler
- 11. ultrasonic scaler
- 12. ultrasonic scaler
- 13. ultrasonic scaler
- 14. ultrasonic scaler
- 15. ultrasonic scaler

The load bearing arm is fixed to the dental chair from the side. To fix the dental unit is articulated by itself. Through the rear cover door of the dental unit (21) the following segments are articulated by itself. Through the rear cover door of the dental unit (21) the following segments are articulated by itself. Through the rear cover door of the dental unit (21) the following segments are articulated by itself.

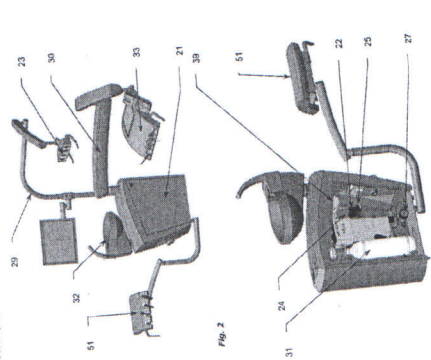


Fig. 2

Dental unit is additionally equipped by following:

- 1. Headrest
- 2. Headrest
- 3. Headrest
- 4. Headrest
- 5. Headrest
- 6. Headrest
- 7. Headrest
- 8. Headrest
- 9. Headrest
- 10. Headrest
- 11. Headrest
- 12. Headrest
- 13. Headrest
- 14. Headrest
- 15. Headrest



Fig. 3

- 1. Headrest
- 2. Headrest
- 3. Headrest
- 4. Headrest
- 5. Headrest
- 6. Headrest
- 7. Headrest
- 8. Headrest
- 9. Headrest
- 10. Headrest
- 11. Headrest
- 12. Headrest
- 13. Headrest
- 14. Headrest
- 15. Headrest

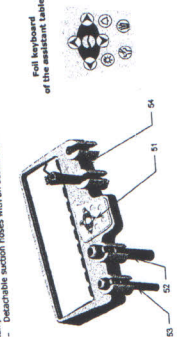


Fig. 4

Foot board of the assistant table

Automatic control. The chair positions can be programmed and stored in the memory, see chapter 4.2. The chair will move automatically into the programmed position. The chair will move automatically into the programmed position. The chair will move automatically into the programmed position.

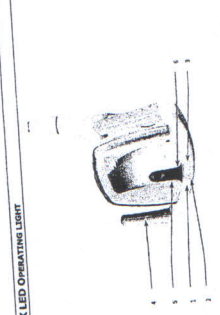


Fig. 11

LOOK LED showstopper operating light (Fig. 11) is equipped with touchless sensor (5) which enables to control the intensity of illumination from the dental unit. It is possible to switch on/off the intensity of illumination from the dental unit. It is possible to switch on/off the intensity of illumination from the dental unit.

Procedure of DU unpacking:

- 1. Check the shipping box for damage.
- 2. Check the shipping box for damage.
- 3. Check the shipping box for damage.
- 4. Check the shipping box for damage.
- 5. Check the shipping box for damage.
- 6. Check the shipping box for damage.
- 7. Check the shipping box for damage.
- 8. Check the shipping box for damage.
- 9. Check the shipping box for damage.
- 10. Check the shipping box for damage.
- 11. Check the shipping box for damage.
- 12. Check the shipping box for damage.
- 13. Check the shipping box for damage.
- 14. Check the shipping box for damage.
- 15. Check the shipping box for damage.

8.2 PLACEMENT OF THE DENTAL UNIT

Placement of DU depends on dental workplace space and complexity of its equipment. The placement of DU depends on dental workplace space and complexity of its equipment. The placement of DU depends on dental workplace space and complexity of its equipment.


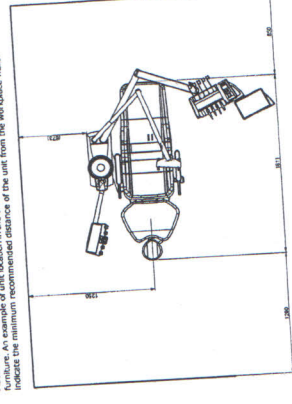


Fig. 15

3. Produkto aprašymas

STOMADENT NEO Of yra sukurtas pritaikyti ant odontologinio kėdės su ergonomišku, valdomu ant odontologinio kėdės (pat. 1). Ši odontologinė įrangą galima pritaikyti prie DC-70 NEO odontologinio kėdės, kurį pagamino kėdės (pat. 1). Ši odontologinė įrangą galima pritaikyti prie DC-70 NEO odontologinio kėdės, kurį pagamino kėdės (pat. 1). Ši odontologinė įrangą galima pritaikyti prie DC-70 NEO odontologinio kėdės, kurį pagamino kėdės (pat. 1).

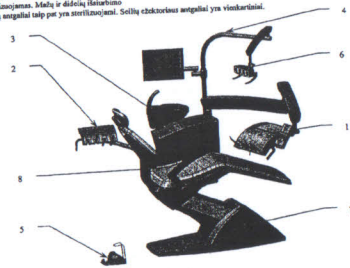

Pat. 1

1. Odontologinis stalo
2. Asinimo stalo
3. Spinduliuojantis
4. Pritaikyti operacinei būsenai
5. Pūslės
6. Operacinis lęšas
7. Energetinis
8. Odontologinis kėdės

Odontologinis stalo gali būti su 5 ar 6 instrumentais (visi gali būti optimizuoti) 4 šiuose tipuose:


- ☐ 1x iškilus
- ☐ 2x 4 rotaciniai instrumentais:
 - o muko, 2 turėtojai
 - o muko, 2 įrengimo / nedidelių mikromotors
- ☐ 1x ultragarsinis skalavimas
- ☐ 1x gręžimo lęšas

Asinimo stalo gali būti su 3 ar 4 instrumentais:

- ☐ 1x didelis išsiveržimo žarna
- ☐ 1x muko išsiveržimo žarna
- ☐ 1x sūlių ekstraktas
- ☐ 1x buras kameros
- ☐ 1x gręžimo lęšas
- ☐ 1x iškilus

4.3 Vandens tiekimo nustatymas

Aukšto vandens kiekis gali būti nustatytas naudojant valdymo (1), esančias valdymo skydo apačioje, esančioje po instrumentais.

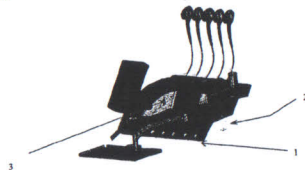

Pat. 7

Paviršius, iškilus instrumentais gali būti išvalytas stikliniu valdymu. Valdymo rutulius reikia prisukti po valdymo instrumentais, odontologinio stalo apačioje.

Dvi USB jungtys (3) yra naudojamos prijungiant du USB prietaisus.




Alyvos griebtuvai (2) turi būti patikrinami kiekvieną dieną ir, jei būtina, išvalomi.

4.4 Odontologinio stalo aukščio nustatymas

Pritaikyti odontologinio stalo aukščio (38) (pat. 2) yra įmanoma stikliniu valdymu, stikliniu automatiškai, kai aktyvuojama aukšto atnaujinimas. Tuo metu galima nustatyti aukščio, atidaryti rakelę, atidaryti stikliniu automatiškai, kai aktyvuojama aukšto atnaujinimas.

8.5 Aukšto iškilusio aukščio ir aukšto iškilusio nustatymas

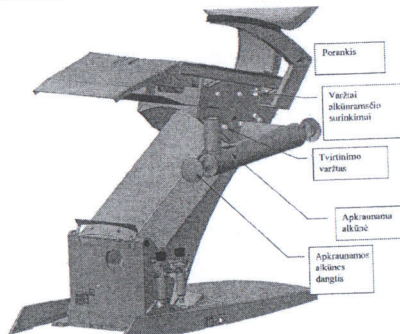

Pat. 18

- Pakeičkite kėdę į aukšto iškilusio puzę
- Aukšto iškilusio (1) iškilusio ir aukšto iškilusio puzę (2) į gultą, iškilusio.
- Iškilusio iškilusio aukšto iškilusio puzę (3) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (4) į gultą, iškilusio.
- Iškilusio iškilusio aukšto iškilusio puzę (5) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (6) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (7) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (8) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (9) į gultą, iškilusio.
- Nustatykite iškilusio aukšto iškilusio puzę (10) į gultą, iškilusio.

STOMADENT®

To whom it may concern

LETTER OF AUTHORIZATION

We hereby confirm that the company:

"LIMETA" UAB

is our authorized sales and service, including after sale and post-warranty maintenance partner and authorized to train staff partner in the territory of Lithuania for the following products:

If needed, Stomadent employees having appropriate qualification install dentology equipment mentioned below in the territory of Lithuania.

Dental Units:

STOMADENT IMPULS
STOMADENT GLANC
STOMADENT NEO

Dental Chair:

STOMADENT DC-70
STOMADENT NEO



STOMADENT SK s.r.o.

Valid to August 1st, 2026

Harmoned, August 1st, 2021



CEC International s.r.o., Naričinská 16, 821 06 Bratislava, Slovakia
Not/for Body No. 2255

EC CERTIFICATE
No. 2019-MDD/QS-054

Dental Unit
STOMADENT IMPULS
STOMADENT NEO
STOMADENT HARMONY

manufactured by company
STOMADENT SK s.r.o.
300, Lachovice 666 01, Slovak Republic



Stomadent 16.08.2021 - 17.08.2021 - 18.08.2021 - 19.08.2021 - 20.08.2021 - 21.08.2021 - 22.08.2021 - 23.08.2021 - 24.08.2021 - 25.08.2021 - 26.08.2021 - 27.08.2021 - 28.08.2021 - 29.08.2021 - 30.08.2021 - 31.08.2021 - 01.09.2021 - 02.09.2021 - 03.09.2021 - 04.09.2021 - 05.09.2021 - 06.09.2021 - 07.09.2021 - 08.09.2021 - 09.09.2021 - 10.09.2021 - 11.09.2021 - 12.09.2021 - 13.09.2021 - 14.09.2021 - 15.09.2021 - 16.09.2021 - 17.09.2021 - 18.09.2021 - 19.09.2021 - 20.09.2021 - 21.09.2021 - 22.09.2021 - 23.09.2021 - 24.09.2021 - 25.09.2021 - 26.09.2021 - 27.09.2021 - 28.09.2021 - 29.09.2021 - 30.09.2021 - 01.10.2021 - 02.10.2021 - 03.10.2021 - 04.10.2021 - 05.10.2021 - 06.10.2021 - 07.10.2021 - 08.10.2021 - 09.10.2021 - 10.10.2021 - 11.10.2021 - 12.10.2021 - 13.10.2021 - 14.10.2021 - 15.10.2021 - 16.10.2021 - 17.10.2021 - 18.10.2021 - 19.10.2021 - 20.10.2021 - 21.10.2021 - 22.10.2021 - 23.10.2021 - 24.10.2021 - 25.10.2021 - 26.10.2021 - 27.10.2021 - 28.10.2021 - 29.10.2021 - 30.10.2021 - 31.10.2021 - 01.11.2021 - 02.11.2021 - 03.11.2021 - 04.11.2021 - 05.11.2021 - 06.11.2021 - 07.11.2021 - 08.11.2021 - 09.11.2021 - 10.11.2021 - 11.11.2021 - 12.11.2021 - 13.11.2021 - 14.11.2021 - 15.11.2021 - 16.11.2021 - 17.11.2021 - 18.11.2021 - 19.11.2021 - 20.11.2021 - 21.11.2021 - 22.11.2021 - 23.11.2021 - 24.11.2021 - 25.11.2021 - 26.11.2021 - 27.11.2021 - 28.11.2021 - 29.11.2021 - 30.11.2021 - 01.12.2021 - 02.12.2021 - 03.12.2021 - 04.12.2021 - 05.12.2021 - 06.12.2021 - 07.12.2021 - 08.12.2021 - 09.12.2021 - 10.12.2021 - 11.12.2021 - 12.12.2021 - 13.12.2021 - 14.12.2021 - 15.12.2021 - 16.12.2021 - 17.12.2021 - 18.12.2021 - 19.12.2021 - 20.12.2021 - 21.12.2021 - 22.12.2021 - 23.12.2021 - 24.12.2021 - 25.12.2021 - 26.12.2021 - 27.12.2021 - 28.12.2021 - 29.12.2021 - 30.12.2021 - 31.12.2021 - 01.01.2022 - 02.01.2022 - 03.01.2022 - 04.01.2022 - 05.01.2022 - 06.01.2022 - 07.01.2022 - 08.01.2022 - 09.01.2022 - 10.01.2022 - 11.01.2022 - 12.01.2022 - 13.01.2022 - 14.01.2022 - 15.01.2022 - 16.01.2022 - 17.01.2022 - 18.01.2022 - 19.01.2022 - 20.01.2022 - 21.01.2022 - 22.01.2022 - 23.01.2022 - 24.01.2022 - 25.01.2022 - 26.01.2022 - 27.01.2022 - 28.01.2022 - 29.01.2022 - 30.01.2022 - 31.01.2022 - 01.02.2022 - 02.02.2022 - 03.02.2022 - 04.02.2022 - 05.02.2022 - 06.02.2022 - 07.02.2022 - 08.02.2022 - 09.02.2022 - 10.02.2022 - 11.02.2022 - 12.02.2022 - 13.02.2022 - 14.02.2022 - 15.02.2022 - 16.02.2022 - 17.02.2022 - 18.02.2022 - 19.02.2022 - 20.02.2022 - 21.02.2022 - 22.02.2022 - 23.02.2022 - 24.02.2022 - 25.02.2022 - 26.02.2022 - 27.02.2022 - 28.02.2022 - 29.02.2022 - 30.02.2022 - 31.02.2022 - 01.03.2022 - 02.03.2022 - 03.03.2022 - 04.03.2022 - 05.03.2022 - 06.03.2022 - 07.03.2022 - 08.03.2022 - 09.03.2022 - 10.03.2022 - 11.03.2022 - 12.03.2022 - 13.03.2022 - 14.03.2022 - 15.03.2022 - 16.03.2022 - 17.03.2022 - 18.03.2022 - 19.03.2022 - 20.03.2022 - 21.03.2022 - 22.03.2022 - 23.03.2022 - 24.03.2022 - 25.03.2022 - 26.03.2022 - 27.03.2022 - 28.03.2022 - 29.03.2022 - 30.03.2022 - 31.03.2022 - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 03.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 06.04.2022 - 07.04.2022 - 08.04.2022 - 09.04.2022 - 10.04.2022 - 11.04.2022 - 12.04.2022 - 13.04.2022 - 14.04.2022 - 15.04.2022 - 16.04.2022 - 17.04.2022 - 18.04.2022 - 19.04.2022 - 20.04.2022 - 21.04.2022 - 22.04.2022 - 23.04.2022 - 24.04.2022 - 25.04.2022 - 26.04.2022 - 27.04.2022 - 28.04.2022 - 29.04.2022 - 30.04.2022 - 01.05.2022 - 02.05.2022 - 03.05.2022 - 04.05.2022 - 05.05.2022 - 06.05.2022 - 07.05.2022 - 08.05.2022 - 09.05.2022 - 10.05.2022 - 11.05.2022 - 12.05.2022 - 13.05.2022 - 14.05.2022 - 15.05.2022 - 16.05.2022 - 17.05.2022 - 18.05.2022 - 19.05.2022 - 20.05.2022 - 21.05.2022 - 22.05.2022 - 23.05.2022 - 24.05.2022 - 25.05.2022 - 26.05.2022 - 27.05.2022 - 28.05.2022 - 29.05.2022 - 30.05.2022 - 31.05.2022 - 01.06.2022 - 02.06.2022 - 03.06.2022 - 04.06.2022 - 05.06.2022 - 06.06.2022 - 07.06.2022 - 08.06.2022 - 09.06.2022 - 10.06.2022 - 11.06.2022 - 12.06.2022 - 13.06.2022 - 14.06.2022 - 15.06.2022 - 16.06.2022 - 17.06.2022 - 18.06.2022 - 19.06.2022 - 20.06.2022 - 21.06.2022 - 22.06.2022 - 23.06.2022 - 24.06.2022 - 25.06.2022 - 26.06.2022 - 27.06.2022 - 28.06.2022 - 29.06.2022 - 30.06.2022 - 01.07.2022 - 02.07.2022 - 03.07.2022 - 04.07.2022 - 05.07.2022 - 06.07.2022 - 07.07.2022 - 08.07.2022 - 09.07.2022 - 10.07.2022 - 11.07.2022 - 12.07.2022 - 13.07.2022 - 14.07.2022 - 15.07.2022 - 16.07.2022 - 17.07.2022 - 18.07.2022 - 19.07.2022 - 20.07.2022 - 21.07.2022 - 22.07.2022 - 23.07.2022 - 24.07.2022 - 25.07.2022 - 26.07.2022 - 27.07.2022 - 28.07.2022 - 29.07.2022 - 30.07.2022 - 31.07.2022 - 01.08.2022 - 02.08.2022 - 03.08.2022 - 04.08.2022 - 05.08.2022 - 06.08.2022 - 07.08.2022 - 08.08.2022 - 09.08.2022 - 10.08.2022 - 11.08.2022 - 12.08.2022 - 13.08.2022 - 14.08.2022 - 15.08.2022 - 16.08.2022 - 17.08.2022 - 18.08.2022 - 19.08.2022 - 20.08.2022 - 21.08.2022 - 22.08.2022 - 23.08.2022 - 24.08.2022 - 25.08.2022 - 26.08.2022 - 27.08.2022 - 28.08.2022 - 29.08.2022 - 30.08.2022 - 31.08.2022 - 01.09.2022 - 02.09.2022 - 03.09.2022 - 04.09.2022 - 05.09.2022 - 06.09.2022 - 07.09.2022 - 08.09.2022 - 09.09.2022 - 10.09.2022 - 11.09.2022 - 12.09.2022 - 13.09.2022 - 14.09.2022 - 15.09.2022 - 16.09.2022 - 17.09.2022 - 18.09.2022 - 19.09.2022 - 20.09.2022 - 21.09.2022 - 22.09.2022 - 23.09.2022 - 24.09.2022 - 25.09.2022 - 26.09.2022 - 27.09.2022 - 28.09.2022 - 29.09.2022 - 30.09.2022 - 01.10.2022 - 02.10.2022 - 03.10.2022 - 04.10.2022 - 05.10.2022 - 06.10.2022 - 07.10.2022 - 08.10.2022 - 09.10.2022 - 10.10.2022 - 11.10.2022 - 12.10.2022 - 13.10.2022 - 14.10.2022 - 15.10.2022 - 16.10.2022 - 17.10.2022 - 18.10.2022 - 19.10.2022 - 20.10.2022 - 21.10.2022 - 22.10.2022 - 23.10.2022 - 24.10.2022 - 25.10.2022 - 26.10.2022 - 27.10.2022 - 28.10.2022 - 29.10.2022 - 30.10.2022 - 31.10.2022 - 01.11.2022 - 02.11.2022 - 03.11.2022 - 04.11.2022 - 05.11.2022 - 06.11.2022 - 07.11.2022 - 08.11.2022 - 09.11.2022 - 10.11.2022 - 11.11.2022 - 12.11.2022 - 13.11.2022 - 14.11.2022 - 15.11.2022 - 16.11.2022 - 17.11.2022 - 18.11.2022 - 19.11.2022 - 20.11.2022 - 21.11.2022 - 22.11.2022 - 23.11.2022 - 24.11.2022 - 25.11.2022 - 26.11.2022 - 27.11.2022 - 28.11.2022 - 29.11.2022 - 30.11.2022 - 01.12.2022 - 02.12.2022 - 03.12.2022 - 04.12.2022 - 05.12.2022 - 06.12.2022 - 07.12.2022 - 08.12.2022 - 09.12.2022 - 10.12.2022 - 11.12.2022 - 12.12.2022 - 13.12.2022 - 14.12.2022 - 15.12.2022 - 16.12.2022 - 17.12.2022 - 18.12.2022 - 19.12.2022 - 20.12.2022 - 21.12.2022 - 22.12.2022 - 23.12.2022 - 24.12.2022 - 25.12.2022 - 26.12.2022 - 27.12.2022 - 28.12.2022 - 29.12.2022 - 30.12.2022 - 31.12.2022 - 01.01.2023 - 02.01.2023 - 03.01.2023 - 04.01.2023 - 05.01.2023 - 06.01.2023 - 07.01.2023 - 08.01.2023 - 09.01.2023 - 10.01.2023 - 11.01.2023 - 12.01.2023 - 13.01.2023 - 14.01.2023 - 15.01.2023 - 16.01.2023 - 17.01.2023 - 18.01.2023 - 19.01.2023 - 20.01.2023 - 21.01.2023 - 22.01.2023 - 23.01.2023 - 24.01.2023 - 25.01.2023 - 26.01.2023 - 27.01.2023 - 28.01.2023 - 29.01.2023 - 30.01.2023 - 31.01.2023 - 01.02.2023 - 02.02.2023 - 03.02.2023 - 04.02.2023 - 05.02.2023 - 06.02.2023 - 07.02.2023 - 08.02.2023 - 09.02.2023 - 10.02.2023 - 11.02.2023 - 12.02.2023 - 13.02.2023 - 14.02.2023 - 15.02.2023 - 16.02.2023 - 17.02.2023 - 18.02.2023 - 19.02.2023 - 20.02.2023 - 21.02.2023 - 22.02.2023 - 23.02.2023 - 24.02.2023 - 25.02.2023 - 26.02.2023 - 27.02.2023 - 28.02.2023 - 29.02.2023 - 30.02.2023 - 31.02.2023 - 01.03.2023 - 02.03.2023 - 03.03.2023 - 04.03.2023 - 05.03.2023 - 06.03.2023 - 07.03.2023 - 08.03.2023 - 09.03.2023 - 10.03.2023 - 11.03.2023 - 12.03.2023 - 13.03.2023 - 14.03.2023 - 15.03.2023 - 16.03.2023 - 17.03.2023 - 18.03.2023 - 19.03.2023 - 20.03.2023 - 21.03.2023 - 22.03.2023 - 23.03.2023 - 24.03.2023 - 25.03.2023 - 26.03.2023 - 27.03.2023 - 28.03.2023 - 29.03.2023 - 30.03.2023 - 31.03.2023 - 01.04.2023 - 02.04.2023 - 03.04.2023 - 04.04.2023 - 05.04.2023 - 06.04.2023 - 07.04.2023 - 08.04.2023 - 09.04.2023 - 10.04.2023 - 11.04.2023 - 12.04.2023 - 13.04.2023 - 14.04.2023 - 15.04.2023 - 16.04.2023 - 17.04.2023 - 18.04.2023 - 19.04.2023 - 20.04.2023 - 21.04.2023 - 22.04.2023 - 23.04.2023 - 24.04.2023 - 25.04.2023 - 26.04.2023 - 27.04.2023 - 28.04.2023 - 29.04.2023 - 30.04.2023 - 01.05.2023 - 02.05.2023 - 03.05.2023 - 04.05.2023 - 05.05.2023 - 06.05.2023 - 07.05.2023 - 08.05.2023 - 09.05.2023 - 10.05.2023 - 11.05.2023 - 12.05.2023 - 13.05.2023 - 14.05.2023 - 15.05.2023 - 16.05.2023 - 17.05.2023 - 18.05.2023 - 19.05.2023 - 20.05.2023 - 21.05.2023 - 22.05.2023 - 23.05.2023 - 24.05.2023 - 25.05.2023 - 26.05.2023 - 27.05.2023 - 28.05.2023 - 29.05.2023 - 30.05.2023 - 31.05.2023 - 01.06.2023 - 02.06.2023 - 03.06.2023 - 04.06.2023 - 05.06.2023 - 06.06.2023 - 07.06.2023 - 08.06.2023 - 09.06.2023 - 10.06.2023 - 11.06.2023 - 12.06.2023 - 13.06.2023 - 14.06.2023 - 15.06.2023 - 16.06.2023 - 17.06.2023 - 18.06.2023 - 19.06.2023 - 20.06.2023 - 21.06.2023 - 22.06.2023 - 23.06.2023 - 24.06.2023 - 25.06.2023 - 26.06.2023 - 27.06.2023 - 28.06.2023 - 29.06.2023 - 30.06.2023 - 01.07.2023 - 02.07.2023 - 03.07.2023 - 04.07.2023 - 05.07.2023 - 06.07.2023 - 07.07.2023 - 08.07.2023 - 09.07.2023 - 10.07.2023 - 11.07.2023 - 12.07.2023 - 13.07.2023 - 14.07.2023 - 15.07.2023 - 16.07.2023 - 17.07.2023 - 18.07.2023 - 19.07.2023 - 20.07.2023 - 21.07.2023 - 22.07.2023 - 23.07.2023 - 24.07.2023 - 25.07.2023 - 26.07.2023 - 27.07.2023 - 28.07.2023 - 29.07.2023 - 30.07.2023 - 31.07.2023 - 01.08.2023 - 02.08.2023 - 03.08.2023 - 04.08.2023 - 05.08.2023 - 06.08.2023 - 07.08.2023 - 08.08.2023 - 09.08.2023 - 10.08.2023 - 11.08.2023 - 12.08.2023 - 13.08.2023 - 14.08.2023 - 15.08.2023 - 16.08.2023 - 17.08.2023 - 18.08.2023 - 19.08.2023 -



	Model	Uni-Jet 75 with box and control panel
	Rated voltage	230 V $\sim$ $\pm$ 5%
	Rated frequency	50 Hz
	Rated current	3,1 A
	Insulation class	Class I
	Type of appliance	B
	Operating conditions	continuous operation
	Protection against ingress of liquids	ordinary
	Degree of protection against electric shock	type B $\uparrow$
	The motor is protected by a thermal switch	
	Output power	0,4 kW
	Maximum flow	1250 umin
	Maximum head for continuous operation	1300 mm H ₂ O
	Sound pressure level	58 dB(A)*
	Other voltages available on request: 240 V $\sim$ 50 Hz, 2,95 A 220 V $\sim$ 60 Hz, 3,5 A, 120 V $\sim$ 60 Hz, 6,0 A - 110 V $\sim$ 60 Hz, 7,0 A - 100 V $\sim$ 60 Hz, 7,0 A	
	This appliance cannot work in the presence of an anesthetic mixture flammable with air, oxygen or nitrous oxide	
	A bacteriological filter is also available to filtrate the exhausted air	
~	Alternating current	IEC 417-5032
⊕	Earthing	IEC 417-5019
⊕	Appliance Type B	IEC 878-02-02
○	OPEN (disconnected from the main electrical supply)	IEC 417-5006
⊞	CLOSED (connected to the main electrical supply)	IEC 417-5007
⊥	Dangerous voltage	IEC 878-03-01

*Sound pressure level with canalized air tested according to the standard ISO 3746-1979 (E).
Parameters: $r=1$ - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær Type 2232.

Manufactured by CATTANI S.p.A. - PARMA - ITALY

STOMADENT SK s.r.o.
HUMENNÉ, January 18th, 2021

Valid to January 18st, 2026

STOMADENT SK s.r.o.
HUMENNÉ, January 18st, 2021

Valid to January 18st, 2026



Topic	Intentional torts (right to privacy, false arrest, libel and slander)
Rule	Right to privacy not a legal tort
Comments/exceptions	1. Right to privacy is a legal tort if it is a violation of a person's right to privacy.



STOMADENT SK s.r.o. č.d. 300, 066 01 Lúckovo, Slovakia,
e-mail: stomadent@stomadent.sk, IČO: 36 722 138, IČ DPH: SK 2022302667
Odborný register Ošetrovateľský ústredný úrad Prešov, číslo zápisu: 18150/P



From:
UAB "LIMETA"
 V.A. Graičiūno g. 4
 LT-02241 Vilnius
 Lithuania

STOMADENT SK S.L.O. confirms that it is supplier of micromotors, turbines, contra-angles and straight handpieces produced by Bien-Air Dental SA, Switzerland and these products (incl. spare parts) supplied to JSC Limeta V.A. Graižiuo 4, Vilnius, Lithuania.



Valid to August 23, 2026

Director of STOMADENT SK s.r.o.
E. Sidun
Humenné August 23, 2021

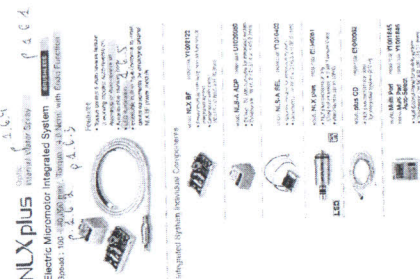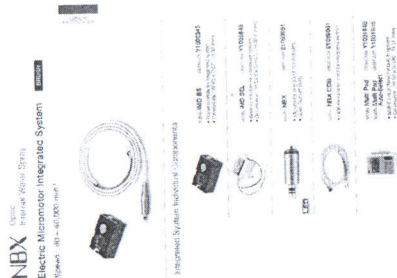


TECHNICAL DATA

[illegible]

CURING LIGHT BUILT-IN C USER'S MANUAL

(Please read this manual before operating)

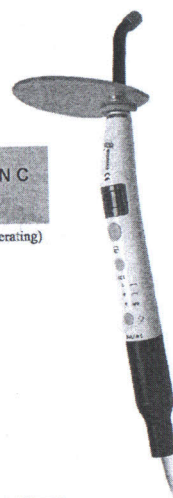

GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
www.glwoodpecker.com

4.4.2 Wave length: $420\text{nm} - 480\text{nm}$ $\uparrow$ 4.4.2

4.4.3 Light intensity: $1000\text{mW/cm}^2 - 1200\text{mW/cm}^2$ $\uparrow$ 4.4.3

4.4.3 Light intensity: $1000\text{mW/cm}^2 \sim 1200\text{mW/cm}^2$ (4.4.4)

4.5 Working condition:

4.5.1 Environment temperature: 5°C to 40°C

4.5.2 Relative humidity: $\leq 80\%$

4.6 Dimensions: $\Phi 23\text{mm} \times 250\text{mm}$

4.7 Net weight: 160g

4.8 Consumption power: $\leq 8W$

4.9 Protection type against electrical shock: class II

4.10 Protection against electrical shock: type B

4.11 Protection against harmful ingress of water or particular matter: Ordinary equipment (IPX0)

4.12 Safety in the presence of flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide: not suitable under this condition.

4.13 Applied part: optical fiber
Notice: the equipment needs to be installed in the medical power supply, and to ensure that the final product meets the requirements of IEC 60601-1.

5. Assembly and disassembly

5.1 Connect the power line which marked with 24V~ to the dental unit 24V~ output, lace the nylon thread to the dental unit, it's ready to be operated.

Spare parts for curing light



Beveled Optical Fiber

- Easy to touch any part of teeth.
- Can radiate vertically at any angles.
- Solve the problem of weak light intensity when radiate vertically with old optical fiber.
- The light intensity is 40% higher than old optical fiber on certain spot when radiate vertically.

Optical fiber
Black and white optical
Can be embedded under
temperature and high
pressure
1. Conduction fibers
2. Dispersion fibers
3. Application for
LEDs, LEDs, LEDs, LEDs,
LEDs, LEDs, LEDs

Power supply
Power input:
AC100V-240V: 50/60Hz
Power Output / Current
DC5.0V / 1.0A
Applicable for:
LED A, LED C, LED D,
LED F, LED H

Light: 1000 lux

Lightmeter

Bathynoder

for LECF