



L. R. Tamulio firma „Meditalika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT- 48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501.206132 faksas 424363

El. paštas: info@meditalika.lt

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „PRIEMONĖS STERILIZACIJAI“
2023-01-16
KAUNAS

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	L.R.Tamulio firma “Meditalika”
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)	134565744
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	[redacted]
Įmonės vadovo vardas, pavardė	[redacted]
Telefono numeris	(8 37) 22 22 23/ 8 610 17000
El. pašto adresas	info@meditalika.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	-

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekeją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekejų (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Subtiekejų (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-
Ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-
Kvazisubtiekejų (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Kvazisubtiekejų (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ priėmimo į klausimą)
1.	EBVVPD anketa	“Kvalifikaciniai klausimai”
2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	“Kvalifikaciniai klausimai”

2. Mes siūlome pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas prekes.

3. **Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninės specifikacija“, nurodant siūlomų prekių įkainius ir kita reikalaujama informacija.**

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): 2023-05-17d.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	“Techninė specifikacija-priemonės sterilizacijai” lentelė	13
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1
3.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	1
4.	Registravimo pažymėjimas/ nuostatų kopija	3
5.	Bowie-Dick prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracijos/ bukletai	12
6.	Krovinio kontrolės prietaiso ir indikatoriaus (garų/ EO) instrukcija/ atitikties deklaracijos/ bukletai	10
7.	Išorinių indikatorių (garų/ EO) instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	9
8.	Cheminio EO paketo indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	5
9.	Popieriaus-plastiko juostų instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletai	20
10.	SealTest instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	4
11.	Rotacinio užlydymo aparato instrukcija	8

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil.Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	EBVVPD anketa	4
2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	17

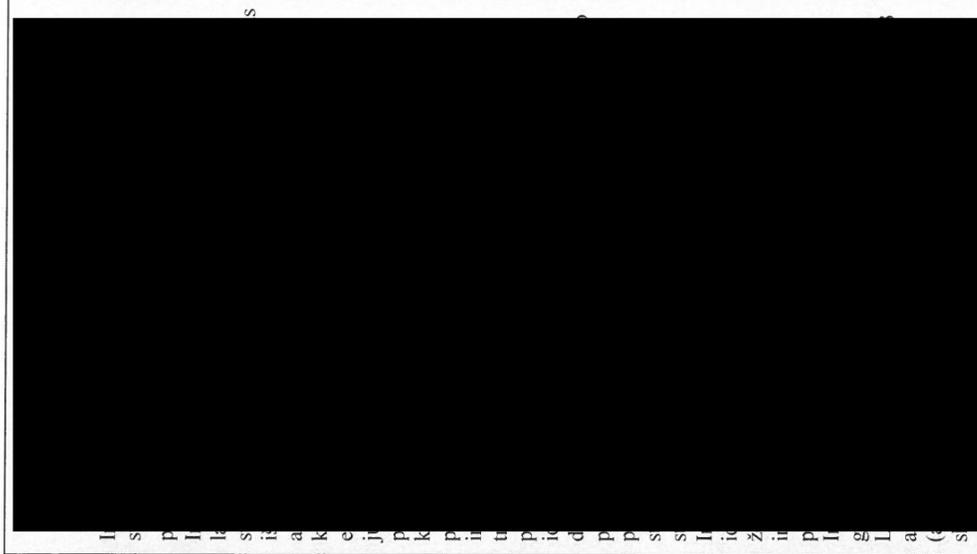
*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.**

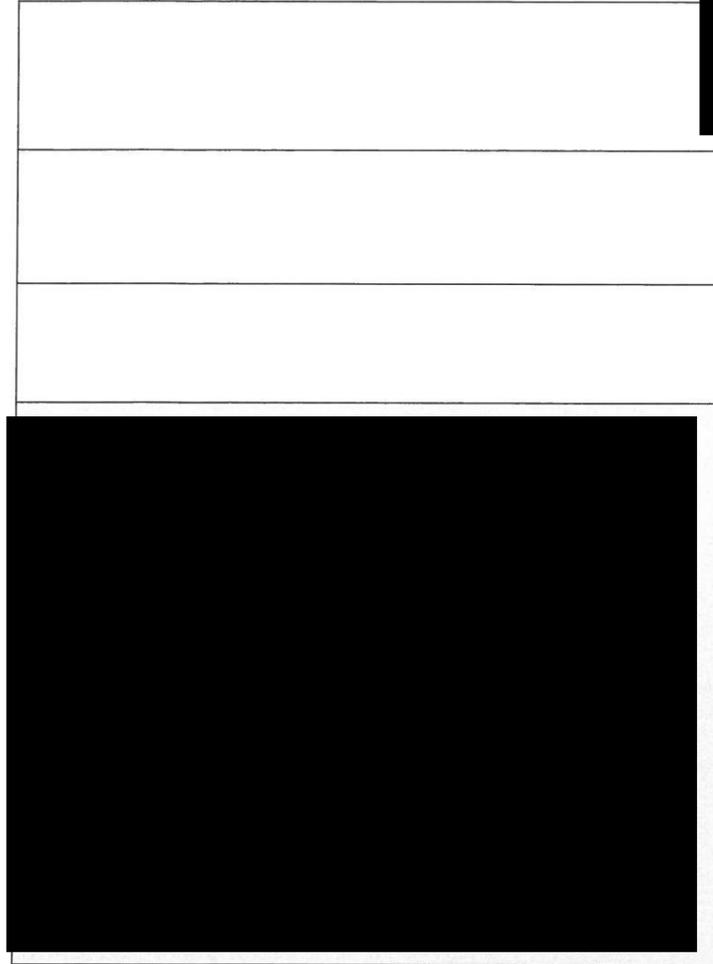
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - PRIEMONĖS STERILIZACIJAI

1 pirkimo dalis. Sterilizacijos proceso kontrolė garo sterilizatoriams.

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Prelimi narius kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1		3	4	5	6	7

51

<p>Bowie ir Dick indikatorius, (specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dick bandymui) garo sterilizatoriams.</p>	<p>Indikatoriai skirti Bowie - Dick bandymui didiesiems garo sterilizatoriams, oro pašalinimo iš sterilizatoriaus ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus gaminius, kontrolei. Indikatorius aiškiai identifikuojamas: ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio rėmo nurodytas testo pavadinimas (Bowie-Dick), sterilizacijos būdas garais (STEAM). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir kelių segmentų indikatorinio agento. Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą. Rezultatai vertinami iš karto. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatoriaus juostelė – lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinatą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Imitacinis prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų sterilizacijai 121-134C temperatūrai, atlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų. Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso ar jo pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artkelio Nr.). Indikatorius ir imitacinis prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogiai dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam garo sterilizatoriui). Būna pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus(antrojo tipo cheminis specialiuųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dick bandymui).</p>		<p>6600 vnt.</p>	<p>E</p>	
<p>Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai socialiais vandens garais (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei).</p>	<p>Krovinio partijos kontrolės indikatorius pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinos prietaisų)) kontrolei garų sterilizatoriuose. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus. Rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui. Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai vandens garais 121-134C temperatūrai. Ant indikatorinės juostelės arba indikatoriaus lapelių rėmo, turi būti gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artkelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą), gamybinės partijos Nr., indikatorinė</p>		<p>27000 vnt.</p>	<p>E</p>	

		<p>juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsauganti indikatorius nuo išorinio poveikio. Krovinio imitacinis prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų sterilizacijos 121-134C temperatūrai, atlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso ar jo pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklėlinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą). Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam garo sterilizatoriui). Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.</p>	
		Bendra 1 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur:	
		PVM, Eur:	
		Bendra 1 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur	

2 pirkimo dalis. Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	<p>Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams</p>	<p>Ant cheminio indikatorius turi būti nurodytas: turi būti skirta sterilizacijai vandens garais 121-134C temperatūrai (STEAM), aiškus indikatorius spalvų pasikeitimas po sterilizacijos. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidas – dviguba lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus). Indikatorius klijuojamas ant paketo paviršiu. Indikatoriai skirti Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750 vnt., indikatoriaus paviršius turi greitai ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrinti, neišblukę, neišsilietę prieš sterilizaciją. sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilus po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui, aiškiai paženklinatą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugantią indikatorius nuo išorinio poveikio. Ant cheminio indikatorius yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo datą – ne mažiau kaip trys eilės (kiekvienoje eilutėje ne mažiau 12 ženklų). Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos. Indikatoriai komplektuojami su rašalo kasetėmis (žymėti numatyta kiekį indikatorių), spausdintuvui tinkamam su etiketėmis, su specialiu rašalu kad indikatorius paviršius greitai ir patikimai sugertu spausdintuvo rašalą, neišsilietę, skirtu sterilizacijai. Būtina pateikti atitikties dokumentus: indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius). Pateikti panaudai rankinius spausdintuvus indikatoriams klijuoti ant paketų ir žymėti reikiamai informacijai ant cheminio indikatorius (sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo laiką). - 4 vnt.</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>2400 ritinėlių (ritinėlyje ne mažiau 750 vnt.)</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>

6.

3 pirkimo dalis. Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizatoriams etileno oksido dujomis (EO) (antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei)

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	<p>Krovinio partijos kontrolės indikatorius (antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinos prietaisų)) sterilizacijai etileno oksido dujomis sterilizatoriuose.</p> <p>Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis; ant indikatorinės juostelės arba indikatoriaus lapelio rėmo, turi būti gamintojo ženklavimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą.), indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus, rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus; indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai.</p> <p>Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gamintojo pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio.</p> <p>Krovinio imitacinis prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo, pagamintas iš patvarios medžiagos, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso ar jo pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą.), atsparus sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis, išlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų.</p> <p>Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje. Imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogė dirbti. Imitaciniai prietaisai sutiekiami nemokamai.</p> <p>Būna pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.</p>	<p>Gke – GmbH, Vokietija</p> <p>BMS indikator.(EO, C-E-PM)212-202</p> <p>Krovinio partijos kontrolės indikatorius(antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinos prietaisų)) sterilizacijai etileno oksido dujomis sterilizatoriuose. Indikatorinė juostelė skirta sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis; ant indikatoriaus lapelio rėmo, yra gamintojo ženklavimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą.), indikatorinė juostelė padengta apsauginiu sluoksniu, indikatorius reaguoja į visus kritinius sterilizacijos parametrus, rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili ne trumpiau kaip 3 metus; indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gamintojo pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Krovinio imitacinis prietaisas daugkartinio naudojimo, pagamintas iš patvarios medžiagos, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso yra įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą.), atsparus sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis, išlaiko 10 000 sterilizacijos ciklų.</p>	<p>1200 vnt.</p>	<p>0,90 Eur/1vnt.</p>	<p>1080,00 Eur</p>	

			<p>Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas sudaro vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje. Imitacinio prietaiso konstrukcija saugi personalui, patogiai dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai.</p> <p>Pateikti atitiktis dokumentus: atitinka LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialiuju tyrimu indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.</p>		
PVM, Eur:					226,80 Eur
Bendra 3 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur					1306,80 Eur

9 -

4 pirkimo dalis. Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai etileno oksido dujų (EO) sterilizatoriams

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminariaus kiekius 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	<p>2</p> <p>Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai etileno oksido dujų (EO) sterilizatoriams</p>	<p>3</p> <p>Ant cheminio indikatorius turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas etileno oksido dujos (EO), aiškus indikatorius spalvų pasikeitimas po sterilizacijos.</p> <p>Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavaldas – dviguba lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus).</p> <p>Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750 vnt., indikatorius paviršius turi greitai ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrinų, neišbluktu, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilus po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus.</p> <p>Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui, aiškiai paženklinimą pakuotė (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio.</p> <p>Ant cheminio indikatorius yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo datą – ne mažiau kaip trys eilės (kiekvienoje eilutėje ne mažiau 12 ženklų). Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos.</p> <p>Indikatoriai komplektuojami su rašalo kasetėmis (žymėti numatytą kiekį indikatorių), spausdintuvui tinkamam su etiketėmis, su specialiu rašalu kad indikatorius paviršius greitai ir patikimai sugertu spausdintuvo rašalą, neišsilietų, skirtą sterilizacijai.</p> <p>Būtina pateikti atitikties dokumentus: indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius).</p> <p>Pateikti panaudai rankinius spausdintuvus indikatoriams klijuoti ant paketų ir žymėti reikiamą informaciją ant cheminio indikatorius (sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo laiką). - 2 vnt.</p>	<p>4</p> <p>Atitikimas reikalavimams</p>	<p>5</p> <p>300 ritinėlių (ritinėlyje ne mažiau 750 vnt.)</p>	<p>6</p>	<p>7</p>

10 -

5 pirkimo dalis. Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido (EO) dujomis

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido (EO) dujomis	<p>Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido dujomis (EO).</p> <p>Popieriaus juostelė, ant kurios užneštas cheminis dažas, kad būtų galima įvertinti indikatoriaus spalvos pasikeitimą. Indikatorius turi kontrolinę spalvą ant juostelės.</p> <p>Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas sterilizacijos būdas etileno oksido dujomis (EO)</p> <p>Indikatorius turi turėti lipnų paviršių, pritaikytą įklijuoti į dokumentaciją.</p> <p>Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius).</p>	<p>Gke – GmbH, Vokietija C-E-P-4-SV2 chem.indik.</p> <p>Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido dujomis (EO). Popieriaus juostelė, ant kurios užneštas cheminis dažas, kad būtų galima įvertinti indikatoriaus spalvos pasikeitimą. Indikatorius turi kontrolinę spalvą ant juostelės. Ant cheminio indikatoriaus nurodytas sterilizacijos būdas etileno oksido dujomis (EO). Indikatorius turi lipnų paviršių, pritaikytą įklijuoti į dokumentaciją.</p> <p>Pateikti atitikties dokumentai: atitinka LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius).</p>	3300 vnt.	0,10 Eur/1vnt.	330,00 Eur
PVM, Eur:						69,30 Eur
Bendra 5 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur						399,30 Eur

12 -

6 pirkimo dalis. Pakavimo medžiagos. Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų mediciniųjų priemonių pakelių formavimui.

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gaminiojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
6.1.	Popieriaus - plastiko juostos be klostės	<p>Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų mediciniųjų priemonių pakelių formavimui. Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m² (pateikti tai įrodančius dokumentus).</p> <p>Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų. Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai proceso indikatoriai STEAM(gary) ir EO (etileno oksido dujų). Visa informacija yra ant juostos šonų: I klasės garų ir dujų proceso poveikio indikatoriai, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis. Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių aplaishų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 11 mm pločio. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros.</p> <p>Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus juostas nuo išorinio poveikio.</p> <p>Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus. Turi turėti CE ženklą(pagal 93/42/EEB).</p>	<p>Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija</p> <p>Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų mediciniųjų priemonių pakelių formavimui. Popierinė dalis pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris 70 g/m². Plastikinė juostos dalis pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios bendras storis 52 mikronų. Ant pakavimo juostų yra išoriniai proceso indikatoriai STEAM(gary) ir EO (etileno oksido dujų). Visa informacija yra ant juostos šonų: I klasės garų ir dujų proceso poveikio indikatoriai, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis. Popieriaus-plastiko juosta pasižymi puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių aplaishų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 11 mm pločio. Pateikta gamintojo rekomendacija dėl lydymo temperatūros.</p> <p>Popieriaus plastiko juostos supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus juostas nuo išorinio poveikio.</p> <p>Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.</p> <p>Turi turėti CE ženklą(pagal 93/42/EEB).</p>	<p>75mm x 200m 450 vnt.</p> <p>100mm x 200m 450 vnt.</p> <p>150mm x 200m 450 vnt.</p> <p>200mm x 200m 450 vnt.</p> <p>250mm x 200m 450 vnt.</p> <p>300mm x 200m 450 vnt.</p> <p>400mm ±20mm x 200m 225 vnt.</p>	<p>12,00 Eur/1vnt.</p> <p>13,00 Eur/1vnt.</p> <p>17,00 Eur/1vnt.</p> <p>22,00 Eur/1vnt.</p> <p>28,00 Eur/1vnt.</p> <p>35,00 Eur/1vnt.</p> <p>44,00 Eur/1vnt.</p>	<p>5400,00 Eur</p> <p>5850,00 Eur</p> <p>7650,00 Eur</p> <p>9900,00 Eur</p> <p>12 600,00 Eur</p> <p>15 750,00 Eur</p> <p>9900,00 Eur</p>
6.2.	Popieriaus - plastiko juostos su klose.	<p>Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų mediciniųjų priemonių pakelių formavimui. Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m² (pateikti tai įrodančius dokumentus).</p> <p>Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų. Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai proceso indikatoriai STEAM(gary) ir EO (etileno oksido dujų). Visa informacija yra ant juostos šonų: I klasės garų ir</p>	<p>Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija</p> <p>Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų mediciniųjų priemonių pakelių formavimui. Popierinė dalis pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris 70 g/m². Plastikinė juostos dalis pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios bendras storis 52 mikronų. Ant pakavimo juostų yra</p>	<p>150 x 100 su klose 90 vnt.</p> <p>400mm ±20mm x100 su klose</p>	<p>18,00 Eur/1vnt.</p> <p>37,00 Eur/1vnt.</p>	<p>1620,00 Eur</p> <p>2220,00 Eur</p>

		<p>dujų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis. Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių atplaišų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm pločio. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros.</p> <p>Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo užlydymo aparato (siūlėtuvo) užlydymo kontrolės indikatorius, skirtas nuolatinei užlydymo aparato kontrolei. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva – juoda.</p> <p>Ant testo yra vietos reikiamai informacijai rašyti. Pritaikytas saugojimui.</p> <p>Būtiną pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti L-ST EN ISO 11607 – 1.</p>	<p>išorinio proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų). Visa informacija yra ant juostos šonų: I klasės garų ir dujų proceso poveikio indikatoriai, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis. Popieriaus-plastiko juosta pasižymi puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių atplaišų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 11 mm pločio. Pateikta gamintojo rekomendacija dėl lydymo temperatūros.</p>	<p>60 vnt.</p>	
<p>6.3.</p>	<p>Užlydymo siūlės kokybės testas.</p>	<p>PharmaLabel B. V., Olandija</p> <p>SEAL TEST indikatoriai</p> <p>Užlydymo aparato (siūlėtuvo) užlydymo kontrolės indikatorius, skirtas nuolatinei užlydymo aparato kontrolei.</p> <p>Indikatoriaus funkcinės dalies spalva – juoda.</p> <p>Ant testo yra vietos reikiamai informacijai rašyti. Pritaikytas saugojimui.</p> <p>Pateiktas atitikties dokumentus: atitinka LST EN ISO 11607 – 1.</p>	<p>3000 vnt.</p>	<p>0,20 Eur/1vnt.</p>	<p>600,00 Eur</p>
	<p>Rotacinis užlydymo aparatas panaudai</p>	<p>Kartu su plastiko juostomis turi būti pateikiami <i>rotaciniai</i> popieriaus-plastiko juostų užlydymo aparatai su <i>priekiniu transportavimo stalu</i>.</p> <p>Korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.</p> <p>Aisparus valymui ir dezinfekcijai.</p> <p>Turi turėti mikroprocesoriaus valdymą.</p> <p>Užlydymo greitis ne mažiau 7,5 m/min.</p> <p>Užlydymo siūlės plotis ne mažiau 12 mm.</p> <p>Temperatūros nustatymo ribos (nuo 50°C iki 250 °C).</p> <p>Turi turėti apsaugą nuo perkaitimo.</p> <p>Apsauga nuo pakuočių įtraukimo.</p> <p>Su savaiminiu slėgio reguliavimo mechanizmu, kuris įjungtų transporterį tik įdėjus paketą į lydymo takelį.</p> <p>Su apsaugine išsijungimo funkcija.</p>	<p>2 vnt.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

