

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Kauno ligoninė
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2024 m. liepos m. 18 d. Nr. VP-24-06
Į 2024-07-08 CVP IS Nr. 12678438

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Perkančioji organizacija vykdo viešąjį pirkimą „*Universalaus skaitmeninio rentgeno aparato pirkimas*“, pirkimo CVP IS Nr. 701608 (toliau – **Pirkimas**). Pirkimo objektas yra nurodytas techninėje specifikacijoje (toliau – **Techninė specifikacija**). Techninės specifikacijos 1.1 p. nurodyta, kad Pirkimo objektas yra universalus skaitmeninis rentgeno aparatas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu.

Pirkime pasiūlymą teikė ir tiekėjas UAB „Kodmeda“ (toliau – **Tiekėjas**), tačiau Perkančioji organizacija 2024-07-08 pateikė prašymą paaiškinti / patikslinti Tiekėjo pasiūlymą. Iš esmės Perkančiajai organizacijai kyla klausimai dėl Tiekėjo nurodytos konfidencialios informacijos, Tiekėjo pateiktų dokumentų pilnos apimties bei pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.1.29, 1.1.85, 1.1.86. p. ir pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Virtualus kolimavimas“ (T₃). Paaiškinimų pateikimui perkančioji organizacija suteikė Tiekėjui terminą iki 2024-07-19 09:00 val.

Dėl savo pasiūlymo informacijos (ne)konfidencialumo Tiekėjas jau pasisakė ankstesnėje komunikacijoje, o toliau teikia atsakymus / paaiškinimus į likusius Perkančiosios organizacijos pateiktus klausimus.

1. Dėl pateikiamų dokumentų ir jų apimties

Kartu su savo pasiūlymu Tiekėjas pateikė visus dokumentus, kurie patvirtintų jo pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija prašo pateikti visų „*Dokumentai. Konfidencialu*“ dokumente sudėtų originalių dokumentų skaitmenines kopijas visa apimtimi.

Tiekėjas pažymi, kad beveik visi pateikti dokumentai ir buvo pateikti pilna apimtimi, tik sudėti į vieną failą. Nepaisant to, atskirai teikiame visus dokumentus. Kaip pastebės Perkančioji organizacija, naujai pateikiamoje rentgeno įrangos techninėje dokumentacijoje jau yra nurodyta informacija apie integruotą vaizdo kamerą rentgeno vamzdžio kolonoje (Techninės specifikacijos 1.1.29 p.) (02. Premium vartotojo instrukcija 294 psl.). Tiekėjas šios informacijos sąmoningai neteikė (o teikė gamintojo deklaraciją), nes šiai dienai įranga yra atnaujinta, tačiau techninė dokumentacija gamintojo neatnaujinta (plačiau apie tai Tiekėjas pasisako kitoje šio rašto dalyje).

2. Dėl integruotos kameros (Techninės specifikacijos 1.1.29 p.)

Techninės specifikacijos 1.1.29. p. nurodyta „*Integruota vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, valdoma technologo darbo vietoje*“. Savo prašyme Perkančioji organizacija toliau klausia, kodėl pateiktoje gamintojo dokumentacijoje konkrečiai neįvardintas šis funkcionalumas, o Tiekėjas atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.29 p. reikalavimui grindžia gamintojo deklaracija.

Kaip jau minėjo Tiekėjas, ši informacija sąmoningai nebuvo teikta, nes šiai dienai įranga yra atnaujinta, tačiau gamintojas dar nėra atnaujinęs įrangos techninės dokumentacijos. Iš pateiktos originalios techninės dokumentacijos (02. Premium vartotojo instrukcija 294 psl.) matyti, kad joje nurodyta jog integruota vaizdo kamera naudoja CXDI NE programinę įrangą. Tačiau technologas vietoje nestovi,



gamintojas vis labiau optimizuoja (kainos ir kokybės atžvilgiu) savo įrangos parametrus ir bando kitokius sprendinius. Šiai dienai yra naudojama ne tik CXDI NE programinė įranga, bet ir gamintojo pasirinkta PRIMO S programinė įranga. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai siūlo rentgeno įrangą su naujausiais optimaliais sprendiniais.

Perkančioji organizacija nurodo, kad „*tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais*“. Būtent tokia situacija susiklostė ir šiuo atveju, kol kas oficialiai išleistais techniniais dokumentais atitiktis šiam Techninės specifikacijos reikalavimui nėra galimybės patvirtinti. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad pats įrangos gamintojas patvirtino kartu su pasiūlymu pateiktą deklaraciją, o ne davė nuorodą į savo išleistą dokumentaciją.

Akcentuotina, kad gamintojas kartu su pasiūlymu pateiktoje deklaracijoje patvirtino, jog įranga turi integruotą vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje (atitinka Techninės specifikacijos 1.1.29 p.). Šiek tiek plačiau situaciją gamintojas paaiškino ir dabar po Tiekėjo kreipimosi dėl paaiškinimų / patvirtinimų (žr. priedamą gamintojo raštą).

Pažymėtina, kad Pirkimo sutarties 1.2 p. nurodyta, kad prekės (su CE ženkliniu) turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos ir apmokytas personalas per **6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Taigi, nuo sutarties sudarymo Tiekėjas dar turės laiko su gamintoju suderinti tinkamas instrukcijas šios kameros naudojimui, įrangos įrengimo metu Perkančiosios organizacijos atstovai bus apmokyti, o ir pats Tiekėjas visada pasiruošęs atsakyti į bet kokius Perkančiosios organizacijos klausimus / padėti su įrangos valdymu.

Pažymėtina, kad instrukcijos pateikimas nėra Techninės specifikacijos reikalavimas, o labiau susijęs su Pirkimo sutarties vykdymu. Kaip bus nurodyta ir toliau, Tiekėjas yra įsipareigojęs besąlygiškai laikytis Pirkimo sąlygų reikalavimų, įskaitant ir Pirkimo sutarties sąlygų laikymąsi.

3. Dėl įrangos komplektavimo kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtų gamintojo deklaracijų (Techninės specifikacijos 1.1.85 p.)

Techninės specifikacijos 1.1.85 p. nurodyta „*Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos.*“ Perkančioji organizacija nurodė, kad Tiekėjas nepateikė jokios deklaracijos, kuri patvirtintų apie atitikį šiam reikalavimui.

Tiekėjas paaiškina, kad pateiktoje techninėje dokumentacijoje, konkrečiai 81 psl., yra nurodyta kokius kokybės ir kalibravimo testus **atlieka pats gamintojas**, prieš klientui atiduodamas įrangą. Nurodomos ne tik nurodytos kokybės kontrolės priemonės, kurias gamintojas taikė, tačiau nurodyti ir šių bandymų aprašymai (įrangos konfigūracijos). Pavyzdžiui, „Dosimeter: Vacudap“ (kaip tirtas radiacijos dozės lygis), PMMA 25 cm x 25 cm x 20 cm testas (testas naudojant specialų inžinerinį plastiką). Toliau nurodoma kokia buvo įrangos kalibracija, kokie rezultatai tikėtini atliekant testus.



Tiekėjas suprato, kad Techninės specifikacijos 1.1.85 p. kalbama apie visas bet kuriame įrangos pristatymo procese (nuo gamybos iki instaliacijos) taikomas kokybės kontrolės ir kalibravimo priemonės. Įvertinus Perkančiosios organizacijos paklausimą, Tiekėjas patvirtina, kad pats **Tiekėjas ar Perkančioji organizacija neturės** atlikti jokių panašių testų, taikyti tam tikrų kontrolės priemonių įrangos instaliacijos metu ar po to. Tai patvirtina ir įrangos gamintojas prie šio rašto pridedamame gamintojo rašte.

4. Dėl kartu su rentgeno įranga pateikiamos vaizdo plokštės, kompiuterio ir monitorių (Techninės specifikacijos 1.1.86 p.)

Techninės specifikacijos 1.1.86 p. nurodyta, kad „Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, ≥ 3 megapikselių raiškos, ≥ 21 " ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m², apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA“.


Perkančioji organizacija savo prašyme nurodo, kad jai nėra aišku ar Tiekėjo pasiūlymas atitinka 1.1.86 p. nurodytą reikalavimą dėl vaizdo plokštės, kompiuterio ir monitoriaus, todėl prašo patikslinti Tiekėjo pasiūlymą dėl atitikties šiam reikalavimui.

Tiekėjas paaiškina, kad jokių techninių reikalavimų nei vaizdo plokštei, nei kompiuteriui, nei monitoriui Perkančioji organizacija nenustatė, todėl Tiekėjo įsitikinimu paprasčiausio patvirtinimo, kad tokia įranga bus montuojama, Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams privalėjo pakakti, o Tiekėjas tai ir padarė. Tiekėjas:

- (i) prie pasiūlymo formos pridėtoje užpildytoje techninėje specifikacijoje nurodė „<...> Komplektuojama <...> įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių <...>“:

Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, 3 megapikselių raiškos 21,3" ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis 600 cd/m², apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2200 VA; 477, 478, 481 psl.

- (ii) o garantiniame rašte (Techninės dokumentacijos 502 psl.) dar kartą patvirtinama, jog kartu su radiologo darbo vietoje bus įrengta ir vaizdo plokštė, ir kompiuteris, ir monitorius:

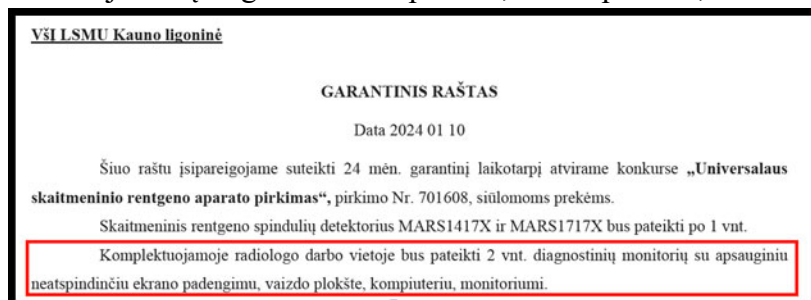

Bet kuriuo atveju, apie šią siūlomą įrangą galima spręsti ir iš kitų su Tiekėjo pasiūlymu pateiktų dokumentų.


Kaip savo pasiūlyme nurodė Tiekėjas, kartu su įranga (šiuo atveju pagrindiniais monitoriais NIO COLOR 3MP (MDNC-3521)) pateikiama ir vaizdo plokštė (angl. *display controler*) (Techninės dokumentacijos 478 psl.):

Optional accessories**Display controller****1.1.86**

Kaip nurodyta Techninėje dokumentacijoje, jei monitorius teikiamas su vaizdo plokšte, ši plokštė yra MXRT (konkrečių parametrų atitikčiai Techninei specifikacijai nurodyti nereikėjo):

Yes (in **MXRT display controller**, when used as a system with **MXRT display controller** & QAWeb Enterprise

Tuo tarpu siūlomų monitorių naudotojo vadove¹ (Tiekėjas teikė atitinkamą brošiūrą, vadovas prieinamas internete), nurodyta, kad šie monitoriai darbo vietoje naudojami ne tik su vaizdo plokšte, tačiau ir su kompiuteriu bei reikalinga periferija (klaviatūra, pelė):

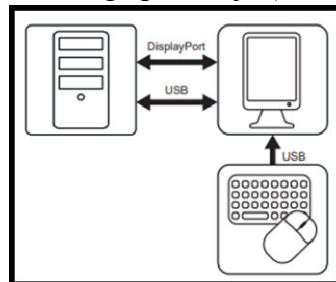

Taigi, įrengiant pagrindinius monitorius ir vaizdo plokštę Tiekėjas įprastai pristato ir kompiuterius bei kitą monitoriaus valdymui reikalingą įrangą (pelė, klaviatūra). Kadangi minėtiems elementams (kompiuteriui, vaizdo plokštei ar periferijai) jokių reikalavimų Techninėje specifikacijoje nebuvo nustatyta, Tiekėjas kažkokių techninių dokumentų kartu su pasiūlymu ir neteikė.

Kartu su įranga radiologui (Techninės specifikacijos 1.1.86 p.) pristatomas monitorius nurodytas Techninės dokumentacijos 358 psl. Kadangi jokių reikalavimų monitoriui nebuvo, jokių papildomų nuorodų į Techninę specifikaciją ir nebuvo nurodyta. Tačiau, kadangi tas pats monitorius bus naudojamas ir radiologijos technologo darbo vietoje (Techninės specifikacijos 1.1.82 p.), Tiekėjas papildomai pažymėjo tą eilutę, kuri patvirtina ir atitiktį šiam Techninės specifikacijos reikalavimui, kad monitorius būtų didesnis arba lygus 19 colių įstrižainei.

Be to, Tiekėjas atkreipia dėmesį, kad Tiekėjas sutiko su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtino, kad jo pasiūlyta įranga pilnai apima visus Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus (žr. Tiekėjo užpildytą pasiūlymo formą):

„Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, teikdami pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui“

Tarp šių sąlygų yra atitiktis Techninei specifikacijai. Kadangi Techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyta jokių konkrečių reikalavimų nei radiologo kompiuteriui, nei vaizdo plokštei, nei darbo vietos monitoriui, kažkokių didesnės įrodomosios galios dokumentų Tiekėjas šiame Pirkimo etape neteikė.

¹ <https://www.barco.com/en/support/nio-color-3mp-mdnc-3521?facets=documentation-barco-dxp:support/tde/languages/en.documentation-barco-dxp:support/tde/languages/ww>



Vis dėlto, savo prašyme Perkančioji organizacija įpareigojo Tiekėją „pateikti trūkstamus duomenis“, todėl Tiekėjas kartu su šiuo raštu teikia numatytą įrengti vaizdo plokštės bei kompiuterio techninę dokumentaciją. Dar kartą pabrėžiame, kad pasiūlymas šiuo atveju nėra keičiamas – tiek monitorius, tiek vaizdo plokštė, tiek kompiuteris buvo pasiūlyti Tiekėjo pasiūlyme, papildomai pateikiami duomenys tik patvirtina, kad ši įranga buvo pasiūlyta, o jokių jos specifikacijų atitikties Techninei specifikacijai nereikia (ir nereikėjo) įrodyti.

5. Dėl Virtualaus kolimavimo (T₃)

Pirkimo sąlygose nurodyta, kad norint gauti balus už T₃ kokybės kriterijaus parametą tiekėjai turėjo pasiūlyti įrangą su virtualiu kolimavimu. Tiekėjas savo pasiūlymo formoje ties minėtu parametru nurodė „Taip“, t. y., kad siūloma įranga atitinka šį reikalavimą.

Savo prašyme Perkančioji organizacija nurodo, kad „trūksta duomenų pagrindžiančių atitiktį techninio reikalavimo kriterijaus (T) parametrui T₃ „Virtualus kolimavimas“ ir nėra galimybės įsitikinti T₃ parametro atitiktimi“ ir prašė pateikti papildomus duomenis.

Tiekėjas paaiškina, kad sąvoką virtualus kolimavimas, tai programinės įrangos atliekamas veiksmas, kai po rentgeno tyrimo ekspozicijos iš detektoriaus gavus informaciją, ekrane atvaizduojamas tik fiziškai sukolimuotas laukas, t.y. tai kas nebuvo apšviesta rentgeno spinduliais, rentgeno technologui nerodoma.

Jei Perkančioji organizacija T₃ parametre nurodytą virtualų kolimavimą supranta kitaip, tai ji tinkamai to nepaaiškino. Kad iš esmės taip pat supranta virtualų kolimavimą patvirtino ir Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas (kadangi Tiekėjas kreipėsi į gamintoją dėl patvirtinimų kitais klausimais, Tiekėjas gamintojo taip pat paklausė ir dėl virtualaus kolimavimo funkcijos siūlomoje įrangoje).

Bet kuriuo atveju šis reikalavimas yra kokybės kriterijus, todėl jei Perkančioji organizacija nuspręstų, kad Tiekėjo pasiūlymas šio reikalavimo neatitinka (tokio sprendimo pagrindumą ir poreikį jį ginčyti Tiekėjas taip pat vertintų), Tiekėjo pasiūlymas vis tiek turėtų būti traukiamas į pasiūlymų eilę.

Atsižvelgiant į išdėstytą, Tiekėjas Perkančiosios organizacijos **prašo:**

- **Priimti Tiekėjo pasiūlymo paaiškinimus / patikslinimus ir sudarant pasiūlymų eilę į ją traukti ir Tiekėjo pasiūlymą;**

Pridedama:

- Anksčiau teikta techninė dokumentacija atskirai visoje apimtyje;
- Gamintojo raštas / deklaracija;
- Vaizdo plokštės ir kompiuterio techninė dokumentacija.

Pagarbiai

UAB „Kodmeda“ direktorius
Jonas Voluckis

