



2023 m. _____ d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, kurios registruota buveinė yra Vilniuje, Vilniaus g. 33, LT-01506, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės Jurgitos Grebenkovienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. V-43 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“ (2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-33 redakcija), (toliau – **Pirkėjas**),

ir

UAB „Tradintek“, juridinio asmens kodas 124942182, kurio registruota buveinė yra Biržiškų g. 125, Vilnius, veiklos buveinė J. Jasinskio g. 9, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Mickūnaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), laimėjęs 2023 m. balandžio 23 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtą konkursą skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu pirkimas Nr. 666186 (toliau – Pirkimas) pirkti medicinos įrangą, vykdamas investicijų projektą „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ (toliau – investicijų projektas),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, bei trečiasis suinteresuotas asmuo – **Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**, juridinio asmens kodas 124364561, kurių registruota buveinė yra Vilniuje, Santariškių g. 2, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – **Gavėjas**),

sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra prekių skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu Omni Legend 32, gamintojas GE HealthCare (toliau – Prekės) pirkimas-pardavimas, pristatymas, instaliavimas / įdiegimas, personalo apmokymas, kurių kaina nurodyta Sutarties specialiuųjų sąlygų 3.1 papunktyje bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“:

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, CE sertifikatais (arba lygiavertėmis dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodytos Prekės (t. y. Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra nebegaminama arba Prekės negalima įsigyti rinkoje), kitoms Sutarties Šalims ir Gavėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kitą prekę su sąlyga, kad nauja prekė atitiks keliamus reikalavimus, t. y. prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatyta už tą pačią kainą:

1.1.5.1. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui ir Gavėjui apie ketinimą keisti prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.) bei prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokios pat formos ir apimties kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu;

1.1.5.2. Gavėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto, nurodyto šios Sutarties 1.1.5.1 papunktyje, gavimo dienos privalo pateikti Pirkėjui motyvuotą išvadą, o Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo rašto, nurodyto šios Sutarties 1.1.5.1 papunktyje, gavimo dienos privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą, įvertinti Gavėjo pateiktą išvadą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui ir Gavėjui. Šalims ir Gavėjui nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 22 punkte numatyta tvarka. Šalims ir Gavėjui susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių ir Gavėjo susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekės Eil. Nr.	Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas, jų instaliavimas / įdiegimas, personalo apmokymas)
1.	Santariškių g. 2, Vilnius	Per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Gavėjo ir Tiekėjo raštu suderintą grafiką.

1.2.1. Tiekėjas pristatytas, instaliuotas / įdiegtas Prekes perduoda Gavėjui, o Gavėjas kokybiškas Prekes priima. Prekių pristatymo, instaliavimo / įdiegimo bei Gavėjo personalo apmokymo data yra Gavėjo pasirašymo Prekių priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktuose data.

1.2.2. Tiekėjui pristačius Prekes, Gavėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti, o instaliavus Prekes ir apmokius personalą – pasirašyti prekių instaliavimo aktą.

1.2.3. Gavėjas pateikia Pirkėjui Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti kartu su Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktais per 3 (tris) darbo dienas nuo šio akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

1.2.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Gavėją raštu arba el. paštu info@santa.lt apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Gavėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Gavėjas su Tiekėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

1.2.5. Prekes Gavėjas priima tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Gavėjui Sutarties Prekių sąraše ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Gavėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.4. Garantinių įsipareigojimų laikotarpis:

1.4.1. Prekėms Tiekėjas suteikia ne mažiau nei 36 mėnesių garantiją (žr. 2 priedą), skaičiuojamą nuo Prekės instaliavimo akto pasirašymo dienos. Prekių garantinį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti ir Prekių gamintojo sertifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.

1.4.2. Paašikėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, juos pašalinti arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per terminą, nustatytą šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 papunktyje, Prekes pakeisti naujomis. Prekių ar jų dalies taisymo ir / ar keitimo metu Tiekėjas suteikia Gavėjui lygiavertės Prekes ar jų dalis, kuriomis Gavėjas naudojami neatlygintinai.

1.4.3. Jei Prekių trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali Prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 papunktyje nustatytą terminą, Gavėjas raštu ir / ar elektroninėmis priemonėmis informuoja Pirkėją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo dėl Sutarties nutraukimo tiesiogiai patirtų nuostolių atlyginimo.

1.4.4. Garantijos termino metu Tiekėjas nemokamai atlieka Prekių profilaktinę techninę priežiūrą pagal gamintojų reikalavimus, Gavėjui teikia konsultacijas ir paaiškinimus telefonu. Prekių gedimo atveju, kai konsultacijos telefonu neužtenka, atvyksta remontuoti prekes ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie Prekių gedimą gavimo. Nemokamai remontoja arba keičia sugedusias dalis (detales).

1.5. Vykdam Sutartį pasitelkiami šie subtiekejai: Viva Medical, UAB radiofarmacinių preparatų automatinės injekavimo sistemos tiekimui.

1.6. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui ir Gavėjui raštu pranešti tuo metu žinomų subtiekejų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nuroydamas Sutarties dalį, kuri bus perduodama subtiekimui. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją ir Gavėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

1.7. Subtiekimui sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

1.8. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją ir Gavėją dėl subtiekejo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.8.1. subtiekėjas yra bankrutavęs;

1.8.2. subtiekėjas yra likviduojamas;

1.8.3. subtiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

1.8.4. subtiekėjui yra iškelta bankroto byla;

1.8.5. subtiekėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

1.8.6. subtiekėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

1.8.7. subtiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

1.8.8. subtiekėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

1.8.9. subtiekėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

1.8.10. subtiekėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

1.8.11. kitos aplinkybės.

1.9. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją ir Gavėją dėl naujo subtiekejo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.9.1. subtiekejo pasitelkimas pagreitinėtų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Gavėjo personalo apmokymą, kt.;

1.9.2. Sutarties vykdymo metu paašikėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiekėjas;

1.9.3. kitos aplinkybės.

1.10. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją ir Gavėją dėl sutikimo keisti subtiekėją ir / ar pasitelkti naują subtiekėją, privalo nurodyti aplinkybes pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 1.8–1.9 papunkčius, kokiai Sutarties daliai ir

kokius subtiekejus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekęs privalo atitikti visus subtiekejui Pirkimo sąlygų 3 skyriaus 3.10 punkto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

1.11. Gavėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo pateikti Pirkėjui motyvuotą išvadą, o Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą, įvertinti Gavėjo pateiktą išvadą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui ir Gavėjui. Šalims ir Gavėjui nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 22 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių ir Gavėjo susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

1.12. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Gavėjui ir Pirkėjui.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo pateikimo Pirkėjui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) bei galioja 7 (septynis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu. Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir/ar nepasirašius Sutarties, Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

2.2. Šalis ar Gavėjas nėra laikomi atsakingais už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenumatytų (*force majeure*) aplinkybių, kurių Šalys ar Gavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz. teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kurie turėjo poveikį Šalių ir Gavėjo veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. *Force majeure* aplinkybėmis nelaikomos aplinkybės, jeigu Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, neturi valstybės valdymo institucijų išduodamų įgaliojimų, licencijų, leidimo įvažiuoti į Lietuvos Respubliką ar joje gyventi bei kitų dokumentų, kurių reikia Sutarties vykdymui; taip pat aplinkybės, jog rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti priemonių, prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

2.3. Tiekėjas Prekes pristato, jas instaliuoja / įdiegia, personalą apmoko per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinė Sutarties vertė lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), t. y.:

Pradinė Sutarties vertė be PVM 2.999.990,00 (du milijonai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 00 ct) Eur.

PVM 629.997,90 (šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 90ct).

Pradinė Sutarties vertė su PVM 3.629.987,90 (trys milijonai šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 90 ct).

3.2. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina kuri apima visas Sutartyje nurodytas Prekes. Į Prekių kainą įskaitytos visos išlaidos ir mokesčiai bei visos Sutarties įvykdymo išlaidos. Prekių kainų svyravimo riziką prisiima Tiekėjas.

Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame papunktyje nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 1.6 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma keturšalė sutartis tarp Pirkėjo, Gavėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.3. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

3.3.1. Atsiskaitymai atliekami pagal Tiekėjo tinkamai surašytas PVM sąskaitas faktūras ir pasirašytas Prekių priėmimo–perdavimo, Prekių instaliavimo aktus, kai Prekės pristatytos Gavėjui, jos sumontuotos, instaliuotos / įdiegtos bei apmokytas Gavėjo personalas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar lygiavertio dokumento gavimo dienos bei Gavėjui pateikus Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės

sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdanč Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame papunktyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

3.3.2. Mokėjimas atliekamas į šioje Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą, kai Pirkėjas gauna tinkamus dokumentus, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.1. papunktyje.

3.3.3. Tiekėjas negali pateikti sąskaitos faktūros ar lygiavėčio dokumento Pirkėjui mokėjimui anksčiau, nei yra patvirtinamas Prekių perdavimo–priėmimo aktas, Prekių instaliavimo aktas, kiti dokumentai (jei numatyta Sutartyje).

3.3.4. Šalys žino ir supranta, kad ši Sutartis įgyvendinama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, ir aiškiai susitaria bei sutaria, kad tai yra objektyviai pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje.

3.3.5. Mokėjimai atliekami eurais.

3.3.6. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą: Sąskaitos Nr. LT657044060001368083;

Bankas AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo / Subtiekėjo šiame papunktyje nurodytą sąskaitą.

3.4. Sutartyje numatyti Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiamai išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas PVM arba taikoma Sutarties 3.7 papunktyje numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama arba didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.

3.5. Sutarties kaina nedidinama, kai nėra lėšų padidėjusiam PVM tarifui kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai mažinama Sutarties kainos dalis be PVM, kad bendra Sutarties kaina su PVM išliktų nepakitusi.

3.6. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas rašytiniu Šalių ir Gavėjo susitarimu. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo Pirkėjo, Gavėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po kainos perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

3.7. Bet kuri Sutarties šalis ir Gavėjas Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį papunktį dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.8 papunktyje, viršija 10 procentų. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt; <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/>) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (061 MEDICINOS GAMINIAI, APARATAI IR ĮRANGA) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 3.8 papunktyje, yra didesnis kaip 10 procentų. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

Šalys ir Gavėjas privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

3.8. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);

k – Pagal vartotojų kainų indeksą „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}), \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo prekės ir paslaugos“;

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir

vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

3.9. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

3.10. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.11. Sutartyje numatytas įkainių/kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių ir Gavėjo rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.12. Sutartis finansuojama Valstybės biudžeto lėšomis, neviršijant sveikatos apsaugos ministro įsakymu einamiesiems biudžetiniams metams investicijų projekto įgyvendinimui skirtų lėšų.

3.13. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais.	Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.	5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM (181,499.40 (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 40 ct.))	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

4.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.2. Jei Tiekėjas neatlieka įsipareigojimų per Sutarties 2.3. papunktyje nustatytą galutinį terminą, Gavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos šios Sutarties 3.1. papunktyje, už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos su PVM. Pirkėjas turi teisę apskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui apskaičiuotus delspinigius.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos su PVM, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

5.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

5.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį.

5.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Gavėjui Prekę į vietą ir / ar jos neįdiegia (neinstaliuoja) pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 (dvidešimt) procentų Sutarties vertės dydžio baudą.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys ir Gavėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis ar Gavėjas gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ar Gavėjui ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis ar Gavėjas, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Gavėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė			
Adresas			
Telefonas			

<i>Faksas</i>	85 266 1402	85 236 5111	8 5 2496084
<i>El. paštas</i>	ministerija@sam.lt	info@santa.lt	info@tradintek.com

6.2. Jei pasikeičia Šalies ar Gavėjo adresas ir / ar kiti duomenys (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris, nurodytas Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.6 papunktyje), tokia Šalis arba Gavėjas turi informuoti kitą Šalį ir / arba Gavėją pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos. Jei Šaliai ar Gavėjui nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies ar Gavėjo veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Atsakingi asmenys

7.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Gavėjas	Tiekėjas
<i>Vardas, pavardė</i>			
<i>Adresas</i>			
<i>Telefonas</i>			
<i>El. paštas</i>	ministerija@sam.lt	info@santa.lt	info@tradintek.com

7.2. Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Už minėtos informacijos paskelbimą atsakingas asmuo –

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 (trims) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir Gavėjui.

8.3. Šalys ir Gavėjas patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.4.1. 1 priedas. Prekių sąrašas.

8.4.2. 2 priedas. Techninė specifikacija.

8.4.3. 3 priedas. Prekių priėmimo–perdavimo akto forma.

8.4.4. 4 priedas. Prekių instaliavimo akto forma.

8.4.5. 5 priedas. Sutarties įvykdymo garantijos pavyzdinė forma.

8.4.6. 6 priedas. Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma.

Pirkėjo vardu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188603472
A. s. LT81 7300 0100 0245 5511
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Tiekėjo vardu

UAB TRADINTEK
J. Jasinskio g. 9, Vilnius
Įmonės kodas 124942182
A. s. Nr. LT657044060001368083
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Gavėjo vardu:

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Jurgita Grebenkovienė

A.V.

Tomas Mickūnaitis

A.V.



Feliksas Jankevičius

[Redacted signature area]



23-C-2096 2023-07-03

1 priedas
prie 2023 m. d. viešojo pirkimo-pardavimo Sutarties Nr.

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir modelis	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1	Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu Omni Legend 32, gamintojas GE HealthCare	Kompl.	1	2999990,00	3629987,90	21	629997,90	2999990,00	3629987,90
Bendra Sutarties kaina Eur							629997,90	2999990,00	3629987,90

Pirkėjo vardu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188603472
A. s. LT81 7300 0100 0245 5511
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Tiekėjo vardu

UAB TRADINTEK
J. Jasinskio g. 9, Vilnius
Įmonės kodas 124942182
A. s. Nr. LT657044060001368083
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Gavėjo vardu:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000


Jurgita Grebenkovienė

A.V.

Tomas Mickūnaitis

A.V.

Peliksas Jankevičius





23-C-2096 2023-07-03

prie 2023 m. d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. 2 priedas

Techninė specifikacija pridėta Excel faile



3 priedas

prie 20.... m. d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr.

(Prekių perdavimo–priėmimo akto forma)
Prekių priėmimo–perdavimo aktas

[Akto sudarymo vieta ir data]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 188603472, registruotos Vilniuje, Vilniaus g. 33, LT-01506, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Pirkėjas**) įgaliota **Viešoji įstaiga** *[pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurios registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – **Gavėjas**),

ir *[teisinė forma, pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurio registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, veiklos buveinė *[miestas, adresas]* *[pildoma, jei nesutampa su registruota buveine]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal *[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo]* (toliau – **Tiekėjas**)

remiantis *[Sutarties sudarymo data]* sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi *[Sutarties numeris]*, sudarė šį Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

1. **Tiekėjas** perduoda **Gavėjui** Prekes *[prekių pavadinimas, modelis, gamintojas, mato vnt., kiekis, kaina, bendra suma]*, o **Gavėjas** šias Prekes priima.

2. Už Prekes **Pirkėjas** įsipareigoja sumokėti **Tiekėjui** *[suma skaičiais ir žodžiais]* eurų Šalių ir Gavėjo sudarytoje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

3. Prekės pristatytos, atitinka *[sutarties sudarymo data]* sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties *[sutarties numeris]* techninės specifikacijos reikalavimus.

4. **Gavėjas** neturi **Tiekėjui** pretenzijų dėl Prekių komplektiškumo ir kokybės.

5. Šis aktas sudarytas 3 (trimis) egzemplioriais (po vieną **Tiekėjui**, **Gavėjui** ir **Pirkėjui**), kurie turi vienodą juridinę galią.

Gavėjo vardu priėmė:

Tiekėjo vardu perdavė:

[vardas, pavardė, parašas]

[vardas, pavardė, parašas]

A.V.

A.V.



23-C-2096 2023-07-03

4 priedas

prie 20.... m. d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr.

(Prekių instaliavimo akto forma)

Prekių instaliavimo aktas

[Akto sudarymo vieta ir data]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 188603472, registruotos Vilniuje, Vilniaus g. 33, LT-01506, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Pirkėjas**) įgaliota **Viešojo įstaiga** *[pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurios registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – **Gavėjas**),

ir *[teisinė forma, pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurio registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, veiklos buveinė *[miestas, adresas]* *[pildoma, jei nesutampa su registruota buveine]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal *[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo]* (toliau – **Tiekėjas**)

remiantis *[Sutarties sudarymo data]* sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi *[Sutarties numeris]*, sudarė šį Prekių instaliavimo aktą:

1. Prekės pagal *[sutarties sudarymo data]* sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties *[sutarties numeris]* sąlygas, suinstaliuotos / įdiegtos, apmokytas personalas, pateikti visi reikalingi dokumentai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

2. Už Prekes **Pirkėjas** įsipareigoja sumokėti **Tiekėjui** *[suma skaičiais ir žodžiais]* eurų Šalių ir Gavėjo sudarytoje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

3. **Gavėjas** neturi **Tiekėjui** pretenzijų dėl Prekių komplektiškumo ir kokybės.

4. Šis aktas sudarytas 3 (trimis) egzemplioriais (po vieną **Tiekėjui**, **Gavėjui** ir **Pirkėjui**), kurie turi vienodą juridinę galią.

Gavėjo vardu priėmė:

Tiekėjo vardu perdavė:

[vardas, pavardė, parašas]

[vardas, pavardė, parašas]

A.V.

A.V.



5 priedas

prie 20.... m. d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr.

(Sutarties įvykdymo garantijos pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

Juridinio asmens kodas 188603472

Buveinės adresas Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

20.... m. . _____ d.
(sudarymo vieta)

Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas), pranešė, kad 20__m. _____d. sudarė sutartį Nr. _____ su **Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija** (toliau – Garantijos gavėjas) ir [projekto vykdytojo pavadinimas] dėl [investicijų projekto pavadinimas] prekių pirkimo.

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____ patvirtinanti, kad Klientas neįvykdė (sutarties data) sutarties Nr. _____ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (garantijos išdavimo data).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo);

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

_____ filialas
(Garanto pavadinimas)

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)



23-C-2096 2023-07-03

6 priedas

prie 20.... m. d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr.

(Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO
LIUDIJIMU (POLISU))

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. *(įrašykite draudimo sutarties numerį)*.

Šiuo laidavimo raštu klientas *(įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą)* ir Laiduotojas *(įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą)*, (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai įsipareigoja **Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai** (toliau – Perkančioji organizacija) *(įrašykite laidavimo sumą skaičiais)* *(įrašykite sumą žodžiais)* suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal sutartį su Perkančiąja organizacija ir įgaliotąja organizacija [projekto vykdytojo pavadinimas], įsipareigojo parduoti *[investicijų projekto pavadinimas]* prekes Perkančiajai organizacijai, TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki *(metai)*, *(mėnuo)*, *(diena)*. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

**BENDROSIOS SĄLYGOS****1. Pagrindinės Sutarties sąvokos**

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančiosios organizacijos sąvoka atitinkanti valstybės biudžetinė įstaiga, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Gavėjas – viešasis juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl investicinių lėšų, skirtų einamaisiais metais investicijų projektui įgyvendinti, panaudojimo, gaunantis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.3. Kaina – už Prekes pagal Sutartį Tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Tiekėjo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

1.4. Įkainis – prekės mato vieneto kaina.

1.5. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.6. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatomos Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos viso pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos visas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir instaliuoti, įdiegti, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamus reikalavimus;

3.1.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktų pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir Gavėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo ir Gavėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui ir Gavėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo ir Gavėjo gautus, Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo ir Gavėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodant, kokios Prekės buvo pristatytos, ir kitą su Prekių tiekimu susijusią informaciją;

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Gavėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, bei konsultuoti Gavėją kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo ir Gavėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo ir Gavėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui ir Gavėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.10. jei Tiekėjas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui planuoja pasitelkti subtiekęją (-us), Tiekėjas atsako už savo subtiekęjų veiksmus ar neveikimą. Subtiekęjo pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį;

3.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už kokybiškas, tinkamas ir laiku pateiktas Prekes, kai jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. sumokėti Tiekėjui už tinkamai, kokybiškas ir laiku pristatytas prekes (suteiktas paslaugas: prekių instaliavimas, personalo apmokymas) Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.2. Gavėjui pateikus prašymą dėl pristatytų Prekių perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudą, perduoti jam panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Prekes;

4.1.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Gavėjo teisės ir pareigos

5.1. Gavėjas įsipareigoja:

5.1.1. priimti su Tiekėju sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

5.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo, instaliavimo / įdiegimo, personalo apmokymo ir / ar kita, pasirašyti Prekių gavimo dokumentus (Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktus, bei (jei reikia) kitus dokumentus);

5.1.3. suteikti Pirkėjui ir Tiekėjui informaciją raštu ir žodžiu ir / ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.1.4. nedelsiant informuoti Pirkėją apie bet kokius nukrypimus ir / ar aplinkybes galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

5.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

5.1.6. pateikti Pirkėjui prašymą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktų pasirašymo dėl įgytų Prekių perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudą.

5.2. Gavėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

6.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas, Pradinė Sutarties vertė, kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

6.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1. transportavimo išlaidas;

6.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

6.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas ir Gavėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

6.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir instaliavimo bei priežiūros išlaidas;

6.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / ar priežiūrai, išlaidas;

6.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

6.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas;

6.2.8. Gavėjo personalo mokymus;

6.2.9. kitas būtinas išlaidas, be kurių negalima būtų sėkmingai įvykdyti Sutarties.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais). Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo tinkamai patvirtintą kopiją Tiekėjas pateikia Gavėjui.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, sumokėtos netesybos, atsiradę Tiekėjui pažeidus Sutartį.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei per visą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

7.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Gavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją per 3 (tris) darbo dienas ir Pirkėjas pareikalauja iš garanto / laiduotojo sumokėti visą sumą ar jos dalį

priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Sutarties įvykdymo datos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

8. Prekių tiekimo grafikas

8.1. Atskiru Tiekėjo ir Gavėjo susitarimu dėl atskirų Prekių tiekimo gali būti sudaromas Prekių tiekimo grafikas, nepažeidžiant Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytų Prekių pristatymo terminų.

9. Prekių tiekimo terminai ir vieta

9.1. Prekės pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Gavėjo adresu.

9.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

10. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

10.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Gavėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalio aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.

10.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Gavėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

11. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

11.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

11.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Gavėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Gavėjas pažeidė Prekių naudojimo ir / ar daiktų saugojimo taisykles, Gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo ir / ar Gavėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

11.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra 36 mėnesiai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėmis ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių, ar jų dalių perdavimo Gavėjui dienos.

12. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

12.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos. Iki Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktų pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 papunktyje nustatytus kokybės reikalavimus bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

12.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

12.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Gavėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis taip pat, prireikus, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

12.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktų pasirašymo. Gavėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktus, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

12.6. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Gavėją dėl Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktų pasirašymo. Gavėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktus arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktus, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktai būtų pasirašyti. Prekių priėmimo–perdavimo ir Prekių instaliavimo aktai pasirašomas 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

13. Šalių ir Gavėjo atsakomybė

13.1. Šalių ir Gavėjo atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalis ir Gavėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies ar Gavėjo priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

13.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių ir Gavėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

14.1. Šalis ar Gavėjas nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis ar Gavėjas įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kurie turėjo poveikį Šalių ar Gavėjo veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamas nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis ir Gavėjas vadovaujasi Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis ir Gavėjas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. *Force majeure* aplinkybėmis nelaikomos aplinkybės, jeigu Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, neturi valstybės valdymo institucijų išduodamų įgaliojimų, licencijų, leidimo įvažiuoti į Lietuvos Respubliką ar joje gyventi bei kitų dokumentų, kurių reikia Sutarčiai vykdyti; taip pat aplinkybės, jog rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti priemonių, prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

14.2. Šalis ar Gavėjas, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai ar Gavėjui raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat turi pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

14.3. Pagrindas atleisti Šalį ar Gavėją nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis ar Gavėjas laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai ar Gavėjui žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

15. Šalių pareiškimai ir garantijos

15.1. Kiekviena iš Šalių ir Gavėjas pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai ir Gavėjui, kad:

15.1.1. Šalis ir Gavėjas yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

15.1.2. Šalis ir Gavėjas atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

15.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis ir Gavėjas neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

15.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai ir Gavėjui galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalis ir Gavėjas sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalis gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies ir Gavėjo rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

17. Sutarties galiojimas

17.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

17.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

17.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių ir Gavėjo pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

18. Sutarties pakeitimai

18.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

18.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis ar Gavėjas, inicijuojantis Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai ir Gavėjui motyvuotą raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas, nurodydamas: 1) Sutarties ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs prekių pavadinimai, vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) ir kt.; 4) Kaina, apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis ar Gavėjas motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip). Šalims ir Gavėjui nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims ir Gavėjui tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

19. Sutarties pažeidimas

19.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis ar Gavėjas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, ji pažeidžia Sutartį.

19.2. Vienai Sutarties Šaliai ar Gavėjui pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis ar Gavėjas turi teisę:

19.2.1. reikalauti kitos Šalies ar Gavėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

19.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

19.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

19.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

19.2.5. nutraukti Sutartį;

19.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

20. Sutarties vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas

20.1. Esant nenumatytoms objektyvioms nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, galimas Prekių pristatymo sutartu laiku ir / ar į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimo atidėjimas (toliau – Sutarties vykdymo sustabdymas). Sutarties vykdymas sustabdomas Specialiųjų sąlygų 2.4 papunktyje nustatytais atvejais ir tvarka.

20.2. Jei Sutarties Šalis ar Gavėjas nusprendžia turįs teisę Sutarties atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti kitą Šalį ir Gavėją:

20.2.1. Šalis ar Gavėjas, gavę tokį Sutarties bendrųjų sąlygų 20.2 papunktyje nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą ir priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai ir Gavėjui. Šalims ir Gavėjui nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 22 punkte numatyta tvarka. Šalims ir Gavėjui susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių ir Gavėjo susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

20.3. Sutarties vykdymo terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, gali būti pratęsiamas tam Sutarties vykdymo terminui, kuris buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

20.4. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Gavėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

20.5. Dėl Gavėjo kaltės patirtos saugojimo priemonių taikymo išlaidos padengiamos Gavėjo lėšomis. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas dėl šių priežasčių: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo ir / ar Gavėjo veiksmų ar neveikimo.

21. Sutarties nutraukimas

21.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių ir Gavėjo susitarimu arba vienos iš Šalių ar Gavėjo valia.

21.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

21.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

- 21.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 21.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
- 21.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
- 21.2.5. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
- 21.2.6. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 21.2.7. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio reikalavimus;
- 21.2.8. Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
- 21.2.9. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
- 21.2.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
- 21.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 21.5 papunktyje nustatytų terminų:
- 21.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
- 21.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.
- 21.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą kai Pirkėjas ir (ar) Gavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas ir (ar) Gavėjas;
- 21.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 21.6. Nutraukdamas Sutartį:
- 21.6.1. Pirkėjas, dalyvaujant Gavėjui ir Tiekėjui ar jų atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą;
- 21.6.2. parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui;
- 21.6.3. Taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. 4 p.

22. Ginčų nagrinėjimo tvarka

- 22.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 22.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių ir Gavėjo dėl šios Sutarties, sprendžiami Šalių ir Gavėjo derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis ar Gavėjas pateikė prašymą raštu kitai Šaliai ar Gavėjui su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims ir Gavėjui nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių ir Gavėjo susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

23. Asmens duomenų apsauga

- 23.1. Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi asmens duomenys.
- 23.2. Šalys įsipareigoja:
- 23.2.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;
- 23.2.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
- 23.2.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą;
- 23.2.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;

23.2.5. tinkamai informuoti visus fizinius asmenis, kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.

24. Baigiamosios nuostatos

24.1. Nė viena Šalis ir Gavėjas neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies ir Gavėjo sutikimo.

24.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių ir Gavėjo nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

24.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

24.4. Šalys ir Gavėjas patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

Pirkėjo vardu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188603472
A. s. LT81 7300 0100 0245 5511
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Tiekėjo vardu

UAB TRADINTEK
J. Jasinskio g. 9, Vilnius
Įmonės kodas 124942182
A. s. Nr. LT657044060001368083
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Gavėjo vardu:

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000


Jurgita Grebenkovienė

A.V.

Tomas Mickūnaitis

A.V.

Feliksas Jankevičius





23-C-2096 2023-07-03

1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu - 1 vnt.

Tiekėjo pasiūlymas:

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrai reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis dokumentas, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas	Nurodyti	Omni Legend 32 cm modelio PET /KT sistema, gamintojas GE HealthCare (Techninis aprašas.pdf - 3 psl.)
2.	Reikalaujami skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemai su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/CT)		
2.1	Pozitronų emisijos tomografijos aparatas ir kompiuterinės tomografijos aparatas prijungti į vieną sistemą	Būtina	Pozitronų emisijos tomografijos aparatas ir kompiuterinės tomografijos aparatas prijungti į vieną sistemą (Techninis aprašas.pdf - 44 psl.)
2.2	Galimybė atlikti KT tyrimus be PET tyrimo	Būtina	Galima atlikti KT tyrimus be PET tyrimo (Techninis aprašas.pdf - 48, 361 psl.)
3.	Reikalaujami skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemai		
3.1	Ašinis detektoriaus vaizdo matymo laukas	≥ 26 cm	32 cm (Techninis aprašas.pdf - 3 psl.)
3.2	PET skersinis matymo laukas	≥ 70 cm	70 cm (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.3	Skaitmeninės technologijos PET detektorių sistema, naudojami: SiPM (angl. solid-state silicon photomultiplier), dSiMP (angl. digital solid-state silicon photomultiplier), DPC (angl. Digital-Photon-Counting) ar analogiška technologija	Būtina	Skaitmeninės technologijos PET detektorių sistema, naudojami dSiMP su SiPM technologiją (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.4	Sistemos jautrumas (pagal NEMA NU 2-2018 arba lygiavertį standartą)	≥ 16 cps/kBq	46 cps/kBq (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.5	Ašinė skyla, iki 10 cm nuo centro (pagal NEMA NU 2-2018 standartą naudojant filtruotą atgalinę projekciją (angl. Filtered Back Projection) arba alternatyvius rekonstrukcijos algoritmus (angl. alternate reconstruction algorithms))	≤ 4.5 mm	3.0 mm (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.6	Ašinė skyla, iki 1 cm nuo centro (pagal NEMA NU 2-2018 standartą naudojant filtruotą atgalinę projekciją (angl. Filtered Back Projection) arba alternatyvius rekonstrukcijos algoritmus (angl. alternate reconstruction algorithms))	≤ 4 mm	2.5 mm (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.7	Skersinė skyla, iki 1 cm nuo centro (pagal NEMA NU 2-2018 standartą naudojant filtruotą atgalinę projekciją (angl. Filtered Back Projection) arba alternatyvius rekonstrukcijos algoritmus (angl. alternate reconstruction algorithms))	≤ 4 mm	1.4 mm (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.8	Skersinė skyla, iki 10 cm nuo centro (pagal NEMA NU 2-2018 standartą naudojant filtruotą atgalinę projekciją (angl. Filtered Back Projection) arba alternatyvius rekonstrukcijos algoritmus (angl. alternate reconstruction algorithms))	≤ 4.5 mm	1.5 mm (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.9	Išbarstymo frakcija (pagal NEMA NU 2-2018 arba lygiavertį standartą)	≤ 41%	35% (Techninis aprašas.pdf - 8 psl.)
3.10	EKG strobavimo (angl. ECG gating) režimas PET sistemai	Būtina	Yra EKG strobavimo režimas PET sistemai (Techninis aprašas.pdf - 116, 746 psl.)
3.11	Kvėpavimo sukeltų judesio artefaktų šalinimo PET tyrimuose įranga (nenaudojanti jokių išorinių įrenginių jungiamų ar tvirtinamų prie paciento)	Būtina	Kvėpavimo sukeltų judesio artefaktų šalinimo PET tyrimuose įranga, nenaudojanti jokių išorinių jungiamų ar tvirtinamų prie paciento įrenginių (Techninis aprašas.pdf - 4)
3.12	PET kokybės kontrolės priemonės	3.12.1. Visos reikalingos priemonės, kurias numato gamintojas rutininiams (kasdieniams ir periodiniams) kokybės kontrolės atlikimui ir kalibraciniai šaltiniai reikalingi PET įrangos techninei priežiūrai 3.12.2. NEMA imaging IQ fantomas (angl. IEC image quality phantom) su užpildomomis iš fantomo išorės (neatidarant) sferomis 3.12.3. SUV fantomas	Visos reikalingos priemonės, kurias numato gamintojas rutininiams (kasdieniams ir periodiniams) kokybės kontrolės atlikimui ir kalibraciniai šaltiniai reikalingi PET įrangos techninei priežiūrai (Techninis aprašas.pdf - 264 psl.) NEMA fantomas vaizdo kokybei patikrinti su užpildomomis iš fantomo išorės (neatidarant) sferomis įtrauktas į pasiūlymo kainą (Techninis aprašas.pdf - 749 psl.) SUV fantomas įtrauktas į pasiūlymo kainą (Techninis aprašas.pdf - 264, 299 psl.)
3.13	Maksimalus PET/CT skenavimo diapazonas	≥ 1950 mm	2000 mm (Techninis aprašas.pdf - 21 psl.)
4.	Reikalaujami rentgeno kompiuterinės tomografijos sistemai		
4.1	Paskirtis	Viso žmogaus kūno tyrimams	Viso žmogaus kūno tyrimams (Techninis aprašas.pdf - 48 psl.)
4.2	Pagrindiniai skenavimo režimai	4.2.1. Spiralinis skenavimas, 4.2.2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas, 4.2.3. Topogramas	Spiralinis skenavimas (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.) Daugiapjūvis ašinis skenavimas (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.) Topogramas (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.)
4.3	Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu	≥ 64	64 nuskaitomi pjūviai, 443 rekonstruojami pjūviai (Techninis aprašas.pdf - 17 psl.)
4.4	Efektus detektorių matricos plotis izocentre z-šies kryptimi (išilginis)	≥ 38 mm	40 mm (Techninis aprašas.pdf - 17 psl.)
4.6	Skenavimo angos diametras	≥ 700 mm	700 mm (Techninis aprašas.pdf - 101 psl.)
4.7	Skenavimo apšvitulos laukas (angl. SFOV)	≥ 500 mm	500 mm (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.)
4.8	Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas	≤ 0.35 sek.	0.35 sek. (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.)
4.9	Sistemos generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką)	≥ 70 kW	72 kW (Techninis aprašas.pdf - 16, 743 psl.)
4.10	Generatoriaus įtampos diapazonas	≥ (80-140) kV	Nuo 80 iki 140 kV (Techninis aprašas.pdf - 743 psl.)
4.11	Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 20 iki 600 mA	Nuo 10 iki 600 mA (Techninis aprašas.pdf - 16, 743 psl.)
4.12	Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis	≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui	2 fokuso taškai (Techninis aprašas.pdf - 16 psl.)
4.13	Paciento apšvitą mažinančios technologijos	4.13.1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė, 4.13.2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti,	Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė (Techninis aprašas.pdf - 12 psl.) Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Techninis aprašas.pdf - 9 psl.)
4.14	Algoritmai metalinių implantų sukeliami artefaktams sumažinti	Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeliami artefaktams sumažinti	Sistema turi algoritmus metalinių implantų sukeliami artefaktams sumažinti (Techninis aprašas.pdf - 11 psl.)
4.15	Tyrimų apdorojimo programinė įranga	Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaploktuminių rekonstrukcijų programos	Yra trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaploktuminių rekonstrukcijų programos (Techninis aprašas.pdf - 516, 197, 198 psl.)

4.16	Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys	Būtina	Yra dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys (Techninis aprašas.pdf - 156, 157, 158 psl.)
4.17	KT kokybės kontrolės priemonės	KT fantomas arba fantomai reikalingi sistemos patikrai	KT fantomas sistemos patikrai yra įtrauktas į pasiūlymo kainą (Techninis aprašas.pdf - 261 psl.)
5.	Technologo valdymo konsolė su programine įranga:	5.1. Programinė įranga siūlomos sistemos valdymui.	Yra programinė įranga siūlomos sistemos valdymui (Techninis aprašas.pdf - 160 psl.)
		5.2. Greitų vaizdų peržiūra.	Yra įranga greitų vaizdų peržiūrai (Techninis aprašas.pdf - 193 psl.)
		5.3. Vaizdo monitoriaus įstrižainė $\geq 19"$.	Du 19" įstrižainės vaizdo monitoriai (Techninis aprašas.pdf - 154, 155, 156 psl.)
		5.4. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus.	Gamintojo parinktas ir sukomplektuotas sistemos kompiuteris įtrauktas į komplektą (Techninis aprašas.pdf - 154 psl.)
		5.5. Nepertraukiamas el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą ≥ 10 min.	Nepertraukiamas el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą > 10 min įtrauktas į pasiūlymo kainą. (Techninis aprašas.pdf - 154 psl.)
		5.6. DICOM funkcionalumai (arba lygiavertiai):	
		5.6.1 Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print.	Yra vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print (Techninis aprašas.pdf - 22 psl.)
		5.6.2 Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send).	Yra informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send) (Techninis aprašas.pdf - 22 psl.)
		5.6.3 Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist.	Yra Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist (Techninis aprašas.pdf - 22 psl.)
		5.6.4 Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report.	Yra apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Structured Dose Report (Techninis aprašas.pdf - 13 psl.)
6.	Komplekte su PET/CT aparatu patiekiami priedai	6.1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu).	Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu) yra įtraukta į pasiūlymo kainą (Techninis aprašas.pdf - 887 psl.)
		6.2. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės.	Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės įtrauktos į pasiūlymo kainą (Techninis aprašas.pdf - 78 psl.)
7.	Reikalingi kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatiniai ir programiniai įrangai vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)		
7.1	Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai	7.1.1. Trimatį paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaploktuminių rekonstrukcijų programos (su galimybe naudoti 5-ioje darbo vietose vienu metu).	Trimatį paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaploktuminių rekonstrukcijų programos (su galimybe naudoti 5-ioje darbo vietose vienu metu) (Techninis aprašas.pdf - 742, 751, 753 psl.)
		7.1.2. Programinė įranga, skirta 3D tyrimų automatiniam koregistravimui ir pokyčių parenchiminuose organuose, įskaitant kepenis ir limfmazgius, pateikimui su automatinio navigavimu pagal RECIST 1.1 (ar analogišką) klasifikatorių (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu).	Į pasiūlymo kainą įtraukta programinė įranga, skirta 3D tyrimų automatiniam koregistravimui ir pokyčių parenchiminuose organuose, įskaitant kepenis ir limfmazgius, pateikimui su automatinio navigavimu pagal RECIST 1.1 klasifikatorių (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu). (Techninis aprašas.pdf - 742, 753, 781 psl.)
		7.1.3. Onkologinių tyrimų paketas, apimanis kiekvįnį SUV įvertinimą, bendrą naviko gliukozę, bendrąjį aktyvumą, atsako į gydymą įvertinimą pagal PERCIST (arba analogišką) klasifikatorių (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu).	Į pasiūlymo kainą įtrauktas onkologinių tyrimų paketas, apimanis kiekvįnį SUV įvertinimą, bendrą naviko gliukozę, bendrąjį aktyvumą, atsako į gydymą įvertinimą pagal PERCIST klasifikatorių (su galimybe naudoti 2-se darbo vietose vienu metu). (Techninis aprašas.pdf - 742, 754, 800, 852 psl.)
		7.1.4. Programinė įranga limfmazgių pokyčių PET tyrimuose klasifikacijai pagal Deauville (arba analogišką) klasifikatorių (su galimybe naudoti 2-se darbo vietose vienu metu).	Į pasiūlymo kainą įtraukta programinė įranga limfmazgių pokyčių PET tyrimuose klasifikacijai pagal Deauville klasifikatorių (su galimybe naudoti 2-se darbo vietose vienu metu). (Techninis aprašas.pdf - 742, 754, 755, 800 psl.)
		7.1.5. Neurologinis paketas automatizuotai PET tyrimų analizei, apimanis FDG normalizavimo duomenų bazes ir 3D galvos smegenų rekonstrukcijas (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu).	Į pasiūlymo kainą įtrauktas neurologinis paketas automatizuotai PET tyrimų analizei, apimanis FDG normalizavimo duomenų bazes ir 3D galvos smegenų rekonstrukcijas (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu). (Techninis aprašas.pdf - 742, 756 psl.)
		7.1.6. Kardiologinis programinės įrangos paketas PET / KT tyrimo miokardo gyvybingumo vertinimui (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu).	Į pasiūlymo kainą įtrauktas kardiologinės programinės įrangos paketas PET / KT tyrimo miokardo gyvybingumo vertinimui (su galimybe naudoti 1-je darbo vietoje vienu metu) (Techninis aprašas.pdf - 742, 755 psl.)
		7.1.7. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 5 vnt. (3 realios darbo vietos su technine įranga ir ≥ 2 virtualios darbo vietos). Turi būti numatytas ir pateiktas toks sprendinys (licencijos, programinės įrangos paketai ar pan.), kuris leistų prie virtualių darbo vietų, jungtis iš ne mažiau kaip 8 (aštuonių) kompiuterinių darbo vietų.	Į pasiūlymo kainą įtrauktos 5 konkurencinių darbo vietų licencijos. (3 realios darbo vietos su technine įranga ir 2 virtualios darbo vietos). Numatytas ir bus pateiktas toks sprendinys (licencijos, programinės įrangos paketai ar pan.), kuris leis prie virtualių darbo vietų, jungtis iš 8 (aštuonių) kompiuterinių darbo vietų. (Techninis aprašas.pdf - 742, 751 psl.)
7.2	Tarnybinė stotis (centrinis serveris)	1. Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus. Serveris turi būti komplektuojamas su operacine sistema (OS), kuri turi būti suderinama su radiologinių vaizdų peržiūra ir diagnostikos programine įranga (pateikiama OS licencija).	Serverio techniniai parametrai atitinka rekomenduojamus programinės įrangos parametrus. Serveris komplektuojamas su operacine sistema (OS), kuri suderinama su radiologinių vaizdų peržiūra ir diagnostikos programine įranga (pateikiama OS licencija). (Techninis aprašas.pdf - 752, 995 psl.)
		2. Maitinimo šaltiniai ir ausinuvai:	
		2.1 Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius ir ausinuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. Maitinimo šaltiniai keičiami nestabdant veikiančio serverio (angl. „hot plug“).	Tarnybinė stotis turi dubliuotus maitinimo šaltinius ir ausinuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. Maitinimo šaltiniai keičiami nestabdant veikiančio serverio (angl. „hot plug“). (Techninis aprašas.pdf - 992, 995 psl.)
		3. Nuotolinio valdymo adapteris:	
		3.1 Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų.	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. (Techninis aprašas.pdf - 990, 992, 1000, 1001 psl.)
		3.2 Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą.	Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą. (Techninis aprašas.pdf - 1003, 1004, 1016 psl.)
		3.3 Tarnybinės stoties nuotolės valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos.	Tarnybinės stoties nuotolės valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos. (Techninis aprašas.pdf - 1012 psl.)
		3.4 Tekstinė ir grafinė konsolė; Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas.	Yra tekstinė ir grafinė konsolės; Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. (Techninis aprašas.pdf - 1012, 1017, 1021 psl.)
		3.5 Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvines atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas, automatinis pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.	Yra aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvines atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas, automatinis pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. (Techninis aprašas.pdf - 1014 psl.)
		3.6 Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas.	Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. (Techninis aprašas.pdf - 1017 psl.)
		4. Tinklo sąsajos ir priedai:	
		4.1 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10G SFP+ tipo jungtis Multimode optikai.	Serveris komplektuojamas su 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10G SFP+ tipo jungtis Multimode optikai. (Techninis aprašas.pdf - 995 psl.)
		4.2 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais (diegiami į perkamą serverį).	Serveris komplektuojamas 2-ju portų 10G Multimode SFP+ moduliu (diegiama į perkamą serverį). (Techninis aprašas.pdf - 995, 1032 psl.)
		4.2 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis).	Serveris komplektuojamas su 2 vnt. 15m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis). (Techninis aprašas.pdf - 995 psl.)

		4.3 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco gamintojo tinklo įrangą). (Techninis aprašas.pdf - 995, 1035, 1037 psl.) 4.4 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu skirtu serverio valdymui (angl. management port). (Techninis aprašas.pdf - 1013 psl.) 5. Diskų RAID valdiklis: 5.1 Diskų apjungimo valdiklis, palaikantis RAID 1,5,6,10 diskų apjungimo tipus. Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 4GB spartinančiosios atminties, išsaugančios duomenis elektros dingimo atveju. (Techninis aprašas.pdf - 1041, 1042 psl.) 6. Korpusas ir montavimas: 6.1 Optimuota montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkinė). (Techninis aprašas.pdf - 990 psl.) 7. Rezervinis maitinimas: 7.1 Serveris komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu serverio darbą ne mažiau kaip 30 min., dingus elektrai. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti tinkamas montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi turėti nuotolinio valdymo ir būsenos stebėjimo naudojantis Ethernet kompiuteriniu tinklu funkciją. Nuotoliniu būdu iš standartinio kompiuterio turi būti galima stebėti maitinimo šaltinio darbą: įėjimo/išėjimo įtampą/srovę, baterijų įkrovimo lygį, sisteminio gedimo būseną (jei gamintojo yra numatyta, turi būti pateikta šiai funkcijai atlikti reikalinga programinė įranga su licencijomis, bent vienam kompiuteriui). (Techninis aprašas.pdf - 1052, 1080, 1094, 1095, 1171, 1172 psl.) 8. Surinkimo reikalavimai ir komplektacija: 8.1 Turi būti pateiktos visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai ir pan.). Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neįskaitomi. Visos komplektuojamosios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamybiniais kodais. (Techninis aprašas.pdf - 1344 psl.)	Serveris komplektuojamas su 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco gamintojo tinklo įrangą). (Techninis aprašas.pdf - 995, 1035, 1037 psl.) Serveris komplektuojamas su 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu skirtu serverio valdymui. (Techninis aprašas.pdf - 1013 psl.) Disių apjungimo valdiklis, palaikantis RAID 1,5,6,10 diskų apjungimo tipus. Valdiklis turi 4GB spartinančiosios atminties, išsaugančios duomenis elektros dingimo atveju. (Techninis aprašas.pdf - 1041, 1042 psl.) Optimuota montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkinė įranka) (į pasiūlymo kainą). (Techninis aprašas.pdf - 990 psl.) Serveris komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu serverio darbą 48 min., dingus elektrai. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis tinkamas montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi nuotolinio valdymo ir būsenos stebėjimo naudojantis Ethernet kompiuteriniu tinklu funkciją. Nuotoliniu būdu iš standartinio kompiuterio galima stebėti maitinimo šaltinio darbą: įėjimo/išėjimo įtampą/srovę, baterijų įkrovimo lygį, sisteminio gedimo būseną (į pasiūlymą įtraukta ir bus pateikta šiai funkcijai atlikti reikalinga programinė įranga su licencijomis vienam kompiuteriui). (Techninis aprašas.pdf - 1052, 1080, 1094, 1095, 1171, 1172 psl.) Patvirtiname, kad bus pateiktos visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai ir pan.). Siūloma įranga nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neįskaitomi. Visos komplektuojamosios tarnybinės stoties dalys komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamybiniais kodais. (Techninis aprašas.pdf - 1344 psl.)
7.3	Radiologo darbo vietos kompiuteris	1. Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio pavadinimą ir modelį (gamintojo suteiktą kodą). (Techninis aprašas.pdf - 1344 psl.) 2. Kompiuterio komplektacija: stalinis kompiuteris su dedikuota vaizdo plokšte(-ėmis), kuri turi užtikrinti ne mažiau kaip trijų monitorių prijungimą vienu metu. Komplektuojamas su USB laidine pele ir USB laidine klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu. Pastaba: reikalingai dedikuoti vaizdo plokštėi detalizuoti punkte 7.6, klaviatūrai punkte 7.3.11, pelei punkte 7.3.12). (Techninis aprašas.pdf - 1344 - 1417 psl.) 3. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 30000 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. (Techninis aprašas.pdf - 1344 psl.) 4. Procesorius turi būti suderinamas su ne mažesne nei Windows 10 Pro arba lygiaverte operacine sistema. (Techninis aprašas.pdf - 1355, 1356 psl.) 5. Atmintinė - ne mažiau 16 GB. (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.) 6. Standžiojo disko talpa ne mažesnė kaip 512 GB (turi būti nurodyta disko talpa). (Techninis aprašas.pdf - 1384, 1400 psl.) 7. Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe arba lygiavertė. (Techninis aprašas.pdf - 1350, 1384 psl.) 8. Vidinis DVD įrenginys. (Techninis aprašas.pdf - 1400, 1344 psl.) 9. Ne mažiau kaip 6 vnt. USB, ne mažesni nei 3.0 tipo, iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. korpuso priekyje. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1345 psl.) 10. Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėti dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1 000 Mbps. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1395 psl.) 11. USB kabeliu prijungiama klaviatūra su integruotu SmartCard (arba lygiaverti) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiaverti), kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard/ US English layout išdėstymą. (Techninis aprašas.pdf - 1407 psl.) 12. USB kabeliu prijungiama lazerinė pele su ratuku. (Techninis aprašas.pdf - 1412, 1413 psl.) 13. Kompiuteris turi turėti lizdą arba lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1345 psl.) 14. Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius) arba pateikiamas išorines garsiakalbis. (Techninis aprašas.pdf - 1370 psl.) 15. Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raška ne blogesnė nei Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas. (Techninis aprašas.pdf - 1414 psl.) 16. Turi būti užtikrintas visiškas kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas: techninės įrangos, tvarkyklės ir techninio palaikymo. (Techninis aprašas.pdf - 1345 - 1415 psl.) 17. Ne mažesne nei Microsoft Windows 10 Pro arba lygiaverte operacine sistema. (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.) 18. Ne mažesne nei MS Office 2019 Home & Business arba lygiavertė (turi būti nurodyta licencija). (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.)	HP Z2 Tower G9 Workstation (Techninis aprašas.pdf - 1344 psl.) Į pasiūlymo kainą įtraukto kompiuterio komplektacija: stalinis kompiuteris su dedikuota vaizdo plokšte, kuri užtikrina keturių monitorių prijungimą vienu metu. Komplektuojamas su USB laidine pele ir USB laidine klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu. (Techninis aprašas.pdf - 1344 - 1417 psl.) Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ 32713 (https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-13500&id=4993). Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Techninis aprašas.pdf - 1355, 1356 psl.) Procesorius suderinamas su Windows 10 Pro, Windows 11 Home ir Windows 11 Pro bei Linux operacinėmis sistemomis. (Techninis aprašas.pdf - 1355, 1356 psl.) 16 GB (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.) 512 GB (Techninis aprašas.pdf - 1384, 1400 psl.) Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe. (Techninis aprašas.pdf - 1350, 1384 psl.) Yra vidinis DVD įrenginys. (Techninis aprašas.pdf - 1400, 1344 psl.) 8 vnt. USB, 3.0 arba aukštesnio tipo, iš jų 5 vnt. korpuso priekyje. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1345 psl.) Kompiuteris turi integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir gali dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1 000 Mbps. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1395 psl.) USB kabeliu prijungiama klaviatūra su integruotu SmartCard skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą, kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard/ US English layout išdėstymą. (Techninis aprašas.pdf - 1407 psl.) USB kabeliu prijungiama lazerinė pele su ratuku. (Techninis aprašas.pdf - 1412, 1413 psl.) Kompiuteris turi lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti. (Techninis aprašas.pdf - 1344, 1345 psl.) Kompiuteris turi integruotą garsiakalbį. (Techninis aprašas.pdf - 1370 psl.) Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raška Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas. (Techninis aprašas.pdf - 1414 psl.) Užtikrintas visiškas kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas: techninės įrangos, tvarkyklės ir techninio palaikymo. (Techninis aprašas.pdf - 1345 - 1415 psl.) Microsoft Windows 10 Pro operacine sistema. (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.) Į pasiūlymo kainą įtraukta MS Office 2021 Home & Business licencija. (Techninis aprašas.pdf - 1400 psl.)
7.4	Spalvotas radiologo darbo vietos diagnostinis medicininis monitorius	1. Bendra monitoriaus raška ≥ 3 megapikseliai, (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) 2. Istrižainė $\geq 21"$, (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) 3. Kalibruotas skaitis ≥ 500 cd/m², (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) 4. Kontrastiškumas (tipinis) $\geq 1400:1$, (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) 5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis technologinis sprendimas. (Techninis aprašas.pdf - 889 psl.)	Bendra monitoriaus raška 3 megapikseliai (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) Istrižainė 21,3" (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) Kalibruotas skaitis 500 cd/m² (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) Kontrastiškumas (tipinis) 1500:1 (Techninis aprašas.pdf - 888 psl.) Yra integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti. (Techninis aprašas.pdf - 889 psl.)
7.5	Papildomas spalvotas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai	1. Istrižainė $\geq 24"$, (Techninis aprašas.pdf - 890 psl.) 2. Kontrastiškumas $\geq 1000:1$, (Techninis aprašas.pdf - 890 psl.) 3. Maksimalus skaitis ≥ 300 cd/m², (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaitis ≥ 180 cd/m², (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) 5. VESA tvirtinimas. (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) 6. USB jungtis ≥ 2 vnt. (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm. (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.)	Istrižainė 27" (Techninis aprašas.pdf - 890 psl.) Kontrastiškumas 1000:1 (Techninis aprašas.pdf - 890 psl.) Maksimalus skaitis 350 cd/m² (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) DICOM kalibruotas maksimalus skaitis 250 cd/m² (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) VESA tvirtinimas (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) USB jungtys 3 vnt. (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) Jungtys Display port ir HDMI (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.) Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas 150 mm (Techninis aprašas.pdf - 891 psl.)
7.6	Dedikuota medicininė vaizdo plokštė	1. Ne mažiau kaip 10 bitų, (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.) 2. Atminties dydis ≥ 8 GB, (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.) 3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt. 3 x Display port jungtys ir 1 x USB-C jungtis. (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.)	10 bitų, (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.) Atminties dydis 8 GB, (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.) 3 x Display port jungtys ir 1 x USB-C jungtis. (Techninis aprašas.pdf - 1417 psl.)

7.7	Monitorių ir dedikuotos vaizdo plokštės suderinamumo reikalavimai	Medicininis diagnostinis monitorius, papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu	Medicininis diagnostinis monitorius, papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė suderinami su siūlomu kompiuteriu (Techninis aprašas.pdf - 1417, 1372, 891, 888 psl.)
7.8	Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS)	Būtinai, ne mažiau kaip 1800 VA	2000 VA. (Techninis aprašas.pdf - 1419 psl.)
8	Radiofarmacinių preparatų automatinė injekavimo sistema	1. Injektoriaus tipas - automatizuotas radiofarmacinių preparatų injekavimas, galimybė injekuoti ≥ 10 ml tūrį, 2. Galimybė naudoti skirtingus radiodifracinių preparatų ekranuotus transportavimo konteinerius. 3. Dozės galia prie injekavimo prietaiso su pakrautu radiofarmacinių preparatų (nuo ≥ 20 GBq) ≤ 20 mikroSv/val 10 cm atstumu nuo bet kurio injektoriaus paviršiaus taško. 4. Prietaisas turi būti motorizuotas. 5. Prietaisas turi būti tinkamas naudoti su 18F-FDG, 18F-PSMA, 177Lu-, 68Ga-DOTATOC preparatais	Automatizuotas radiofarmacinių preparatų injekavimas. Galima injekuoti 10 ml tūrį. (Techninis aprašas.pdf - 958, 960 psl.) Galima naudoti skirtingus radiofarmacinių preparatų ekranuotus transportavimo konteinerius. (Techninis aprašas.pdf - 987 psl.) Dozės galia prie injekavimo prietaiso su pakrautu radiofarmaciniu preparatu (20 GBq) yra 13,75 mikroSv/val 10 cm atstumu nuo bet kurio injektoriaus paviršiaus taško. (Techninis aprašas.pdf - 988 psl.) Prietaisas yra motorizuotas. (Techninis aprašas.pdf - 961 psl.) Prietaisas tinkamas naudoti su 18F-FDG, 18F-PSMA, 177Lu-, 68Ga-DOTATOC preparatais. (Techninis aprašas.pdf - 960, 961, 987 psl.)
9	Komplektacija	1. Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu - 1 vnt. 2. Tyrimų apdorojimo programinė įranga - 1 vnt. 3. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt. 4. Technologo valdymo konsolė su programine įranga - 1 vnt. 5. Įvadinė elektros spinta - 1 vnt. 6. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės - visų priedų ≥ 1 vnt. 7. Sistemos kalibravimui reikalingi rinkiniai, įskaitant šaltinius - 1 komplektas. 8. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatinė ir programinė įranga vaizdų peržiūrai ir diagnostikai): 8.1 Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 5 vnt. (3 realios darbo vietos su technine įranga ir ≥ 2 virtualios darbo vietos). Turi būti numatytas ir pateiktas toks sprendinys (licencijos, programinės įrangos paketai ar pan.), kuris leistų prie virtualių darbo vietų, jungtis iš ne mažiau kaip 8 (aštuonių) kompiuterinių darbo vietų. 8.2 Tarnybinė stotis (centrinis serveris) - 1 vnt. 8.3 Radiologo darbo vietos kompiuteris - 3 vnt. 8.4 Spalvotas radiologo darbo vietos diagnostinis medicininis monitorius - 3 vnt. 8.5 Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 3 vnt. 8.6 Dedikuota vaizdo plokštė - 3 vnt. 8.7 Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 3 vnt. 9. Radiofarmacinių preparatų automatinė injekavimo sistema - 1 vnt.	Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu - 1 vnt. Tyrimų apdorojimo programinė įranga - 1 vnt. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt. Technologo valdymo konsolė su programine įranga - 1 vnt. Įvadinė elektros spinta - 1 vnt. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės - visų priedų po 1 vnt. Sistemos kalibravimui reikalingi rinkiniai, įskaitant šaltinius - 1 komplektas. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatinė ir programinė įranga vaizdų peržiūrai ir diagnostikai): Konkrencinių darbo vietų skaičius - 5 vnt. (3 realios darbo vietos su technine įranga ir 2 virtualios darbo vietos). Numatytas ir bus pateiktas toks sprendinys (licencijos, programinės įrangos paketai ar pan.), kuris leistų prie virtualių darbo vietų, jungtis iš 8 (aštuonių) kompiuterinių darbo vietų. Tarnybinė stotis (centrinis serveris) - 1 vnt. Radiologo darbo vietos kompiuteris - 3 vnt. Spalvotas radiologo darbo vietos diagnostinis medicininis monitorius - 3 vnt. Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 3 vnt. Dedikuota vaizdo plokštė - 3 vnt. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 3 vnt. Radiofarmacinių preparatų automatinė injekavimo sistema - 1 vnt.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo dieną turi turėti Radiacinės saugos centro suteiktą licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais). Tiekėjas Radiacinės saugos centro suteiktą licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencijas montuoti ir remontuoti prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais) turi pateikti kartu su įranga.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitikimą reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliotą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas taikomas tik techninės specifikacijos 9.1 p. nurodytai skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemai su rentgeno kompiuterinės tomografijos modulių.
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
7. Tiekėjas sumoka valstybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už jonizuojančiosios spinduliuotės kalibravimo šaltinių įvežimą į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas bei jų grąžinimą.
8. Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus: Bandymai turi būti atlikti vadovaujantis LR HN 78:2009, HN 77:2015, IAEA HUMAN HEALTH SERIES Nr. 27 PET/CT Atlas on Quality Control and Image Artefact ir EFOMP'S GUIDELINE: QUALITY CONTROLS IN PET/CT AND PET/MR bei vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis (arba lygiavertėmis). Po bandymų pateikia protokolus.
9. Garantinis laikotarpis:
 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamų periodiškumų nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
 3. Garantiniu laikotarpiu, jeigu prireikia, turi būti keičiami kalibraciniai šaltiniai, taip pat apmokant visas išlaidas, susijusias su jų grąžinimu gamintojui ir rinkliavų bei draudimų apmokėjimu.
10. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia įrangą, jog gamintojas TP nenumato.
 4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
11. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
 1. Mokymai ≥ 5 gydytojams radiologams (kiekvieno gydytojo radiologo mokymų trukmė ne mažiau kaip 20 akademinių val.),
 2. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams (kiekvieno medicinos fiziko mokymų trukmė ne mažiau kaip 40 akademinių val.),
 3. Mokymai ≥ 10 radiologijos technologams (kiekvieno radiologijos technologo mokymų trukmė ne mažiau kaip 30 akademinių val.),
 4. Visus mokymus turi vesti gamintojo paskirtas specializuotas mokymų specialistas.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turės pristatyti tarnybinę stotį (centrinį serverį) į Santariškių g.2, patalpa H123, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į PO spintą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sistemine programine įranga, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus sukonfigūruoti vidinių diskų RAID apjungimo grupes, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo prekių.
2. Licencijos: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (pvz. Microsoft licencijos ir kt.) turi būti susietos su Perkančiąja organizacija.
3. Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis ir licencijos privalo galioti visą įrangos eksploatacijos periodą.
4. Visi perkamų sistemų ar įrenginių prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai privalo būti perduoti užsakovui ne vėliau kaip 1 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos.
5. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sistemos architektūros schemą, kurioje privalo būti išvardinti visi komponentai ir sąsajos tarp jų, nurodant sąveikos parametrus - naudojamus tinklo prievadus, protokolus, jų versijas (pvz.: SMB 3.0). Turi būti nurodyta konkreti diegiama programinė įranga, jos versijos, detalios sąsajos su veikimui reikalingomis sistemomis ar programomis.
6. Tiekėjas pateikdamas įrangą privalo užtikrinti, kad prieiga prie paciento duomenų pateikiamoje įrangoje bus suteikiama tik autorizuotiems naudotojams (prisijungiant naudotojo vardu ar slaptažodžiu). Viesiems naudotojams turi būti suteikti unikalūs naudotojo vardai ir slaptažodžiai arba pateikiama įranga turi gebėti naudoti VULSK katalogų paslaugoje (angl. Active Directory) saugomų naudotojų prisijungimo duomenis. Jei pateikiamoje įrangoje naudotojų vardai ir slaptažodžiai saugomi lokaliai, Tiekėjas turi suteikti teisę Užsakovui administruoti naudotojus.
7. Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas

(angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (<https://nvd.nist.gov/>) V3.0 arba naujesne versija yra 5.0 arba didesnis.

8. Tiekėjui nuotolinė prieiga sistemų aptarnavimui ir garantinei priežiūrai gali būti suteikta tik naudojant Užsakovo privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą (BeyondTrust PowerBroker Password Safe) ir leidžiant Užsakovui automatizuotomis priemonėmis stebėti Tiekėjo atliekamus veiksmus.
9. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle (LAN). Siūlomas sprendimas neturi reikalauti prieigos prie Interneto.

Aplinkosauginiai reikalavimai (taikoma tik TS 9.1 p. skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemai su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu)

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Siūlomos prekės sudėtyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnį. Prekės veikimui nebus naudojamos eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:

- 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;
- ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos);
- 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.

Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"

Kam: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms

Data: 2023-05-26

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
 Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
 Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
 Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
 Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
 Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
 Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
 Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
 Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai p
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):

Pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis	Modelis, konkreti modifikacija	Kiekis, mato vnt.
Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistema su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu	GE HealthCare, kilmės šalis JAV	Omni Legend 32	1

2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):

Nr.	Siūlomas techninis funkcionalumas	Pasirinkti parametro vertę Yra / Nėra
T1	Sistemos jautrumas veikiant 3D nuskaitymo režimu (išmatuotas pagal NEMA NU 2-2018 arba lygiavertį standartą) ≥ 45 cps / kBq	Yra
T2	Dirbtinio intelekto / gilaus mokymosi algoritmų pagrindu veikianti PET vaizdų rekonstrukcijos sistema leidžianti pagerinti vaizdo kokybę	Yra
T3	Fotonų skrydžio laiko (angl. ToF) skiriamoji geba ≤ 250 ps	Nėra
T4	Automatinė paciento pozicionavimo ir centravimo sistema leidžianti sumažinti personalo apšvitą	Yra
T5	Kasdienė ir savaitinė PET sistemos kokybės patikra nenaudojant radioaktyvaus fantomo	Nėra

3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):

Siūlomos prekės garantinis laikotarpis	Pasirinkti garantinį laikotarpį	Terminas
Siūlomos skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu garantinis laikotarpis	3	metai

4. Siūlomos sistemos skenavimo efektyvumas (Pildo Tiekėjas):

Siūlomos prekės skiriamas ^{18}F (fluoro - ^{18}F) radioizotopo aktyvumas 1 kg paciento svorio (SrA)	Įrašyti deklaruojamą vertę	Mato vnt.
Pasiūlytos skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos skiriamas ^{18}F (fluoro- ^{18}F) radioizotopo aktyvumas 1 kg paciento kūno svorio (tiekėjas arba gamintojas deklaruojamo parametro atitikčiai privalo pateikti skenavimo protokolą, kuris pritaikytas skenuoti onkologines aplikacijas pacientui naudojant ^{18}F -FDG, pacientui kurio svoris 70 kg (+/- 10 kg), KMI - 23 (+/- 1.5), kai skenavimas atliekamas nuo paciento antakių iki šlaunų vidurio)	1,3	MBq/kg


5. Siūlomos sistemos skenavimo laikas (Pildo Tiekėjas):

Siūlomos prekės skenavimo laikas (Ssl)	Įrašyti deklaruojamą skenavimo laiką	Mato vnt.
Pasiūlytos skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos skenavimo laikas vadovaujantis 4 p. nurodytomis skenavimo sąlygomis su deklaruojamomis FDG sąnaudomis (parametro atitikčiai tiekėjas arba gamintojas privalo pateikti skenavimo protokolą, kuriame būtų nurodyti įrangos skenavimo parametrų nustatymai)	6	min.

UAB Tradintek
124942182
J.Jasinskio g. 9, Vilnius 01112
LT249421811
A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tomas Mickūnaitis
tel. +370 5 2685427, faks. +370 5 2496084, el. paštas tomas.mickunaitis@tradintek.com, info@tradintek.com
Tomas Mickūnaitis, direktorius

irkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

Kaina 1 vnt. Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
2 999 990,00	2 999 990,00	3 629 987,90

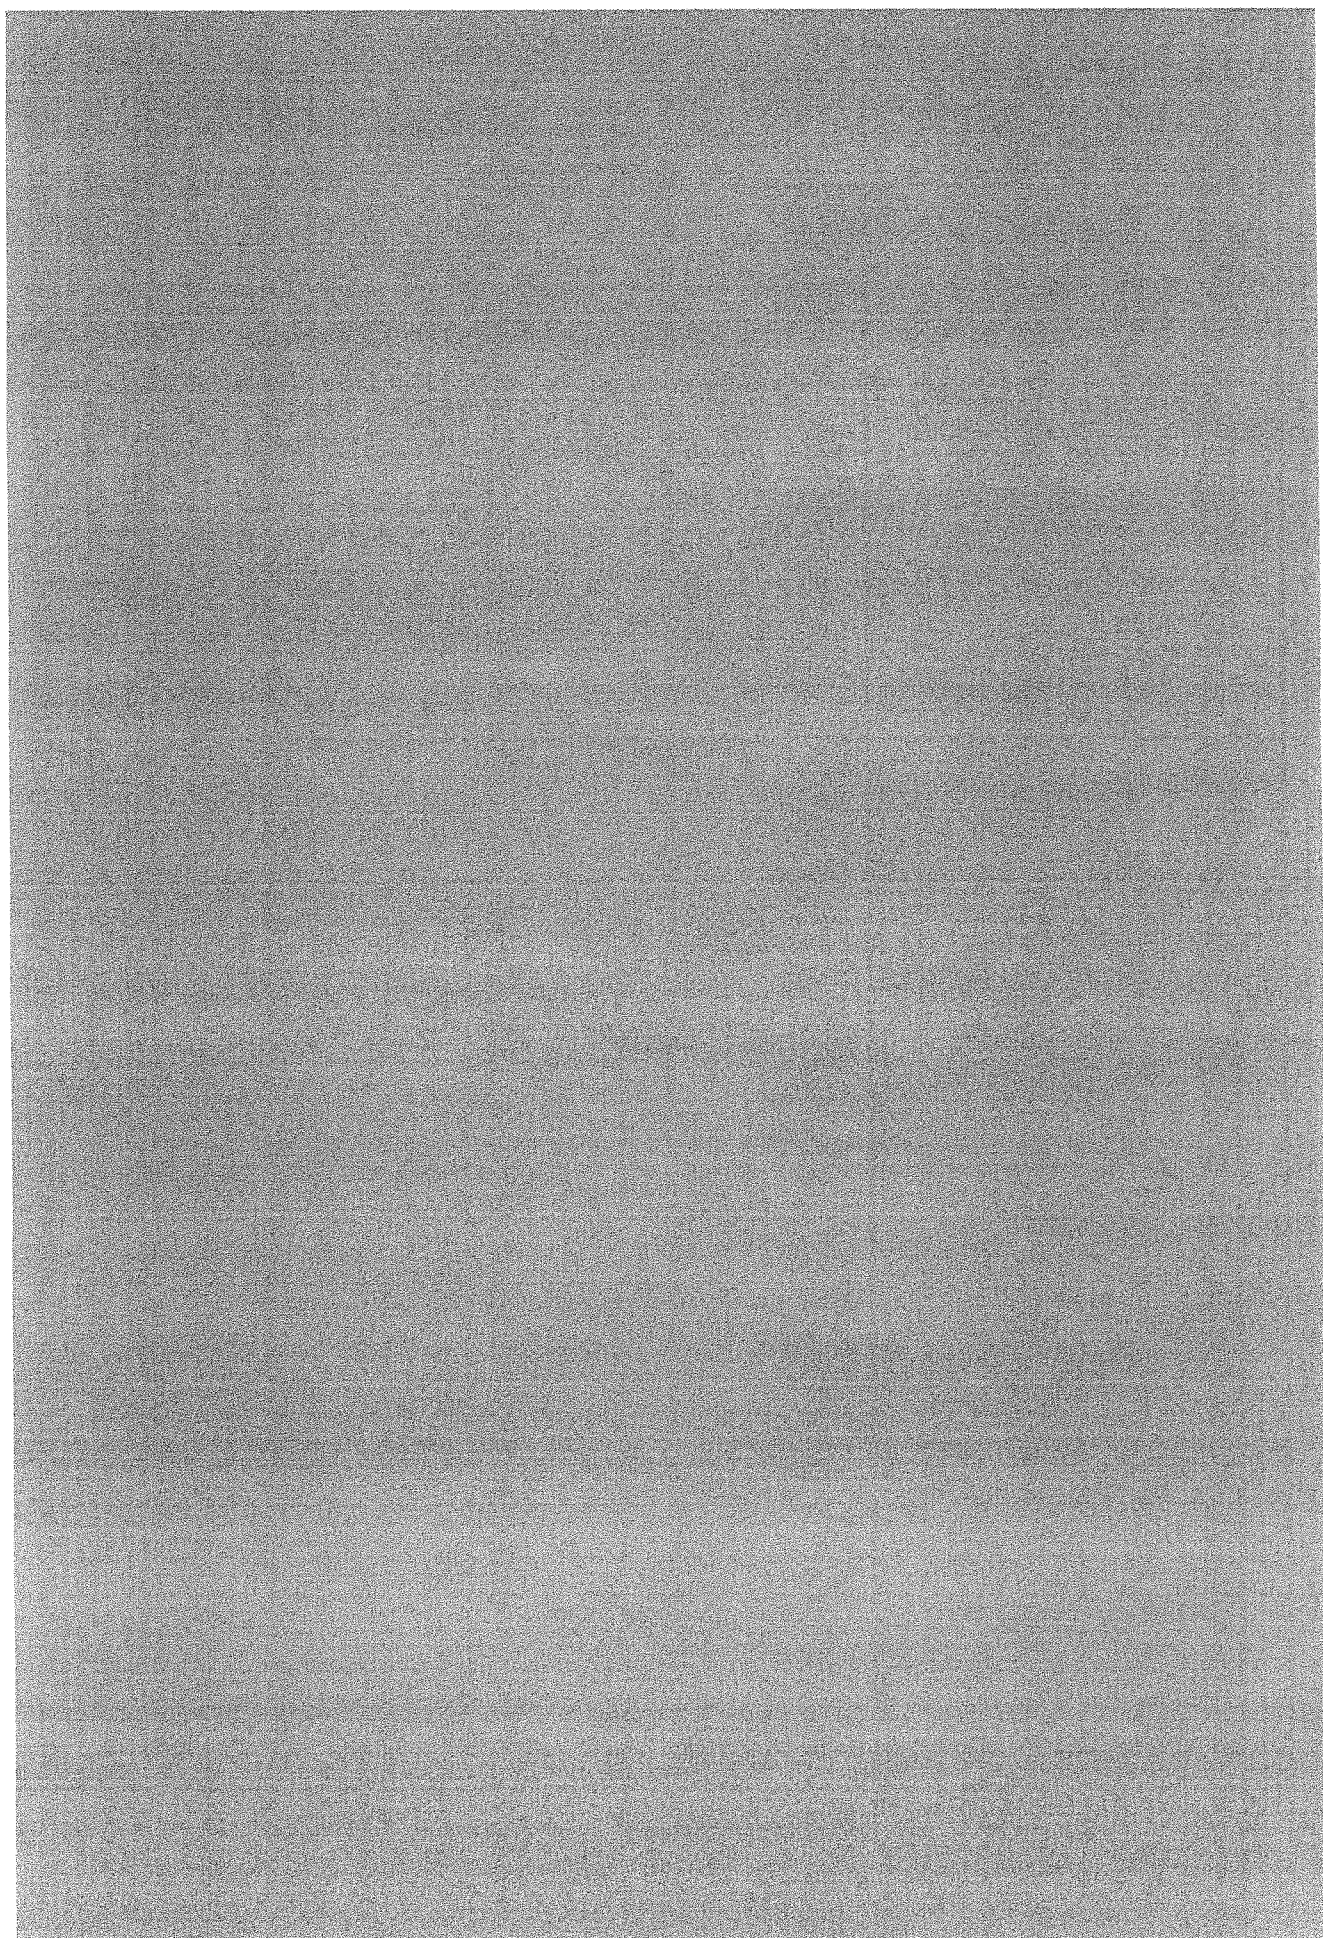

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama **kaina, kokybė ir sąnaudos**.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K)	60
2) Techniniai pranašumai (T)	40

Vertinimo kriterijai ir jų parametų lyginamieji svoriai:

Vertinimo kriterijai				Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime	
Kaina (K)				X =	60
Techniniai pranašumai (T)				Y =	40
Nr.	Parametrai	Formulės rūšis	Parametro lyginamasis svoris		
T1	Sistemos jautrumas veikiant 3D nuskaitymo režimu (išmatuotas pagal NEMA NU 2-2018 arba lygiavertį standartą) ≥ 45 cps / kBq	Statinis: (yra/nėra)	L1 =	0,60	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2	Dirbtinio intelekto / gilaus mokymosi algoritmų pagrindu veikianti PET vaizdų rekonstrukcijos sistema leidžianti pagerinti vaizdo kokybę	Statinis: (yra/nėra)	L2 =	0,10	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3	Fotonų skrydžio laiko (angl. ToF) skiriamoji geba ≤ 250 ps	Statinis: (yra/nėra)	L3 =	0,10	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4	Automatinė paciento pozicionavimo ir centravimo sistema leidžianti sumažinti	Statinis: (yra/nėra)	L4 =	0,10	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5	Kasdienė ir savaitinė PET sistemos kokybės patikra nenaudojant radioaktyvaus fantomo	Statinis: (yra/nėra)	L5 =	0,10	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

$$E = K + T$$

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (K_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (K_v) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$K = \frac{K_{min}}{K_v} \times X$$

3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,60, T2 = L2 = 0,10, T3 = L3 = 0,10, T4 = L4 = 0,10, T5 = L5 = 0,10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

$$T = \left(\sum_{i=1}^5 T_i \right) \times Y$$

Vertinimo sąlygos

PET/CT sistema bus naudojama (Sn)	Sn1	12	val./parą
	Sn2	3	kartų/savaitę
	Sn3	52	savaites/metus
Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo laikotarpis (GCSL)		10	metų
PET/CT visu GCSL sistema bus naudojama valandų (Snv)		18720	valandų
PET/CT visu GCSL sistema bus naudojama minučių (Snm)		1123200	minučių
Fiksuotas vienam pacientui skirtas pasiruošimo laikas (Vpl)		40	minučių
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL)		2	metai
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG)		8	%
Techninės priežiūros aptarnavimų kiekis per metus (TP)		1	vnt.
Fiksuota techninės priežiūros aptarnavimo kaina (FkTP)		5000	€ su PVM
Fiksuota vienam tyrimui reikalingos dozės (4 MBq/kg) kaina (Fdk)*		780	€
Fiksuota 1 MBq/kg kaina (F1dk)		195	€

* Skaičiavimuose naudojami duomenys vadovaujantis galiojančiomis FDG tiekimo sutarties sąlygomis. Sutarties Nr. 22-c-14 2022-01-05

Formulės:

$$S_{nv} = S_{n1} \times S_{n2} \times S_{n3} \times GCSL$$

$$S_{nm} = S_{nv} \times 60$$

$$F1dk = Fdk / 4$$

Diskontuotos techninės priežiūros kainos. Taikoma 4% diskonto norma

Laikotarpis, metai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diskono koeficientas	1,04	1,082	1,125	1,17	1,217	1,265	1,316	1,369	1,423	1,48
Fiksuota TP kaina, €	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Diskontuota TP kaina, €	5200,00	5410,00	5625,00	5850,00	6085,00	6325,00	6580,00	6845,00	7115,00	7400,00

Techninės priežiūros, metrologinių patikrų bei koreguotos pasiūlymo kainos suvestinė

	Tiekėjas 1	Tiekėjas 2	Tiekėjas 3	Tiekėjas 4	Tiekėjas 5	Tiekėjas 6	Tiekėjas 7	Tiekėjas 8	Tiekėjas 9	Tiekėjas 10
Mokamų TP aptarnavimų kiekis GCS skaičiavimo laikotarpiu, vnt (MTP _n)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TP aptarnavimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, už kuriuos PO turės sumokėti, € su PVM (MTPk _n)	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Diskonuota TP aptarnavimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, už kuriuos PO turės sumokėti, € su PVM (dMTPkn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su siūloma Sistema galima atlikti tyrimų kiekį GCS skaičiavimo laikotarpiu, vnt. (Tk _n)	28080	28080	28080	28080	28080	28080	28080	28080	28080	28080
Su siūloma Sistema atliktų tyrimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, € (Tk _n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPG _n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPK _n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:

MTP_n - Tiekėjo n mokamų techninės priežiūros aptarnavimų kiekis gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo laikotarpiu, vnt.

MTPk_n - Techninės priežiūros aptarnavimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, už kuriuos perkančioji organizacija turės sumokėti, € su PVM.

dMTPk_n - Diskonuota techninės priežiūros aptarnavimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, už kuriuos perkančioji organizacija turės sumokėti, € su PVM.

Tk_n - Su siūloma Sistema galima atlikti tyrimų kiekį GCS skaičiavimo laikotarpiu, vnt.

Tk_n - Su siūloma Sistema atliktų tyrimų kaina GCS skaičiavimo laikotarpiu, €.

EpPG_n - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.

KPK_n - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.

Formulės:

$$MTP_n = GCSL - (T_n GL)$$

$$MTPk_n = MTP_n \times FKTP$$

$$Tk_n = Snm / (Vpl + Ssl)$$

$$Tk_n = Tk_n \times Fl(dk \times SrA_n)$$

$$EpPG_n = (T_n GL - MGL) \times (Pk_n \times (EpPG/100))$$

$$KPK_n = Pk_n + dMTPk_n + Tk_n - EpPG_n$$

Tiekėjams pateikus pasiūlymus gaunama tokia pasiūlymų kainų suvestinė

	Tiekėjas 1	Tiekėjas 2	Tiekėjas 3	Tiekėjas 4	Tiekėjas 5	Tiekėjas 6	Tiekėjas 7	Tiekėjas 8	Tiekėjas 9	Tiekėjas 10
Pasiūlymo kaina (Pk_n), € su PVM										
Siūlomas garantinis laikotarpis (T_nGL), metai										
Techninis pranašumas T1 ($T1_n$)										
Techninis pranašumas T2 ($T2_n$)										
Techninis pranašumas T3 ($T3_n$)										
Techninis pranašumas T4 ($T4_n$)										
Techninis pranašumas T5 ($T5_n$)										
Tiekėjo pasiūlytos PET/KT sistemos skiriamas ^{18}F (fluoro - 18) radioizotopo aktyvumas 1 kg paciento svorio (SrA_n)										
Tiekėjo pasiūlytos PET/KT sistemos viso kūno sritys (ang. whole body; nuo antakių iki šlaunų vidurio) vidutinis skenavimo laikas (Ssl_n)										

Žymėjimų paaiškinimai:

Pk_n - Tiekėjo n siūlomos PET/KT kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.

T_nGL - Tiekėjo n siūlomas PET/KT garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikotarpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurį gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 8% nuo pasiūlymo kainos.

$T1_n$ - $T5_n$ - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra arba Nėra).

SrA_n - Tiekėjo n pasiūlytos PET/KT sistemos skiriamas radioizotopo aktyvumas 1 kg paciento svorio.

Ssl - Tiekėjo n pasiūlytos PET/KT sistemos skenavimo laikas.