



MULTIFUNKCINĚ PROCEDŮRINĚ KĚDĚ FD-K01



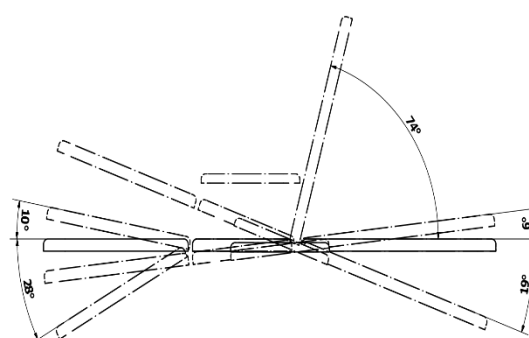

(1.1.17.2.) Infuzinis stovas

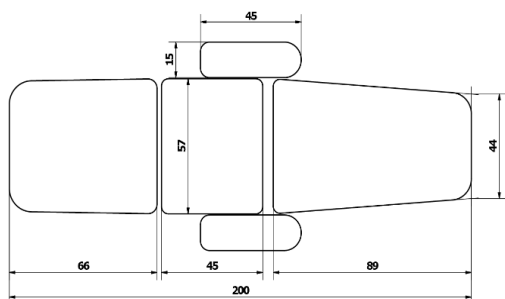

(1.1.17.1.) Popieriaus rulono laikiklis



(1.1.15.) Porankiai



(1.1.11.) Valdymo pultelis

1.1.1. Multifunkcinė kėdė FD-K01 skirta įvairioms procedūroms atlikti: kraujo paėmimas, infuzijų lašinimas, dializė;

Kėdės išoriniai matmenys:

1. Ištiestos kėdės ilgis 2000 mm;
2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija 1000 mm;

1.1.2. Plotis 870 mm.

1.1.3. Kėdės rėmas pagamintas iš plieno, dažytas milteliniu būdu;

1.1.4. Kėdės pagrinde įmontuoti ratukai skirti kėdės transportavimui esant poreikiui;

1.1.5. Kėdės sėdimosios dalies žemiausia pozicija 580 mm, aukščio reguliavimo diapazonas 400 mm;

1.1.6. Kėdės sėdimosios dalies plotis 570 mm;

1.1.7. Kėdė sudaryta iš 3 dalių - galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis;

1.1.8. Kėdės gulimoji dalis paminkštinta.

1.1.9. Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos - besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms;

1.1.10. Pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą galima iš 18 skirtingų spalvų (pridedama spalvų paletė);

1.1.11. Visos kėdės padėtys reguliuojamos elektriniu būdu (pultelio pagalba);

1.1.12. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone (nuo -19° iki $+75^{\circ}$);

1.1.13. Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas 19° ;

1.1.14. Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova 200 kg;

1.1.15. Kėdės porankiai reguliuojamo aukščio ir kampo;

1.1.16. Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius;

1.1.17. Komplektuojama su:

1. Popieriaus rulono laikikliu;
2. Infuzijos stovu;

1.1.18. Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz;

Vertimas tikras: UAB „Polisa“ direktorius Vidmantas Jocius