


## 2. Technical drawing


### 2.1 Bare Fiber, sterile, flat tip

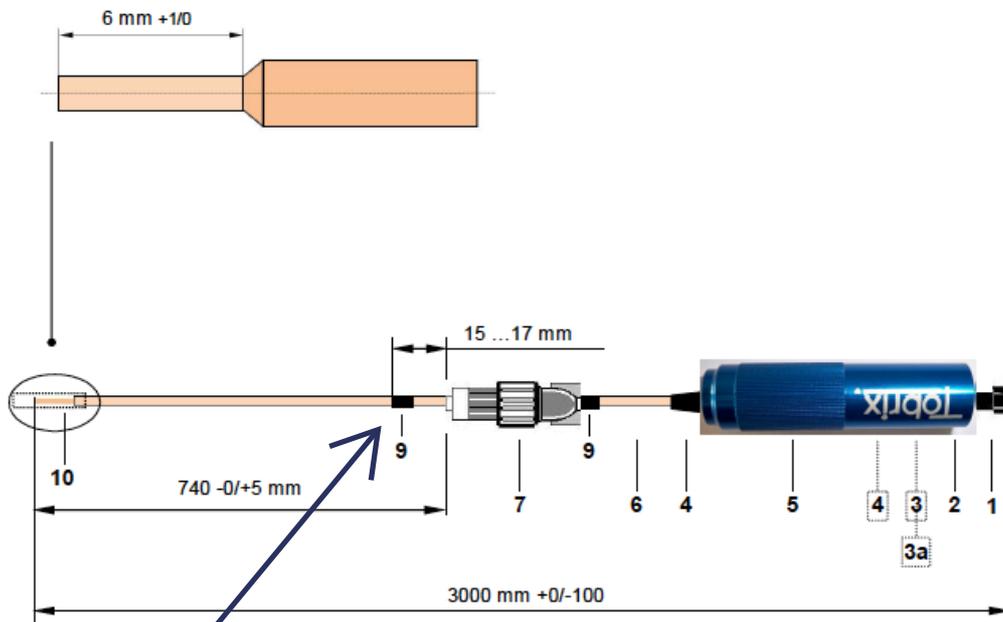

9 - hole and apertures marks (2-3 mm broad) with paint marker (black)

juoda 2-3mm plo io atžyma ties 75cm ilgiu



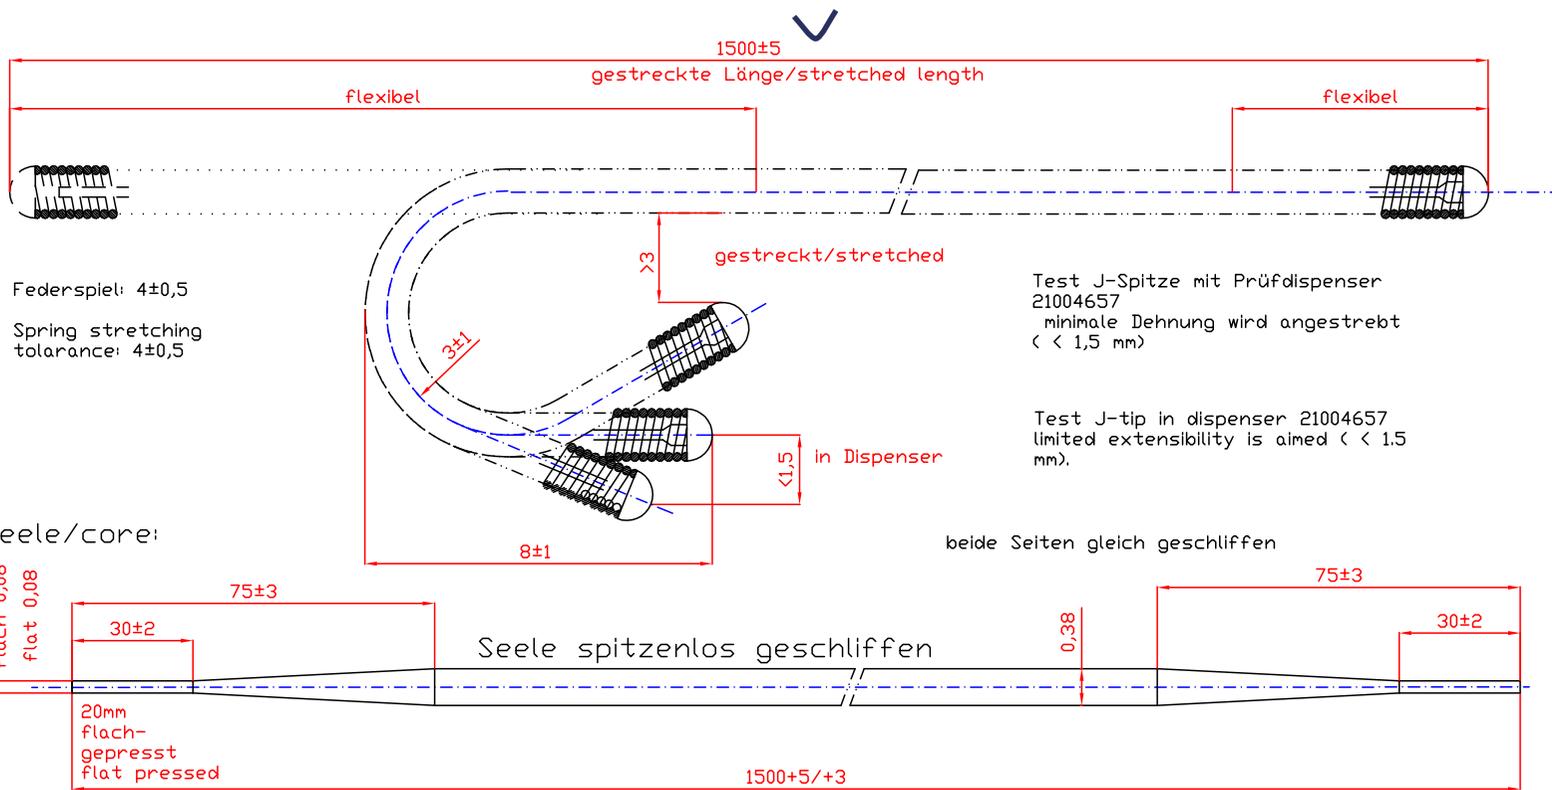

Federspiel:  $4 \pm 0,5$   
 Spring stretching tolerance:  $4 \pm 0,5$

Test J-Spitze mit Prüfdispenser 21004657  
 minimale Dehnung wird angestrebt ( $< 1,5$  mm)

Test J-tip in dispenser 21004657  
 limited extensibility is aimed ( $< 1,5$  mm).


Seele/core:

$0,18 \pm 0,01$   
 flach  $0,08$   
 flat  $0,08$



Seele spitzenlos geschliffen

$0,38$

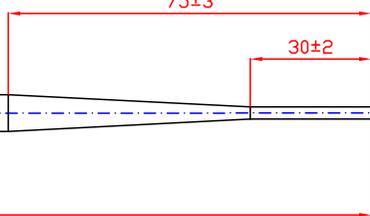

Mind. Festigkeit: 19N  
 100% Zug-Prüfung: 13N  
 Min. strenght: 19N  
 100% Tensile test: 13N

Fingerstretching J-Spitze  
 NICHT prüfen!!!

Fingerstretching j-tip  
 not checked!!!

Ableitet von Zeichnung Nr. 43002566-00

AM 12-139	04.12	JMe
Feder	04.11	MB
Federspiel	04.11	MB
Fingerstretch	04.11	MB
Änderung	Datum	von

2	1	Edelstahldraht/wire d=0,38	14000004
1	1	Federstr./coil 0,152x0,738x1500	27000298
Pos.	Menge	Bezeichnung	Sach-Nr.
Freimaßtoleranz nach DIN 2768-v		erstellt Bühner	Datum 27.12.10
J3-SFC-150-035/G4-0152 o.B. beide Seiten flexibel, ohne Band			
Sach-Nr. 40009702-20			Maßstab M*:M