


1 p.d. Siūlomi jutikliai yra techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Philips Respironics“ polisomnografais Alice 6

Elektrodų jungtys tinkamos Alice 6 daviklių blokui

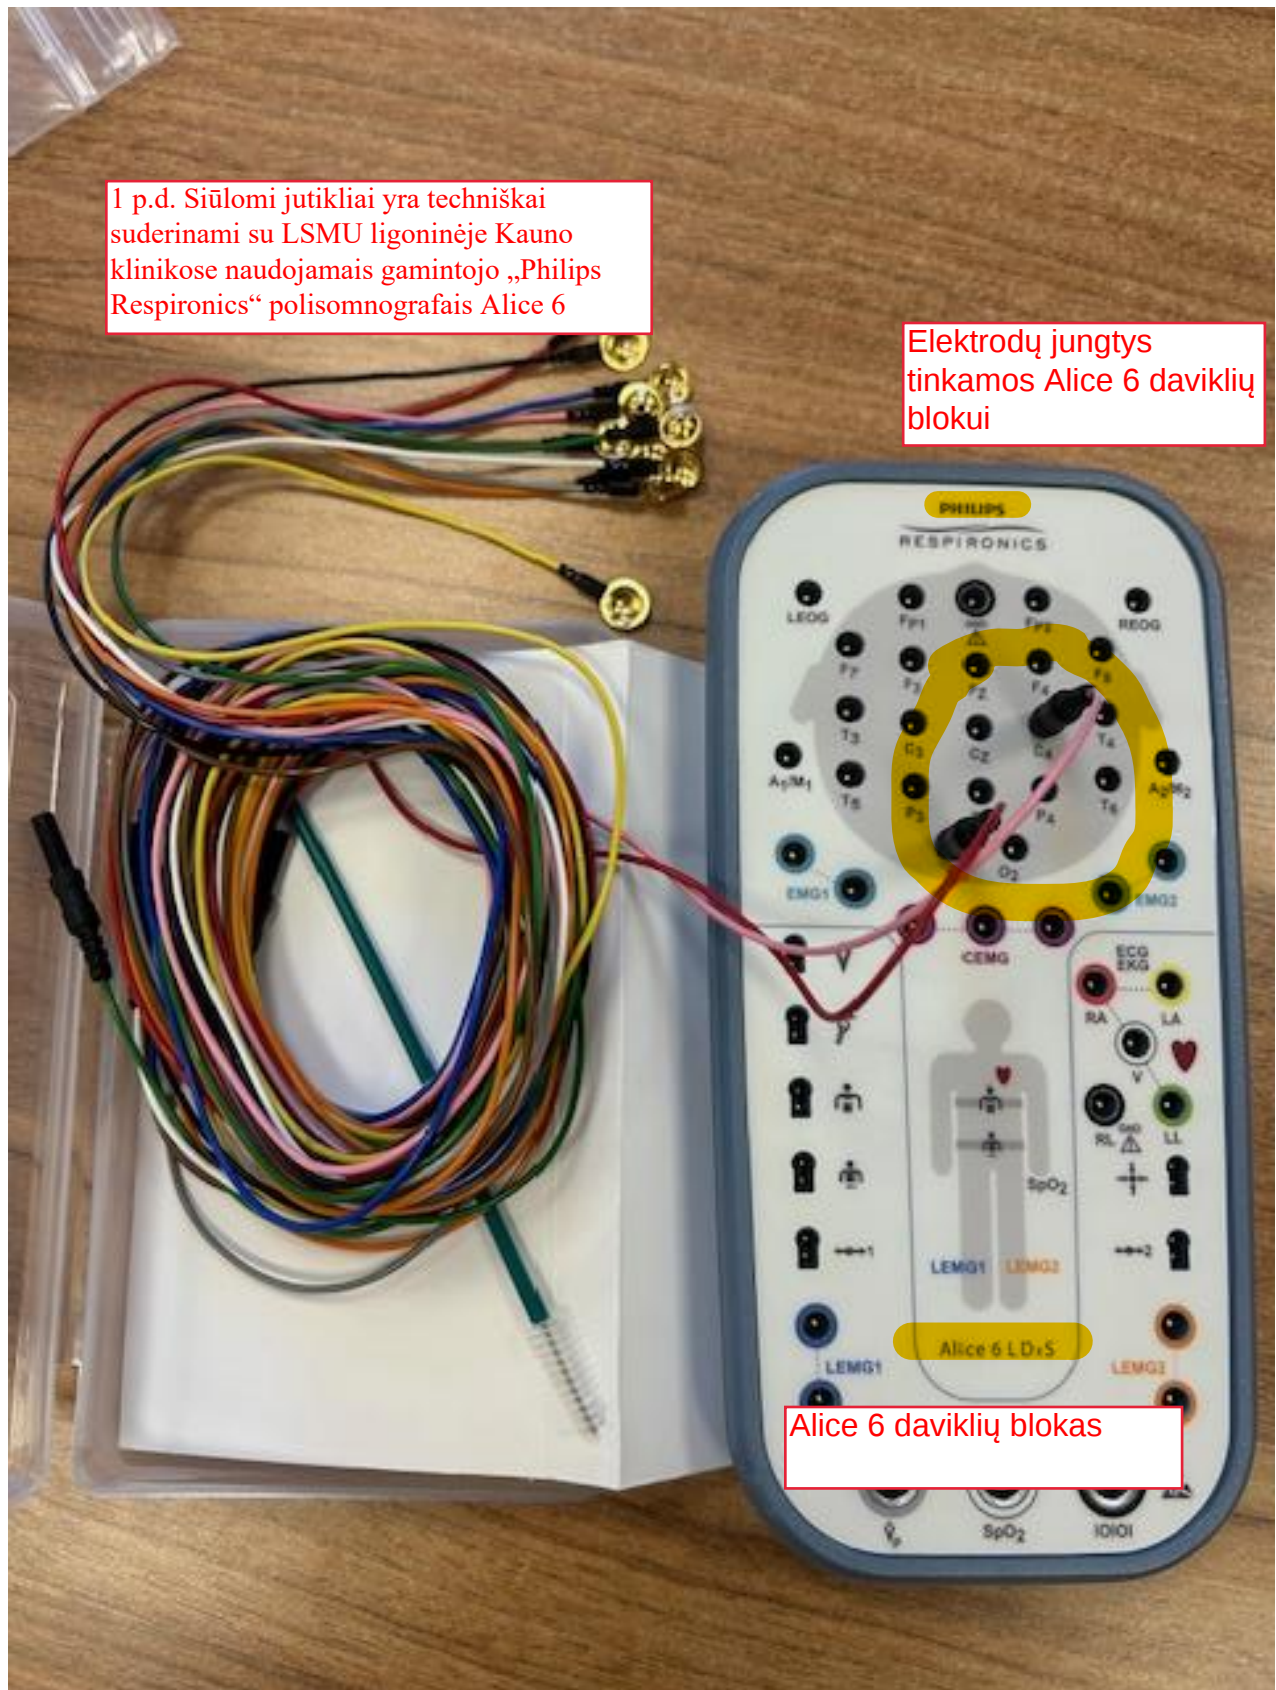

Alice 6 daviklių blokas