

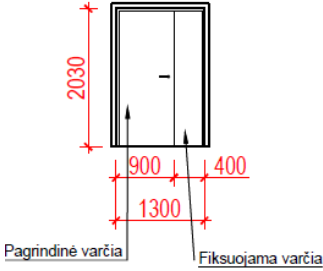
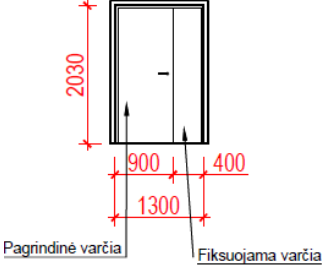


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomo gaminio gamintojas/modelis ir techninė charakteristika
1.	Švinuotos durys: Durų varčia, stakta ir apvadai: švino lakštai ($\geq 2,44$ švino ekvivalentas) dedami į plieninį profilį; Apvadai montuojami prie angos krašto; Durys su užleidimais; Be slenksčio; Baltos spalvos durys ir vyriai (≥ 4) miltelinis dažymas RAL 9003; Rankenos nulenkiamos, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Rakinama raktu; Perkama su montavimo ir demontavimo darbais. 	Švinuotos durys: Durų varčia, stakta ir apvadai: švino lakštai (2,44 švino ekvivalentas) dedami į plieninį profilį; Apvadai montuojami prie angos krašto; Durys su užleidimais; Be slenksčio; Baltos spalvos durys ir vyriai (4) miltelinis dažymas RAL 9003; Rankenos nulenkiamos, nerūdijančio plieno; Rakinama raktu; Perkama su montavimo ir demontavimo darbais. 
2.	Švinuotos durys: Dvivėrių durų varčios, stakta ir apvadai: švino lakštai ($\geq 2,71$ švino ekvivalentas) dedami į plieninį profilį; Apvadai montuojami prie angos krašto; Durys su užleidimais; Be slenksčio; Baltos spalvos durys ir vyriai (≥ 4) miltelinis dažymas RAL 9003; Rankenos nulenkiamos, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Rakinama raktu; Automatinė spyna – mygtukas kabinete; Reikalingas pritraukėjas su varčios fiksacija $\sim 120^\circ$; (Pagr. varčios 900 mm švarus praėjimo plotis) Perkama su montavimo ir demontavimo darbais. 	Švinuotos durys: Dvivėrių durų varčios, stakta ir apvadai: švino lakštai (2,71 švino ekvivalentas) dedami į plieninį profilį; Apvadai montuojami prie angos krašto; Durys su užleidimais; Be slenksčio; Baltos spalvos durys ir vyriai (4) miltelinis dažymas RAL 9003; Rankenos nulenkiamos, nerūdijančio plieno; Rakinama raktu; Automatinė spyna – mygtukas kabinete; Reikalingas pritraukėjas su varčios fiksacija $\sim 120^\circ$; (Pagr. varčios 900 mm švarus praėjimo plotis) Perkama su montavimo ir demontavimo darbais. 

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, **nepalikant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.**
- Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminytis savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnė techninių parametrų. **Pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus.**
- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.
- Priede Nr.1 pateikiami durų matmenys ir brėžiniai** yra informacinio pobūdžio. Vadovaudamasis jais ir matavimais vietoje, konkursą laimėjęs tiekėjas turės parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos su užsakovu iki gamybos pradžios.