

Klaipėda,

2020 m. 12 mėn 31 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir Triolab Oy atstovaujama generalinio direktoriaus Jussi Kurittu (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Diagnosticiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos greitai mikroorganizmų identifikacijai automatizuotu būdu, įsigyjant automatinį analizatorių panaudai“ (506632) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal užsakovo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos el. paštu vidas.peciukenas@triolab.lt, prekės pristatomos per 10 darbo dienų po užsakovo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu ne mažesnis nei 6 mėnesiai.

2.2. Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų techninėje specifikacijoje nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

3.4. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Užsakovas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 24 mėnesius su galimybe pratęsti dar 24 mėnesiams.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.
- 6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.
- 6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 7.1. Pateikti Sutartyje numatytas prekes, nurodytas sutarties priede, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
- 7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą.
- 7.3. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
- 7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
- 7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.
- 7.7. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik tų prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekėjus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas ir (ar) papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
 - 7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
 - 7.8.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį;
 - 7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių tiekimo spartą.
- 7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.
- 7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

- 8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 8.2. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.



8.3. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutartyje nurodytas prekes numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekės vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl pateiktų nekokybiškų prekių.

9. Ginčai:

9.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.



13. Sutarties priedai

- 13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

„Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



„Tiekėjas”

Triolab Oy
Mustionku 8,
20750 Turku, Suomija
A/S FI1931311001525868
Handelsbanken
Banko kodas HANDFIHH
Įmonės kodas 0629706-0
Direktorius
Jussi Kurittu

SUTARTIES 2020 m. 11 mėn. d.
PRIEDAS Nr. 15 - 20-0366

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

II. DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS GREITOS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJOS ANALIZATORIUI, ĮSIGIJIMUI PIRKIMO BŪDU

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės)	Reagentų ir kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM	PVM tarifas %	Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM	Suma, EUR su PVM 48 mėn.	Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reagentai, eksploatacinės medžiagos, bei papildomos priemonės, skirtos darbui su automatinio greitos mikroorganizmų identifikacijos analizatoriumi									
	Bendrieji reikalavimai									
1	Reagentai ir priemonės	Būtina. Turi būti tinkami automatiniam analizatoriui, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti).	Tinkami automatiniam analizatoriui, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Vieno tiekėjo ir kelių gamintojų (analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti).							

11

2	Reagentai ir priemonės	Būtina. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai ir visos kitos būtinos priemonės: reagentai ir visos kitos reikalingos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.	Pasiūlyme yra pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai ir visos kitos reikalingos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.								
3	CE ženklintas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.	Visi reagentai ir priemonės yra sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.								
4	IN VITRO diagnostinis naudojimas	Būtina. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos skirti IN VITRO naudojimui (pateikti tai įrodantį dokumentą)	Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos skirti IN VITRO naudojimui								
5	Reagentų, eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu	Būtina. Ne mažesnis nei 6 mėn.	Ne mažesnis nei 6 mėn.								
6	Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai	Būtina. Turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis reagentų ir kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.	Bus pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis reagentų ir kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Pateikiama elektroninėje laikmenoje.								

7	Prekių tiekimo sistema	Būtina. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).	Bus garantuota lanksti nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).						
8	Prekių pirkimas	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.						

9	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti.	Būtina. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijas.	Bus pateiktos elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijos.																
	AUTOMATINIS GREITOS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJOS ANALIZATORIUS MALDI Biotyper Sirius System																		
1	Bakterijų (gramteigiamų/gramneigiamų, aerobinių/anaerobinių), grybų (mieliagrybių/pelėsinių) identifikacija	Būtina. Identifikacija iš išaugintų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje). Minimalus tiriamosios medžiagos kiekis 1 kolonija	Iki 52000 tyrimų																
1.1	IVD Matrica HCCA-portioned			2000 tyr./pak.	30 pak.	4983,00	0%	4983,00	4983,00	149490,00									
1.2	IVD Bakterijų testo standartas			200 tyr./pak.	10 pak.	710,00	0%	710,00	710,00	7 100,00									

[illegible]

	<i>Acinetobacter spp.</i> , greitas cefalosporinazės aktyvumo nustatymas) automatizuotu būdu.	kultūros) (be papildomos inkubacijos/auginimo Petri lėkštelėje). Minimalus tiriamosios medžiagos kiekis l ml								
2.1	MBT Sepsityper IVD Kit		50 tyr./pak.	14 pak.	902,00	0%	902,00	12628,00		<i>Bruker Daltonics GmbH, MBT Sepsityper IVD Kit, 1834338, 50 testų/rink; MBT STAR-Carba IVD Kit, 1848467, 20 testų/rink; MBT STAR-Cepha IVD Kit, 1858555, 64 testai/rink.</i>
2.2	IVD Matrix HCCA -portioned		2000 tyr./pak.	1 pak.	4983,00	0%	4983,00	4983,00		<i>Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink.</i>
2.3	IVD Bacterial Test Standard		200 tyr./pak.	1 pak.	710,00	0%	710,00	710,00		<i>Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink.</i>
2.4	IVD MBT Biotarget 96 šulinėlių vienkartinė plokštelė		20 vnt./pak.	1 pak.	1565,00	0%	1565,00	1565,00		<i>Bruker Daltonics GmbH, IVD MBT Biotarget 96, 1839298, 20 vnt./pak.</i>

2.5	Bruker standartinis tirpiklis, tinkamas MALDI MS			100 ml/pak.	I pak.	260,00	0%	260,00	260,00	Sigma Aldrich, Bruker standard solvent, 900666-100ML
2.6	Skrudzžių rūgštis			100 ml/pak.	I pak.	190,00	0%	190,00	190,00	Merck, Formic acid, 5.43804.0100, 100 ml
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	29,05						20336,00	
		Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM								
				222176,00						

„Užsakovas“

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 LT-92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035



„Tiekėjas“

Triolab Oy
 Mustionku 8,
 20750 Turku, Suomija
 A/S FI1931311001525868
 Handelsbanken
 Banko kodas HANDEFIHH
 Įmonės kodas 0629706-0


 Direktorius
 Jussi Kurittu

PANAUDOS SUTARTIS Nr. 04.2-20-0035

2020 m. 12 31, Klaipėda

Triolab Oy (toliau - Panaudos davėjas),
adresas: Mustionku 8, 20750 Turku, Suomija, tel. 8 698 80122, įmonės kodas 0629706-0,
atstovaujama generalinio direktoriaus Jussi Kurittu - viena šalis,

ir

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, (toliau - Panaudos gavėjas),
adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel. (8 46) 39 65 02, Faks. (8 46) 39 66 25,
Įm. kodas 190468035, PVM mokėtojo kodas LT9046803514,
atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio - kita šalis,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau - Sutartis)/ Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai toliau Sutartyje gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu - „Šalimis“.

1. Sutarties objektas

1.1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise jam priklausančią įrangą (toliau - Įrangą), o Panaudos gavėjas įsipareigoja priimti ir naudoti Įrangą pagal paskirtį (įrašyti paskirtį ir skyriaus pavadinimą) ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą

2. Panaudos davėjo įsipareigojimai:

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja perduoti įvesti į eksploataciją Įrangą Panaudos gavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įrangą perduoda kartu su jos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

2.2. Panaudos davėjas įsipareigoja supažindinti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama Įranga personalą) su Įrangos naudojimo specifika, apmokyti dirbti personalą per 3 darbo dienas nuo įrangos instaliavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti konsultacijas visais su įrangos naudojimu susijusiais klausimais.

2.3. Pasibaigus Sutarties terminui atsiimti Įrangą iš Panaudos gavėjo per 14 darbo dienų.

2.4. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta.

3. Panaudos gavėjo įsipareigojimai

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja perduotą Įrangą naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį (nurodyta 1.1. punkte), remiantis naudojimo instrukcijomis bei visais Panaudos davėjo nurodymais ir apmokymais.

3.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Įrangą.

3.3. Pasibaigus Sutarties terminui grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Panaudos gavėjas priima ir grąžina Įrangą Panaudos davėjui pagal abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. Panaudos gavėjas įsipareigoja neperduoti Įrangos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.

3.5. Informuoti panaudos davėją apie įrangos gedimą.

4. Sutarties galiojimas

- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 24 mėnesius su galimybe pratęsti dar 24 mėnesiams, kol galioja reagentų tiekimo sutartis.
- 4.2. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių bendru sutarimu. Visi sutarties pakeitimai ir priedai galios, jeigu jie bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.
- 4.3. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai be priežasties nutraukti šią Sutartį raštu pranešus kitai Šaliai prieš 60 kalendorinių dienų. Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama sutartį, privalo pilnai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus kitai Šaliai.

5. Nenugalima jėga (Force majeure)

- 5.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

6. Ginčų sprendimo tvarka

- 6.1. Visi iš šios sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, jis perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui pagal Panaudos gavėjo buveinės adresą.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Visus klausimus, susijusius su informacijos apie Panaudos gavėją pateikimu, Panaudos davėjas privalo iš anksto suderinti su Panaudos gavėjo atstovu.
- 7.2. Jeigu keičiasi Šalių buveinės ar Sutartyje nurodytų Šalių banko sąskaitų rekvizitai, tai ši Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo duomens pasikeitimo informuoti apie tai kitą Šalį.

8. Baigiamosios nuostatos


- 8.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

9. Priedai:

- 9.1. Įrangos techninė specifikacija

PANAUDOS GAVĖJAS

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

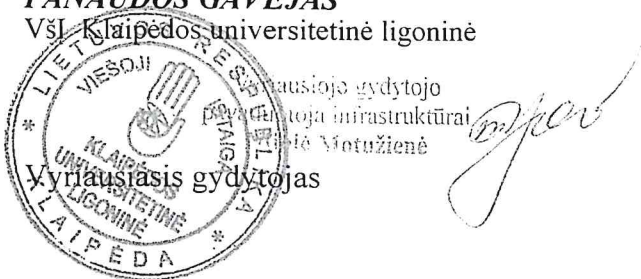

PANAUDOS DAVĖJAS

Triolab Oy

Direktorius
Jussi Kurittu

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS GREITAI MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINĮ ANALIZATORIŲ PANAUDAI

I. GREITOS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJOS AUTOMATINIS ANALIZATORIUS PANAUDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	MALDI Biotyper Sirius
Modelis	System
Gamintoja	Bruker Daltonik GmbH
Kilmės šalis	Vokietija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Techninio parametro reikšmė	Reikalaujamo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	Greitos mikroorganizmų identifikacijos automatinis analizatorius - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)		
1	Analizatorius paskirtis	Greitos identifikacijos atlikimui iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (bakterijų, pelėsinų grybų/mieliagrybių) Petri lėkštelėse, tiesiogiai iš susignalizavusių kraujo vakuuminių buteliukų (greita sepsio diagnostika, greitas A, B ar D klasės karbapenemazės aktyvumo nustatymas Enterobacteriales, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., greitas cefalosporinazės aktyvumo nustatymas) automatizuotu būdu.	Greitos identifikacijos atlikimui iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (bakterijų, pelėsinų grybų/mieliagrybių) Petri lėkštelėse, tiesiogiai iš susignalizavusių kraujo vakuuminių buteliukų (greita sepsio diagnostika, greitas A, B ar D klasės karbapenemazės aktyvumo nustatymas Enterobacteriales, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., greitas cefalosporinazės aktyvumo nustatymas) automatizuotu būdu.
2	Tyrimo metodas	Masių spektrometrinis.	Masių spektrometrinis.
3	Automatinio analizatoriaus komplektacija	Būtina. Kartu su automatinio analizatoriumi turi būti pateikta in-vitro diagnostiniam naudojimui programinė įranga, turintį duomenų "bibliotekas", kompiuteris, klaviatūra, pele, spausdintuvas ir nepertraukiamas maitinimo šaltinis atitinkamo našumo (srovės/įtampos stabilizatorius).	Kartu su automatinio analizatoriumi pateikiama in-vitro diagnostiniam naudojimui programinė įranga, turintį duomenų "bibliotekas", kompiuteris, klaviatūra, pele, spausdintuvas ir nepertraukiamas maitinimo šaltinis atitinkamo našumo (srovės/įtampos stabilizatorius).
4	Greitosios mikroorganizmų identifikacijos tyrimai, atliekami automatinio analizatoriumi	Būtina. Automatinis analizatorius privalo atlikti šiuos tyrimus: greita identifikacija iš gramteigiamų/gramneigiamų, aerobinių/anarobinių bakterijų kolonijų, grybų kolonijų (mieliagrybių/pelėsinų) išaugintų Petri lėkštelėje; greita sepsio diagnostika, greitas A, B ar D klasės karbapenemazės aktyvumo nustatymas Enterobacteriales, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., greitas	Automatinis analizatorius atlieka šiuos tyrimus: greita identifikacija iš gramteigiamų/gramneigiamų, aerobinių/anarobinių bakterijų kolonijų, grybų kolonijų (mieliagrybių/pelėsinų) išaugintų Petri lėkštelėje; greita sepsio diagnostika, greitas A, B ar D klasės karbapenemazės aktyvumo nustatymas Enterobacteriales, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., greitas cefalosporinazės aktyvumo nustatymas tiesiogiai iš teigiamos kraujo kultūros (susignalizavusio kraujo vakuuminio buteliuko).

		cefalosporinazės aktyvumo nustatymas tiesiogiai iš teigiamos kraujo kultūros (susignalizavusio kraujo vakuuminio buteliuko).	
5	In-Vitro diagnostinis naudojimas	Būtina (pateikti tai įrodantį dokumentą) greitai identifikacijai iš: bakterijų kolonijų iš išaugintų kolonijų Petri lėkštelėje; mieliagrybių/pelėsinių grybų kolonijų iš išaugintų kolonijų Petri lėkštelėje; tiesiogiai iš teigiamos kraujo kultūros (be papildomo auginimo/inkubacijos Petri lėkštelėje).	Būtina (pateikti tai įrodantį dokumentą) greitai identifikacijai iš: bakterijų kolonijų iš išaugintų kolonijų Petri lėkštelėje; mieliagrybių/pelėsinių grybų kolonijų iš išaugintų kolonijų Petri lėkštelėje; tiesiogiai iš teigiamos kraujo kultūros (be papildomo auginimo/inkubacijos Petri lėkštelėje).
6	Analizatoriaus pagaminimo metai	Būtina. Automatinis analizatorius turi būti naujas ir nenaudotas (pagamintas 2020m) arba ne senesnis kaip 1 metai, bet techniškai atnaujintas pagal gamintojo reikalavimus (pateikti tai įrodantį įrangos gamintojo dokumentą).	Automatinis analizatorius bus naujas ir nenaudotas, pagamintas 2020 m.
7	Matavimo (identifikacijos) plokštelė	Būtina. Daugkartinė arba vienkartinė, ne mažiau 50 vietų pacientų mėginams, neįskaičiuojant vietų standartams/kalibratoriams. Analizatorius turi leisti išimti plokštelę, papildyti kitais mėginiais ir matuoti toliau nuo bet kurio pasirinkto mėginio. CE ženklavimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. Skirta IN VITRO diagnostiniam naudojimui.	Vienkartinė, ne mažiau 50 vietų pacientų mėginams, neįskaičiuojant vietų standartams/kalibratoriams. Analizatorius leidžia išimti plokštelę, papildyti kitais mėginiais ir matuoti toliau nuo bet kurio pasirinkto mėginio. CE ženklavimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. Skirta IN VITRO diagnostiniam naudojimui.
8	Analizatorius gebėjimas identifikuoti bakterijų ir grybų rūšis (in-vitro)	Ne mažiau 1300 rūšių.	2887 rūšių
9	Metodo jautrumas/specifiškumas	Ne mažiau 97%	97%
10	Mėginio identifikacijos trukmė	Iš bakterijų kolonijos ne daugiau 5 min. Iš grybų kolonijos ne daugiau 15 min. Iš teigiamo kraujo vakuuminio buteliuko ne daugiau 20 min.	Iš bakterijų kolonijos ne daugiau 5 min. Iš grybų kolonijos ne daugiau 15 min. Iš teigiamo kraujo vakuuminio buteliuko ne daugiau 20 min.
11	Analizatoriaus gebėjimas atlikti identifikaciją iš BACTEC kraujo vakuuminės sistemos buteliukų	Būtina. Pateikti validaciją įrodantį dokumentą.	Galima
12	Minimalus tiriamosios medžiagos kiekis, reikalingas identifikacijai	Identifikacija iš bakterijų/grybų kolonijų ne daugiau 1 kolonijos. Identifikacija iš kraujo ne daugiau 1ml.	Identifikacija iš bakterijų/grybų kolonijų ne daugiau 1 kolonijos. Identifikacija iš kraujo ne daugiau 1ml.
13	Nurodyti su kokiomis AST sistemomis analizatoriaus programinė įranga gali jungtis	Pageidautina.	Visos sistemos, kurios gali nuskaityti ASTM arba CVS duomenų formatus
14	Analizatoriaus modulių perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai), esant įvairiems trikdžiams/klaidoms tyrimo atlikimo metu	Būtina. (Nurodyti).	Prietaiso LED indikatoriai: Steady white - NORMAL or STARTUP; Flashing white slow - DOCKING; Flashing white fast - AUTOMODE; Steady red - ERROR. Programinės įrangos klaidų pranešimai: An identification run with special characters in sampleId is not allowed! Error! Please call service! Connecting to flexControl failed!

			Error! Initializing MBT Compass IVD failed! QC on position <X> failed!
15	Analizatoriaus valymas	Pageidautina. Automatizuotam valymui naudojamas papildomas lazeris, integruotas į sistemą.	Yra. Automatizuotam valymui naudojamas papildomas lazeris, integruotas į sistemą.
16	Brūkšninių kodų identifikavimo sistema	Būtina.	Yra
17	Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą	Būtina. Automatinis analizatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Analizatorius (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS) turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus; turi turėti brūkšninių kodų skaitytuvą.	Būtina. Automatinis analizatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Analizatorius (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS) turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus; turi turėti brūkšninių kodų skaitytuvą.
18	Darbo/vartotojo vadovas	Būtina. Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.	Bus pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
19	Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai	Būtina. Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami) popierinėse versijose ar elektroninėje laikmenoje.	Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija bus pateikta (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami) popierinėse versijose ar elektroninėje laikmenoje.
20	Programinės įrangos versijos	Būtina. Tiekėjai privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus.	Tiekėjas kuo skubiau informuos vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atliks gamintojo nurodytus veiksmus.
21	Personalo mokymas	Būtina. Turi būti prarastas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.	Bus prarastas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.
22	Konsultavimas	Būtina. Turi būti garantuotas (darbo dienomis nuo 8- 20 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 8-15 val.) personalo konsultavimas techniniais ir kitais aktualiais klausimais.	Bus garantuotas (darbo dienomis nuo 8- 20 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 8-15 val.) personalo konsultavimas techniniais ir kitais aktualiais klausimais.
23	CE ženklavimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinama CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.	Būtina. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinama CE žyme.
24	Analizatorių priežiūra	Būtina. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dienos, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.	Bus pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dienos, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
25	Nuotolinis pagalbos teikimo centras	Būtina. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę, prisilaikant visų	Bus ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos

		būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų.	reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų.
26	Techninis analizatorių aptarnavimas	Būtina. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2010-05-03, Nr.V-383.	Bus garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2010-05-03, Nr.V-383.
27	Analizatorių techninė priežiūra	Būtina. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas analizatoriaus/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planas (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) bei sąnaudinės lėšos (bei paskaičiuota kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui), per numatytąjį laikotarpį.	Bus pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas analizatoriaus/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planas (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) bei sąnaudinės lėšos (bei paskaičiuota kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui), per numatytąjį laikotarpį.
28	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Būtina. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorius turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis analizatoriaus darbo vietoje ir atlikti šalinimo veiksmus (remontą). Automatinis analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepavykus sutaisyti per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo pateikti problemos sprendimo variantus, užtikrinančius nepertraukiamą tyrimų atlikimą	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorius bus pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas bus pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis analizatoriaus darbo vietoje ir atlikti šalinimo veiksmus (remontą). Automatinis analizatorius bus sutaisytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepavykus sutaisyti per 3 darbo dienas, tiekėjas pateiks problemos sprendimo variantus, užtikrinančius nepertraukiamą tyrimų atlikimą

PANAUDOS GAVĖJAS


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Vyriausiojo gydytojo
pavadootoja infrastruktūrai
Nijolė Motužienė



PANAUDOS DAVĖJAS

Triolab Oy



Direktorius
Jussi Kurittu