

**„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INTERLEUKINO 6 NUSTATYMO KARTU
SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“
(PIRKIMO NR. 4447826)**


**UAB „ROCHE LIETUVA“ PAAIŠKINIMAS
2025 m. lapkričio 14 d.**

1. Komisijai nėra aišku, ar tiekėjo **UAB „Roche Lietuva“** pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos 1.7 punkte nurodytą reikalavimą, nes kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose pažymėtose atžymose aprašytas STAT (t.y., skubių) tyrimų vykdymas, tačiau nėra nurodyta, ar analizatorius tiria pavienius (t.y., po vieną) mėginius.

Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso pirkimo dokumentų 11.2 punkto nuostatomis, priima sprendimą paprašyti tiekėjo **UAB „Roche Lietuva“** per 3 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos paaiškinti pateiktą pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose nurodant tikslias atžymas, patvirtinančias techninės specifikacijos 1.7 punkte nurodytą parametą, kad analizatorius turi galimybę tirti pavienius mėginius.

Atsakymas: UAB „Roche Lietuva“ kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose nurodo tikslias atžymas, kurios patvirtina atitikimą techninės specifikacijos 1.7 punkte nurodytam reikalavimui „Analizatorius turi turėti galimybę tirti pavienius mėginius.“.

UAB „Roche Lietuva“ papildomai paaiškina, kad į vieną mėginių stovėlį telpa ne daugiau kaip penki mėgintuvėliai. Papildomai, kaip pavyzdį, teikiame veikiančio analizatoriaus vaizdo langą, kuriame matyti, kad 00111 stovelyje (rutininiai tyrimai, STAT tyrimo šiuo atveju nėra) yra užimtos tik dvi pozicijos (balti apskritimai (angl. *Completed(C)*). Likusios trys pozicijos yra tuščios (pilki apskritimai (angl. *Empty(E)*). Analogiškai į stovėlį gali būti dedamas tik vienas mėgintuvėlis ir vykdoma analizė (rutininiai tyrimai arba STAT tyrimai). Taip pat analizatoriaus naudotojo vadove yra aprašomi veiksmai, kurių reikėtų imtis kuomet yra problemų su pavieniais mėginiais ir yra referuojama į rutininių bei STAT mėginių padavimą (*Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 347/392*).

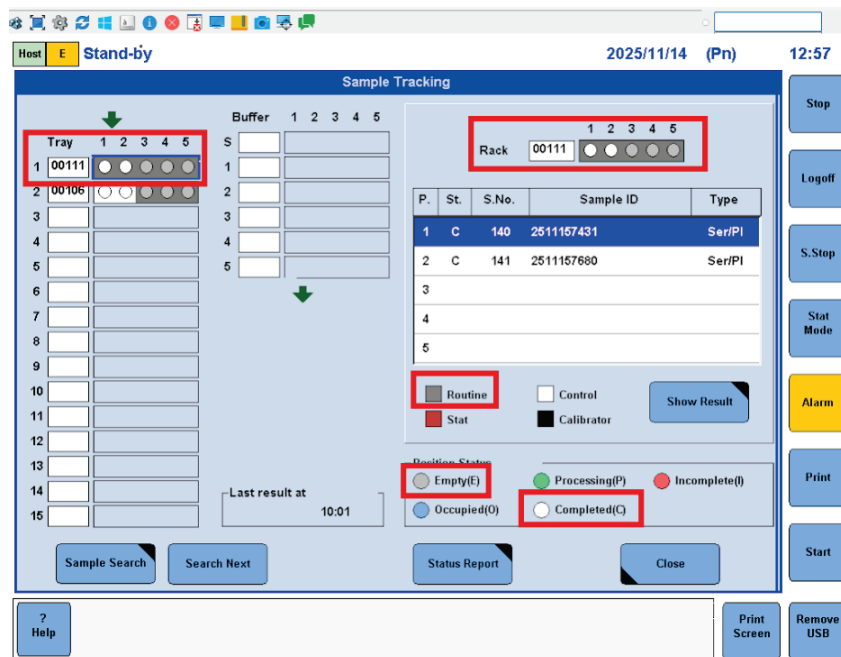

Esamus ir **papildomus** atitikimus žiūrėti žemiau nurodytoje dokumentacijoje:

Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 176/392

Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 28/392

Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 31/392

Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 347/392

2. Komisija pažymi, kad tiekėjas **UAB „Roche Lietuva“** pasiūlyme techninės specifikacijos 4.6 p. nurodė, kad analizatorius turi galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais, tačiau kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose pažymėtose atžymose tai nėra nurodyta.

Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso pirkimo dokumentų 11.2 punkto nuostatomis, priima sprendimą paprašyti tiekėjo **UAB „Roche Lietuva“** per 3 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos paaiškinti pateiktą pasiūlymą, kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose nurodant tikslias atžymas, patvirtinančias techninės specifikacijos 4.6 punkte nurodytą parametą.

Atsakymas: UAB „Roche Lietuva“ kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose nurodo tikslias atžymas, kurios patvirtina atitikimą techninės specifikacijos 4.6 punkte nurodytam reikalavimui *„Analizatorius turi turėti galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais (ng/l) arba turi būti pateiktas perskaičiavimo į SI sistemos vienetus koeficientas.“*.

UAB „Roche Lietuva“ papildomai paaiškina, kad analizatorius automatiškai apskaičiuoja kiekvieno mėginio analitės koncentraciją pg/mL ($1 \text{ pg/mL} = 1 \text{ ng/L}$).

Esamus ir **papildomus** atitikimus žiūrėti žemiau nurodytoje dokumentacijoje:

Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 281/392

IL-6 metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 2/5

Pagarbiai,

UAB „Roche Lietuva“