



MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 90/15
PIRKIMO DALIS Nr. 9 - Kraujagyslių instrumentų rinkiniai, Nr. 10 - Laparatominiai
instrumentų rinkiniai, Nr. 11 - Amputaciniai instrumentų rinkiniai, Nr. 12 - Operaciniai
instrumentų komplektai stuburo operacijoms
Pirkimo numeris 154333

2015 m. balandžio 16 d.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, juridinio asmens kodas 124243848, kurios registruota buveinė yra Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius-43, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus dr. Algimanto Pamernacko, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė B.Braun Medical, juridinio asmens kodas 111551739, kurio registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liauhos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas).

toliau kartu šioje pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1 straipsnis. Sutarties dalykas

- 1.1 Sutarties dalykas yra medicinos įrangos (toliau – Prekė(-s)) pirkimas – pardavimas, atvežimas, esant poreikiui prijungimo priderinimas prie pratiestų kabelių bei kanalų, sumontavimas, instaliavimas, suderinimas, parengimas eksploatacijai, išbandymas, paleidimas bei personalo apmokymas, (techninės specifikacijos pateikiamos Sutarties specialinių sąlygų priede Nr. 1):

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt. kaina Lt /Eur be PVM	Mato vnt. kaina Lt /Eur su PVM	Viso kiekio kaina Lt /Eur su PVM	Garantinių įsipareigojimų terminas
9.	Kraujagyslių instrumentų rinkiniai	2	35.185,00 / 10.190,28	42.573,85 / 12.330,24	85.147,70 / 24.660,48	24 mėnesiai
10.	Laparatominiai instrumentų rinkiniai	1	41.187,00 / 11.928,58	49.836,27 / 14.433,58	49.836,27 / 14.433,58	24 mėnesiai
11.	Amputaciniai instrumentų rinkiniai	1	7.947,00 / 2.301,61	9.615,87 / 2.784,95	9.615,87 / 2.784,95	24 mėnesiai
12.	Operaciniai instrumentų komplektai stuburo operacijoms	1	73.495,00 / 21.285,62	88.928,95 / 25.755,60	88.928,95 / 25.755,60	24 mėnesiai

1.2 Prekės turi būti pristatytos:

Pristatymo vietos adresas	Pristatymo terminas
Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius-43	Prekės pristatomos per 60 kalendorinių dienų nuo raštinio užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių sutarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 30 kalendorinių dienų.

- 1.3 Jei nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (pasiūlyto modelio prekė negaminama ir pan.) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės(-ių), Sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę(-es) su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2 straipsnis. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (viziškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 2.2. Tiekėjas Prekę(-es) pristato ne vėliau, kaip nurodyta šios Sutarties 1.2 punkte.
- 2.3. Pirkimo sutarties trukmė - 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

3 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

- 3.1 Į bendrą Sutarties kainą įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, Prekės(-ių) tiekimo, jos(-ų) pristatymo, instaliavimo, garantinio aptarnavimo, personalo apmokymo bei kitos Sutarties sąlygų 1.1 straipsnyje numatytos išlaidos.
- 3.2 Bendra Sutarties kaina yra 67.634,61 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai 61 euro centas), iš kurių PVM sudaro 11.738,24 Eur (vieniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 24 euro centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 3.3 Numatoma galimybė Prekę(-es) pristatyti etapais ir pateikti PVM sąskaitas faktūras bei aktus tarpiniams mokėjimams, tačiau tik 1.2. punkte nurodytu Prekės(-ių) pristatymo laikotarpiu.
- 3.4 Pistačius atskirą Prekę (ar visas Prekes vienu metu), Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą, priėmimo-perdavimo aktą, instaliavimo aktą, vartotojo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba ir techninę dokumentaciją įformina montavimo dokumentaciją. Pirkėjas sumoka Tiekėjui pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės(-ių) priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 3.5 Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Perkančioji organizacija privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo likamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

4 straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimai

- 4.1 Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimai, kuriuos privaloma pateikti:

Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšis	Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma	Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas)	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo	2.794,82 (du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 82 euro centai) Eur	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra

		pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo liudijimu) galiojimo terminas.
--	--	---

5 straipsnis. Šalių atsakomybė

- 5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekės(-ių) nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytos Prekės(-ių) kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos.
- 5.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:
- 5.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
- 5.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
- 5.2.3. nutraukti Sutartį.

6 straipsnis. Susirašinėjimas

- 6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Dr. Algimantas Pamernickas	Mantas Švagždys
Adresas	Šiltnamių g. 29, Vilnius	Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius
Telefonas	(8 5) 216 9212	(8 5) 237 4333
Faksas	(8 5) 216 8984	(8 5) 237 4344
El. paštas	rvul@rvul.lt	office@hbraun.lt; mantus.svagzdys@hbraun.lt

- 6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

- 7.1. Sutartį sudaro šie cilsės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:
Sutartis ir sutarties sąlygos.
Priedai:
1. Techninės specifikacijos.
2. Tiekėjo pasiūlymus su priedais.
- 7.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Netaikumo ar prieštaravimo atveju vadovaujama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta cilsės tvarka.

8 straipsnis. Kitos nuostatos

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys ją pasirašo ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško joje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba.
- 8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

A. Pamernickas

Mantas Švagždys

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius-43

Juridinio asmens kodas 124243848

Sąskaita Nr. LT507044060000325700

AB SEB bankas

banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas 242438412

Tel. (8 5) 216 9212

Faks. (8 5) 216 8984

UAB B.Braun Medical

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 11551739

Sąskaitos Nr. LT617044060001097040

AB SEB bankas

banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT115517314

Tel. (8 5) 2374333

Faks. (8 5) 2374344

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės

direktorius




(parašas)

Dr. Algimantas Pamerneckas

Uždarosios akcinės bendrovės B.Braun Medical

direktorius

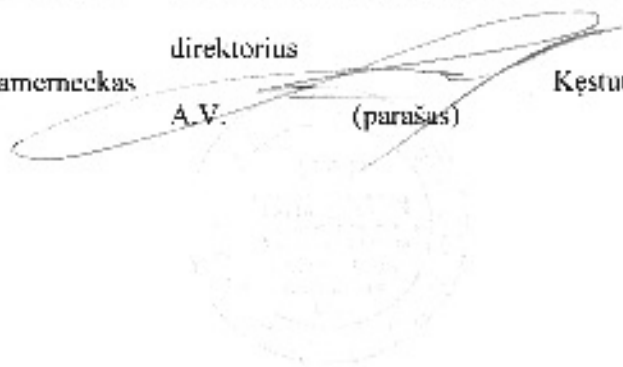

A.V.

(parašas)

Kęstutis Liauba

R. Dainys
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Daina Balčėtienė
2015-08-16

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

9 DALIS

Kraujagyslių instrumentų rinkiniai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.
1.	Plėtejas. Adson tipo arba lygiavertis, kabliai 4x5, aštrūs arba pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvirimo kampas, instrumento ilgis 260 ± 50 mm	Plėtejas. Adson tipo, kabliai 4x5, pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvirimo kampas, instrumento ilgis 320 mm. BV273R
2.	Plėtejas. Adson tipo arba lygiavertis, kabliai 4x5, aštrūs arba pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvirimo kampas, instrumento ilgis 150 – 15 mm	Plėtejas. Adson tipo, kabliai 4x5, pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvirimo kampas, instrumento ilgis 165 mm. BV094R
3.	Plėtejas. Allenberg tipo arba lygiavertis, kabliai 3x4, aštrūs arba buki, su papildomai fiksuojamu dvipusiu centriniu kabliu, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (20x12) ± 5 mm vieno ir (35x10) ± 5 mm kito kablio, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 165 ± 5 mm	Plėtejas. Allenberg tipo, kabliai 3x4, buki, su papildomai fiksuojamu dvipusiu centriniu kabliu, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (20x12) mm vieno ir (35x10) mm kito kablio, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 170 mm. BV097R
4.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 155 ± 10 mm	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm. FB411R
5.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 195 ± 10 mm	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200 mm. FB412R
6.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 155 ± 10 mm	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm. FB400R
7.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – (2 -2,8) mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 ± 10 mm	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – 2,8 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm. FB416R
8.	Disektorius. Rumel tipo arba lygiavertis, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 34 – 5 mm ilgio, bendras ilgis 240 = 10 mm	Disektorius. Rumel tipo, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 37 mm ilgio, bendras ilgis 240 mm. BJ045R
9.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 26 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 135 ± 10 mm	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 27 mm ilgio, bendras ilgis 130 mm. BJ100R
10.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 39 ± 5 mm ilgio, bendras ilgis 205 ± 10 mm	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 38 mm ilgio, bendras ilgis 200 mm. BJ103R
11.	Žirklys. Lexer tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm ± 10 mm	Žirklys. Lexer tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm. BC283B
12.	Žirklys. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	Žirklys. Tonnis-Adson tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm. BC273B
13.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm. BC261B

14.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm. BC265R
15.	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm. BC259B
16.	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm. BC259B
17.	Žirklys. Ligarūrinės, hukos, darbinė dalis su karbido indėklu, vienos branduolės ašmenys dantyti, ilgalaikis vienodas pjovimas branduolės smaigalyje ir gale, vienas žiedas gali būti spalviškai pažymėtas, instrumento ilgis 180 ± 10 mm ilgio	Žirklys. Ligarūrinės, hukos, darbinė dalis su karbido indėklu, vienos branduolės ašmenys dantyti, ilgalaikis vienodas pjovimas branduolės smaigalyje ir gale, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, instrumento ilgis 180 mm ilgio. BC295W
18.	Žirklys. Fomon tipo arba lygiavertės, stipriai lateraliai lenktos, hukos, bendras ilgis 135 ± 15 mm	Žirklys. Fomon tipo, stipriai lateraliai lenktos, hukos, bendras ilgis 135 mm. OK372R
19.	Žirklys. Thorek tipo arba lygiavertės, stipriai užlenktos, hukos, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Žirklys. Thorek tipo, stipriai užlenktos, hukos, bendras ilgis 180 mm. BC636R
20.	Spaustukas. Baby-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100 ± 10 mm	Spaustukas. Baby-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100 mm. BH105R
21.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm. BH111R
22.	Spaustukas. Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova, bendras ilgis 150 ± 10 mm	Spaustukas. Leriche tipo, lenktas, su skersine išpjova, bendras ilgis 150 mm. BH161R
23.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 38 ± 2 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 40 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 155 mm. FB447R
24.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 45 ± 5 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 40 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 155 mm. FB446R
25.	Spaustukas. Atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 20 ± 1 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	Spaustukas. Atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 20 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm. FB441R
26.	Spaustukas. Crafoord tipo arba lygiavertis, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 65 ± 10 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 245 ± 10 mm	Spaustukas. Crafoord tipo, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 72 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 245 mm. BH225R
27.	Spaustukas. Heiss tipo arba lygiavertis, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 40 ± 5 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 ± 10 mm	Spaustukas. Heiss tipo, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 40 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm. BH207R
28.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 ± 10 mm	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm. BH211R
29.	Spaustukas. Pean tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 ± 10 mm	Spaustukas. Pean tipo, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm. BH415R
30.	Adatkotis. Tiesus, darbinės dalys su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 – 0,1 mm žingsniu, rankenos apvalios, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 150 ± 10 mm	Adatkotis. Tiesus, darbinės dalys su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, rankenos apvalios, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 160 mm. BM003R

31.	Adatkotis. De Bakey tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 – 0,1 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 195 ± 15 mm	Adatkotis. De Bakey tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 210 mm. BM034R
32.	Adatkotis. Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 ± 0,1 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 265 ± 10 mm	Adatkotis. Crile-Wood tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 270 mm. BM030R
33.	Adatkotis. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 ± 0,1 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 155 ± 10 mm	Adatkotis. Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 150 mm. BM065R
34.	Adatkotis. Crile-Wood tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm	Adatkotis. Crile-Wood tipo, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm. BM019R
35.	Adatkotis. De Bakey tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 163 ± 10 mm	Adatkotis. De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165 mm. BM033R
36.	Spaustukas. Pean tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 ± 10 mm	Spaustukas. Pean tipo, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm. BH415R
37.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm. BH111R
38.	Spaustukas. Derra-Cooley arba lygiavertis, atraumatinis, rankenos lenktos kampu į išorę, distalinis galas užlenktas kampais į vidų, žiaunos visame paviršiuje susikabina dantukais, su išilgine centrine ertme, darbinės dalies lanko ilgis 17 ± 2 mm, bendras ilgis 170 ± 10 mm	Spaustukas. Derra-Cooley, atraumatinis, rankenos lenktos kampu į išorę, distalinis galas užlenktas kampais į vidų, žiaunos visame paviršiuje susikabina dantukais, su išilgine centrine ertme, darbinės dalies lanko ilgis 16 mm, bendras ilgis 170 mm. FB725R
39.	Spaustukas. Castaneda tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunų galai užlenkti kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 ± 3 mm, darbinės dalies ilgis 46 ± 6 mm, instrumento ilgis 155 ± 10 mm	Spaustukas. Castaneda tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunų galai užlenkti kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 mm, darbinės dalies ilgis 52 mm, instrumento ilgis 155 mm. FB591R
40.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 ± 1 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm. FB448R
41.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 ± 1 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm. FB449R
42.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 55 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 95 ± 5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 305 ± 10 mm	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 mm, darbinės dalies ilgis 100 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 mm. MB676R
43.	Spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos gali būti išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 45 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 65 ± 5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 195 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos gali būti išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 mm, darbinės dalies ilgis 70 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 195 mm. FB461R
44.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo arba lygiavertis, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tolygiai išlenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 20 ±	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tolygiai išlenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 20 mm, su

A. P. P. P. P.

61.	Venų ekstraktorius. Nabatoff tipo arba lygiavertis, lankstus antgalis su plastikiniu galu ir metaliniai antgaliai: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Kitos sudedamosios dalys: T formos rankena su lankstiu zondų, 900 ± 20 mm ilgio, metalinis dėklas su dangteliu visam rinkiniui	Venų ekstraktorius. Nabatoff tipo, lankstus antgalis su plastikiniu galu ir metaliniai antgaliai: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Kitos sudedamosios dalys: T formos rankena su lankstiu zondų, 900 mm ilgio, metalinis dėklas su dangteliu visam rinkiniui. FB030R
62.	Disektorius. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenkti abu galai, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Disektorius. Varady tipo, dvipusis, lenkti abu galai, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm. FB120R
63.	Fleboekstraktorius. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, disektorius/mažas kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Fleboekstraktorius. Varady tipo, dvipusis, disektorius/mažas kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm. FB121R
64.	Fleboekstraktorius. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, disektorius/didelis kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Fleboekstraktorius. Varady tipo, dvipusis, disektorius/didelis kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm. FB122R
65.	Mikro adatkotis. Tiesus, darbinės dalys padengtos deimantiniu paviršiumi, 5/0 ir mažesniems siūlams, rankenos spyruokliuojančios, plokščios arba apvalios, skersai dantytos, su užrakinimu, instrumento ilgis 185 ± 10 mm	Mikro adatkotis. Tiesus, darbinės dalys padengtos deimantiniu paviršiumi, 5/0 ir mažesniems siūlams, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, skersai dantytos, su užrakinimu, instrumento ilgis 185 mm. FM564R
66.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) standartus arba lygiavertius. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 150 mm ± 30 mm.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrai, ne mažiau 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm
67.	Silikoniniai kilimėliai. Skirti kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai: 400 mm 250 mm, + 30 mm	Silikoniniai kilimėliai. Skirti kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai: 394 mm 242 mm
68.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
69.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Siūloma įranga nauja, nesiūloma naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
70.	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis
71.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
72.	CE ženklavimas	CE ženklavimas

10 DALIS

Laparotominiai instrumentų rinkiniai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė su nuoroda į gamtinio kodą kataloge, psl. Nr.
1.	Kablys. Sauerbruch tipo arba lygiavertis, užlenkta dalis tolygaus pločio, su išilginėmis kiaurymėmis, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 265 ± 10 mm	Kablys. Sauerbruch tipo, užlenkta dalis tolygaus pločio, su išilginėmis kiaurymėmis, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 260 mm. BT514R
2.	Kablys. Brunner tipo arba lygiavertis, kablo dydis (gylis x plotis): (180x30) ± 2 mm, tolygaus pločio, rankena su	Kablys. Brunner tipo, kablo dydis (gylis x plotis): (180x30) mm, tolygaus pločio, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis

18.	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 32 ± 2 mm, darbinės dalies ilgis 68 ± 2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 235 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Satinsky. atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 32 mm, darbinės dalies ilgis 68 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 235 mm. FB506R
19.	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 ± 3 mm, darbinės dalies ilgis 84 ± 2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 mm, darbinės dalies ilgis 84 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245 mm. FB508R
20.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 111 ± 3 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 270 ± 10 mm	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 mm, darbinės dalies ilgis 111 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 270 mm. FB481R
21.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 2x3 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai lenktos į vidų, žiaunos lenktos į vidų, darbinės dalies ilgis 105 ± 10 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 ± 15 mm	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 2x3 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai lenktos į vidų, žiaunos lenktos į vidų, darbinės dalies ilgis 110 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 mm. FB472R
22.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm. FB448R
23.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, lenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 ± 2 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, lenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 mm. FB329R
24.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis $18 \pm 0,5$ mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 44 ± 3 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 18 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm. FB330R
25.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis $14 \pm 0,5$ mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 ± 3 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 48 mm. BH022R
26.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, LENKTAS, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis $19 \pm 0,5$ mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 ± 2 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, LENKTAS, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 19 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm. FB331R
27.	Retraktorius. Metalinis strypas su adapteriu surinkimui prie operacinio stalo, dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu; Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais. Komplektacijoje ne mažiau 6 vnt. mentelių, kurių išmatavimai (gylis x plotis): $(220 \times 70) = 5$ mm, $(220 \times 50) = 5$ mm, $(220 \times 40) = 5$ mm	Retraktorius. Metalinis strypas su adapteriu surinkimui prie operacinio stalo, dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu; Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais. Komplektacijoje ne mažiau 6 vnt. mentelių, kurių išmatavimai (gylis x plotis): (220×70) mm, (220×50) mm, (220×40) mm. "Munster": BV846R; BV844R; BV822R; BV825R-BV840R; BV966R; BV967R; BV956R; BV955R; RT092R; BV842R; RT069R; BV843R
28.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuomo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/FEC(MDD) standartus arba lygiavertius. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio,	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuomo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/FEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą

A. P.

8.	Kaulinė dildė. Plokščia, dvipusė, darbinės dalies plotis 20±0,5 mm, vienoje pusėje dildė, kitoje raspatorius, bendras ilgis 220 ± 10 mm	Kaulinė dildė. Plokščia, dvipusė, darbinės dalies plotis 20 mm, vienoje pusėje dildė, kitoje raspatorius, bendras ilgis 220 mm. FK507R
9.	Kaulinė dildė. Dviejų darbinių galų, tiesi, darbinės dalys skirtingo šiurkštumo, su karbido indėklais, viename gale 52 ± 2 dantukai, kitame 62 ± 2 dantukai, rankena plokščia, bendras ilgis 205 ± 10 mm	Kaulinė dildė. Dviejų darbinių galų, tiesi, darbinės dalys skirtingo šiurkštumo, su karbido indėklais, viename gale 52 dantukai, kitame 62 dantukai, rankena plokščia, bendras ilgis 205 mm. OL429R
10.	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytos dalies ilgis 22 ± 3 mm, bendras ilgis 195 ± 10 mm	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 22 mm, bendras ilgis 195 mm. BJ020R
11.	Moskitas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	Moskitas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm. BH111R
12.	1 Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) standartus arba lygiavertius. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 160 mm = 30 mm.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrus, skirtus ne mažiau kaip 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm. JK442; JP001-JP006; JG744
13.	Silikoninis kilimėlis. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 460mm 250 mm, ± 30 mm	Silikoninis kilimėlis. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm. JP948
14.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
15.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
16.	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo įšomis	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo įšomis
17.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
18.	CE ženklavimas	CE ženklavimas

12 DALIS

Operaciniai instrumentų komplektai stuburo operacijoms

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė su nuoroda į gamintojo kodą kataloge, psl. Nr.
Bazinis instrumentų komplektas stuburo operacijoms		
1.	Kabliai	Caspar tipo, nervinėms šaknelėms. išlenktas kampais argal ir pirmyn, 6 mm pločio, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240 mm. FF699R
2.	Kabliai	Love tipo nervinių šaknelių retraktorius, išlenktas 90 laipsnių kampų, instrumento ilgis 220 mm. FF703R
3.	Kabliai	Brunner tipo, stačiu kampu užlenktas kablo dydis (gylis x plotis): (180x30) mm, rankena su skylėmis, instrumento ilgis 275 mm. BT530R

A. P.

		konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilitybę. 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas daugiau 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600 mm 300 mm 140 mm. 55-142-13
31.	Silikoniniai kilimėliai	Silikoniniai kilimėliai skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 394 mm 242 mm. JF947
	Mikrodissektomijos instrumentų komplektas stuburo operacijoms	
1.	Retraktorius	Weidner tipo, kabliai 3x4, aštrūs, kablukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 130 mm. BV071R
2.	Retraktorius	Dockhorn tipo, lovelio formos kablų dydis (gylis x plotis): (55x14) mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 210 mm. DO439R
3.	Retraktorius	Caspar tipo, lovelio formos kablų dydis (gylis x plotis): (67x17) mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 210 mm. BT465R
4.	Kablų	Caspar tipo, nervinėms šaknelėms, išlenktas kampais atgal ir pirmyn, 6 mm pločio, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240 mm. FF699R
5.	Mikro peilis	Caspar tipo, kotas tiesus, distalinis galas kabliuko formos, bukas, rankena su išpjova nykščiui, instrumento ilgis 200 mm. FD347R
6.	Mikro diskektorius	Caspar tipo, bajonetinis, distalinis galas nukreiptas žemyn, 2,0 mm pločio, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, instrumento ilgis 230 mm. FF307R
7.	Kabliukas	Caspar tipo, distalinis galas kabliuko formos su rutuliuku, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, su išpjova, instrumento ilgis 245 mm. BT090R
8.	Šaukštas	Darbinė dalis nežymiai lenkta, plotis 4,4 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiui, bendras ilgis 250 mm. FK703R
9.	Šaukštas	Darbinė dalis smarkiai lenkta, plotis 4,4 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiui, bendras ilgis 250 mm. FK713R
10.	Žnyplės	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (2x12) mm, koto ilgis 160 mm. FF532R
11.	Žnyplės	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) mm, koto ilgis 160 mm. FF534R
12.	Žnyplės	Caspar tipo, lenktos aukšty 150° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) mm, koto ilgis 160 mm. FF543R
13.	Žnyplės	Caspar tipo, lenktos aukšty 150° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) mm, koto ilgis 160 mm. FF544R
14.	Žnyplės	Caspar tipo, nukreiptos žemyn 150° kampu, juda apatinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) mm, koto ilgis 140 mm. FF523R
15.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 mm. FK901B
16.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 mm. FK903B
17.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 200 mm. FK916B
18.	Instrumentų krepšelis	Nerudijančio plieno, perforuotas, su kojelėmis, pagamintomis iš termostabilius plastiko. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm 253mm 76mm), Su silikoniniu kilimėliu: išmatavimai (ilgis x plotis): (517 mm x 242 mm). JF223R, JF949
19.	Instrumentų krepšelis	Pritaikytas sudėti kaulines žnyplės, su silikoniniais fiksatoriais, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (240mm 225mm 161 mm). JF120R
20.	Retraktorius mikrodissektomijai	Su dviem lankstais, viena ranka tvirtinama prie skirtingų dydžių skėtiklių ir medialinių mentelių, kita prie skirtingų dydžių lateralinių mentelių, užsifiksuojančio mechanizmo rankenėle. BV812R
21.	Skėtiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 45 mm ilgio. BV800R
22.	Skėtiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 55 mm ilgio. BV802R

Pasiūlymas 193886



Kainos pasiūlymą
pateikė:
**UAB B. Braun
Medical**
Organizacijos Nr.
111551739

Pirkimo pavadinimas:
Medicinos įranga operacinėms

Kainos pasiūlymo pateikimo terminas (EET):
2014-09-29 15:00

Viršuliškių skg.
34-1
LT-05132
Vilnius
Lietuva

Unikalus (angl. hash) kodas:
F6BE81D2E699A2F78FD728DE498CB8336D842FEA

Pasiūlymas pateiktas: (EET)
2014-09-24 12:37

Kontaktinė
informacija:
Kęstutis Liauba
kostas@bbraun.lt

Mob. +370 6987
4298

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Paketas 193886:1 - Medicinos įranga operacinėms

Klausimynas:

Pateikėme šiuos atsakymus į kvalifikacinius klausimus.

#	Klausimas	Mūsų atsakymas	Pateiktas	Svoris	Bala	Veršif
			ai		i	a
	<u>Duomenys apie tiekėją</u>					
	Klausimų skaičius: 2					
01	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimai)	UAB B. Braun Medical				
02	Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų ūkio subjektų grupės narių kodai)	111551739				
	<u>Už pasiūlymą atsakingo asmens duomenys</u>					
	Klausimų skaičius: 4					
03	Vardas, pavardė	Mantas Švagzdys				1
04	Pareigos	Produktų vadybininkas				1
05	Telefono numeris	8 698 19708, 8 6 237 4333				1

nepateikia, laikoma, kad vykdant sutartį subteikėjai, subteikėjai ar subrangovai nebus pasitelkiami).

- 17 Su pasiūlymu pateiktų dokumentų pavadinimai, kuriuose yra pateikta konfidenciali informacija

Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

PASTABA. Pildyti tik tuomet, jei yra pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kalna arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra.

- 18 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 19 Pasirašydamas visą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

Klausimų skaičius: 3

- 40 Pridedame pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jei teikiamas elektroniniu būdu).

Pridedame

PASTABA. Dokumentas turi būti pasirašytas užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės atstovo saugiu elektroniniu parašu (patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu).

- 41 Pridedame draudimo polisą, patvirtintą draudimo bendrovės atstovo saugiu elektroniniu parašu (patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu).

Pridedame

- 42 Pridedame draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pridedame

Techninė dokumentacija

Klausimų skaičius: 1

- 50 Pridedame pirkimo sąlygose reikalaujamą pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančią techninę dokumentaciją.

Pridedame

PASTABA. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba arba pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, jei vertimas atliktas ne vertimų biuro.

Kvalifikacija

Prisegti dokumentai

Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.

Vardas, pavardė / pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
 Kvalifikacijos deklaracija_0613.pdf (Kvalifikacijos deklaracija_0613.pdf) Komentarai (0) Veiksmas	346	2014-09-17 09:32
 Tiekėjo deklaracija_0612.pdf (Tiekėjo deklaracija_0612.pdf) Komentarai (0) Veiksmas	412	2014-09-17 09:32
 CE KLS Martin sertifikatas.pdf (CE KLS Martin sertifikatas.pdf)	283	2014-09-17 09:32

3.	Pletējas. Allenberg tipo arba lygiavertis, kablai 3x4, aštrūs arba buki, su papildomai fiksuojamu dvipusiu centriniu kable, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (20x12) ± 5 mm vieno ir (35x10) ± 5 mm kito kablo, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 165 ± 5 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BV097R	Pletėjas. Allenberg tipo, kablai 3x4, buki, su papildomai fiksuojamu dvipusiu centriniu kable, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (20x12) mm vieno ir (35x10) mm kito kablo, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 170 mm
4.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 155 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB411R	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm
5.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 195 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB412R	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200 mm
6.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – >2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 155 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB400R	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm
7.	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – (2 -2,8) mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB416R	Atraumatinis pincetas. De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis – 2,8 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm
8.	Disektorius. Rumel tipo arba lygiavertis, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 34 ± 5 mm ilgio, bendras ilgis 240 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ045R	Disektorius. Rumel tipo, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 37 mm ilgio, bendras ilgis 240 mm
9.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 26 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 135 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ100R	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 27 mm ilgio, bendras ilgis 130 mm
10.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 39 ± 5 mm ilgio, bendras ilgis 205 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ103R	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 38 mm ilgio, bendras ilgis 200 mm
11.	Žirklys. Lexer tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BC283B	Žirklys. Lexer tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm
12.	Žirklys. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC273B	Žirklys. Tonnis-Adson tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm
13.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC261B	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm
14.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu,	1	Būtina	Aesculap AG, BC265B	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su kurbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti,

27.	Spaustukas. Heiss tipo arba lygiavertis, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 40 ± 5 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH207R	Spaustukas. Heiss tipo, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 40 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm
28.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH211R	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm
29.	Spaustukas. Pean tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 ± 10 mm	5	Būtina	Aesculap AG, BH415R	Spaustukas. Pean tipo, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm
30.	Adatkotis. Tiesus, darbinės dalys su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas $0,4 \pm 0,1$ mm žingsniu, rankenos apvalios, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 150 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM003R	Adatkotis. Tiesus, darbinės dalys su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, rankenos apvalios, spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 160 mm
31.	Adatkotis. De Bakey tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas $0,4 \pm 0,1$ mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 195 ± 15 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM034R	Adatkotis. De Bakey tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 210 mm
32.	Adatkotis. Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas $0,4 \pm 0,1$ mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 265 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM030R	Adatkotis. Crile-Wood tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 270 mm
33.	Adatkotis. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas $0,5 \pm 0,1$ mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 155 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM065R	Adatkotis. Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 150 mm
34.	Adatkotis. Crile-Wood tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM019R	Adatkotis. Crile-Wood tipo, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm
35.	Adatkotis. De Bakey tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 163 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM033R	Adatkotis. De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis smailėjanti, su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165 mm
36.	Spaustukas. Pean tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 ± 10 mm	10	Būtina	Aesculap AG, BH415R	Spaustukas. Pean tipo, hemostatinis, lenktas, susiaurintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm
37.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	10	Būtina	Aesculap AG, BH111R	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm

47.	Altraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 34 ± 2 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB328R	Altraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 mm
48.	Kabliukas. Desmarres tipo arba lygiavertis, didelės lenkimo kreivės kablio dydis (gylis x plotis): (9x9) – 1 mm, bendras ilgis 140 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, OA310R	Kabliukas. Desmarres tipo, didelės lenkimo kreivės kablio dydis (gylis x plotis): (9x9) mm, bendras ilgis 140 mm
49.	Kabliukas. Desmarres tipo arba lygiavertis, didelės lenkimo kreivės kablio dydis (gylis x plotis): (11x14) ± 0.5 mm, bendras ilgis 140 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, OA312R	Kabliukas. Desmarres tipo, didelės lenkimo kreivės kablio dydis (gylis x plotis): (11x14) mm, bendras ilgis 140 mm
50.	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 245 ± 15 mm ilgio	1	Būtina	Aesculap AG, BC279R	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 260 mm ilgio
51.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 195 ± 10 mm ilgio	1	Būtina	Aesculap AG, BC265R	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 200 mm ilgio
52.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 165 ± 20 mm ilgio	1	Būtina	Aesculap AG, BC261R	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 145 mm ilgio
53.	Žirklys. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC273B	Žirklys. Tonnis-Adson tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm
54.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 143 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC261B	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm
55.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 190 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC263B	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm
56.	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC259B	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm
57.	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 115 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC257B	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 115 mm

67.	Silikoniniai kilimėliai. Skirti kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai: 400 mm 250 mm. + 30 mm	1	Būtina	Aesculap AG, JG947	Silikoniniai kilimėliai. Skirti kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai: 394 mm 242 mm
68.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Būtina		Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokama dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	
69.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Būtina		Siūloma įranga nauja, nesiūlome naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	
70.	Pristatyti įrangą į VėĮ RVUL. Išpakuoti pateikta įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis	Būtina		Pristatyti įrangą į VėĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis	
71.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Būtina		Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	
72.	CE ženklavimas	Būtinas. Būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją.		CE ženklavimas	

3. Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas	Vieno vieneto įkainis, LTL be PVM	Kiekis (vnt.)	Suma LTL, be PVM	Vieno vieneto įkainis, EUR be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Kraujagyslių instrumentų rinkiniai	35 185,0000	2	70 370,0000	10 190,2804	20 380,5607

Bendra pasiūlymo kaina, LTL be PVM:

70 370,0000

PVM tarifas (%): 21 PVM suma, LTL:

14 777,7000

Bendra pasiūlymo kaina, LTL su PVM*:

85 147,7000

Pirkimo dalis Nr. 10: Laparatominiai instrumentų rinkiniai

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentes, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) praeime laikyti neįpareigojantiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartų perimantys Lietuvos standartai. Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedu „arba lygiavertis“.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Kiekis vnt.	Parametro reikšmė	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir prekės modelis (arba gamintojo suteiktas prekės kodas)	Parametro reikšmės atitikimas reikalavimams
1.	Kablų. Sauerbruch tipo arba lygiavertis, užlenkta dalis tolygaus pločio, su išilginėmis kiaurymėmis, rankena su kiaurymėmis, bendras	2	Būtina	Aesculap AG, BT514R	Kablų. Sauerbruch tipo, užlenkta dalis tolygaus pločio, su išilginėmis kiaurymėmis, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 260 mm

13.	Disektorius. Rumel tipo arba lygiavertis, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 38 + 2 mm ilgio, bendras ilgis 240 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ045R	Disektorius. Rumel tipo, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 37 mm ilgio, bendras ilgis 240 mm
14.	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytos dalies ilgis 39 + 2 mm, bendras ilgis 230 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ025R	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 39 mm, bendras ilgis 230 mm
15.	Disektorius. Baby-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytos dalies ilgis 15 – 2 mm ilgio, bendras ilgis 185 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ014R	Disektorius. Baby-Adson tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 15 mm ilgio, bendras ilgis 185 mm
16.	Spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 80 + 2 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB456R	Spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 80 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240 mm
17.	Spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 50 + 2 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB552R	Spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 50 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 170 mm
18.	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 32 + 2 mm, darbinės dalies ilgis 68 ± 2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 235 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB506R	Spaustukas. De Bakey-Satinsky, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 32 mm, darbinės dalies ilgis 68 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 235 mm
19.	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 ± 3 mm, darbinės dalies ilgis 84 ± 2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB508R	Spaustukas. De Bakey-Satinsky tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 mm, darbinės dalies ilgis 84 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245 mm
20.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 111 ± 3 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 270 + 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB481R	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 mm, darbinės dalies ilgis 111 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 270 mm
21.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 2x3 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai lenktos į vidų, žiaunos lenktos į vidų, darbinės dalies ilgis 105 ± 10 mm, su skersine išpjova	1	Būtina	Aesculap AG, FB472R	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 2x3 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai lenktos į vidų, žiaunos lenktos į vidų, darbinės dalies ilgis 110 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 mm

A. P. ...

28.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/FEC(MDD) standartus arba lygiavertčius. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 150 mm ± 30 mm.	1	Būtina	Aesculap AG, JK442; JP001-JP006; JG744	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/FEC(MDD) lygiavertčius standartus. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, turi 2 daugkartinio naudojimo filtrus, ne mažiau 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm.
29.	Silikoniniai kilimėliai. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 460 mm 250 mm, ± 30 mm	1	Būtina	Aesculap AG, JP948	Silikoniniai kilimėliai. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm
30.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokama dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.		Būtina		Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
31.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.		Būtina		Siūloma įranga nauja, nesiūlome naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
32.	Pristatyti įrangą į VšĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis		Būtina		Pristatyti įrangą į VšĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis
33.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis		Būtina		Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
34.	CE ženklavimas	Būtinas. Būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją			CE ženklavimas

3. Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas	Vieno vieneto įkainis, LTL be PVM	Kiekis (vnt.)	Suma LTL, be PVM	Vieno vieneto įkainis, EUR be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Laparotominiai instrumentų rinkiniai	41 187,0000	1	41 187,0000	11 928,5797	11 928,5797

Bendra pasiūlymo kaina, LTL be PVM:

41 187,0000

PVM tarifas (%):

21

PVM suma, LTL:

8 649,2700

7.	Raspatorius. Mo Kissock tipo arba lygiavertis. darbinė dalis išplėtojanti, plokščia, nusmailinta įžambiai, 12 + 1 mm pločio, rankena masyvi. bendras ilgis 195 ± 10 mm	1	Būtin a	Aesculap AG, FK379R	Raspatorius. Mo Kissock tipo, darbinė dalis išplėtojanti, plokščia, nusmailinta įžambiai, 11 mm pločio, rankena masyvi, bendras ilgis 195 mm
8.	Kaulinė dildė. Plokščia, dvipusė, darbinės dalies plotis 20 ± 0.5 mm, vienoje pusėje dildė, kitoje raspatorius, bendras ilgis 220 ± 10 mm	2	Būtin a	Aesculap AG, FK507R	Kaulinė dildė. Plokščia, dvipusė, darbinės dalies plotis 20 mm, vienoje pusėje dildė, kitoje raspatorius, bendras ilgis 220 mm
9.	Kaulinė dildė. Dviejų darbinių galų, tiesi, darbinės dalys skirtingo šiurkštumo, su kurbido indėklais, viename gale 52 ± 2 dantukai, kitame 62 ± 2 dantukai, rankena plokščia, bendras ilgis 205 ± 10 mm	1	Būtin a	Aesculap AG, OL429R	Kaulinė dildė. Dviejų darbinių galų, tiesi, darbinės dalys skirtingo šiurkštumo, su kurbido indėklais, viename gale 52 dantukai, kitame 62 dantukai, rankena plokščia, bendras ilgis 205 mm
10.	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo arba lygiavertis. lenktas, dantytos dalies ilgis 22 ± 3 mm, bendras ilgis 195 ± 10 mm	1	Būtin a	Aesculap AG, BJ020R	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 22 mm, bendras ilgis 195 mm
11.	Moskitas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	8	Būtin a	Aesculap AG, BH111R	Moskitas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm
12.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) standartus arba lygiavertius. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 160 mm ± 30 mm.	1	Būtin a	Aesculap AG, JK442; JP001- JP006; JG744	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteineris su indikatoriaus galimybe, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrus, skirtus ne mažiau kaip 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm
13.	Silikoninis kilimėlis. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 460mm 250 mm, ± 30 mm	1	Būtin a	Aesculap AG, JF948	Silikoninis kilimėlis. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm
14.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.		Būtin a	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	
15.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.		Būtin a	Siūloma įranga nauja, nesiūlome naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	

4.	Kabliai	Pagamintas iš anglies pluošto polimero arba lygiavertės medžiagos, pralaidus rentgeno spinduliams, juodos spalvos, itin lengvas, kablio dydis (gylis x plotis): (140x40) – 10 mm, rankena su skylėmis ir atramomis, instrumento ilgis 250mm ± 10 mm	1	Aesculap AG, B1545P	Pagamintas iš anglies pluošto polimero medžiagos, pralaidus rentgeno spinduliams, juodos spalvos, itin lengvas, kablio dydis (gylis x plotis): (140x40) mm, rankena su skylėmis ir atramomis, instrumento ilgis 255 mm
5.	Disektoriai	Mac Donald tipo arba lygiavertis, dvipusis, viena lopetėlė tiesi, kita lenkta, bukas/bukas, abiejų distaliniai galai 5 ± 0,5 mm pločio, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 187mm ± 3 mm	2	Aesculap AG, FK291R	Mac Donald tipo, dvipusis, viena lopetėlė tiesi, kita lenkta, bukas/bukas, abiejų distaliniai galai 5 mm pločio, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 190 mm
6.	Disektoriai	Killian tipo arba lygiavertis, dvipusis, viena lopetėlė nežymiai lenkta, kita lenkta, aštrus/bukas, rankena apvali, skersai dantytu paviršiumi, bendras ilgis 183mm ± 3 mm	2	Aesculap AG, OL170R	Killian tipo, dvipusis, viena lopetėlė nežymiai lenkta, kita lenkta, aštrus/bukas, rankena apvali, skersai dantytu paviršiumi, bendras ilgis 185 mm
7.	Raspatoriai	Cobb tipo arba lygiavertis, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 10mm ± 1 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280mm ± 3 mm	1	Aesculap AG, FK146R	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 10 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm
8.	Raspatoriai	Cobb tipo arba lygiavertis, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 13mm ± 1 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, FK147R	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 13 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm
9.	Raspatoriai	Cobb tipo arba lygiavertis, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 19mm ± 1 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 ± 5 mm	1	Aesculap AG, FK148R	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 19 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm
10.	Kaltas	Stille tipo arba lygiavertis, darbinis paviršius lovelio formos, 12mm = 0,5 mm pločio, rankena masyvi, su gumbu patogiam kalimui, bendras ilgis 205mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, FL574R	Stille tipo, darbinis paviršius lovelio formos, 12mm pločio, rankena masyvi, su gumbu patogiam kalimui, bendras ilgis 205 mm
11.	Šaukštas	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, nulinio dydžio, tiesi, nukreipta aukštyn, bendras ilgis 240 mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, MF296R	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, nulinio dydžio, tiesi, nukreipta aukštyn, bendras ilgis 240 mm
12.	Šaukštas	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, pirmo dydžio, nukreipta įstrižu kampu aukštyn, bendras ilgis 240mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, MF300R	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, pirmo dydžio, nukreipta įstrižu kampu aukštyn, bendras ilgis 240 mm
13.	Šaukštas	Caspar tipo arba lygiavertis, profilis nežymiai lenktas, darbinė dalis ovali, 3.8mm ± 0,2 mm pločio, rankena pagaminta iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, bendras ilgis 215mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, FK773R	Caspar tipo, profilis nežymiai lenktas, darbinė dalis ovali, 3.6 mm pločio, rankena pagaminta iš PEEK medžiagos, bendras ilgis 220 mm
14.	Mentelė	Harrington-Pemberton tipo arba lygiavertis, dydis (gylis x plotis): (179x59) ± 5 mm, lankstus, distalinis galas širdelės formos, instrumento ilgis 295 mm	1	Aesculap AG, BT553R	Harrington-Pemberton tipo, dydis (gylis x plotis): (175x64) mm, lankstus, distalinis galas širdelės formos, instrumento ilgis 295 mm

23.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, nukreiptos į viršų $150 \pm 3^\circ$ kampų, juda viršutinė dalis, darbinė dalis $3\text{mm} \pm 1\text{mm}$ pločio, koto ilgis $150\text{mm} \pm 3\text{mm}$	1	Aesculap AG, FF843R	Caspar tipo, nukreiptos į viršų 150° kampų, juda viršutinė dalis, darbinė dalis 3mm pločio, koto ilgis 150mm
24.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, nukreiptos žemyn $150 \pm 3^\circ$ kampų, juda apatinė dalis, darbinė dalis $3\text{mm} \pm 1\text{mm}$ pločio, koto ilgis $150\text{mm} \pm 10\text{mm}$	1	Aesculap AG, FF853R	Caspar tipo, nukreiptos žemyn 150° kampų, juda apatinė dalis, darbinė dalis 3mm pločio, koto ilgis 150mm
25.	Žnyplės	Sauerbruch-Coryllos tipo arba lygiavertės, ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, masyvios, smarkiai praplatėjusios į distalinį galą, rankenos spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis $310\text{mm} \pm 10\text{mm}$	1	Aesculap AG, FO570R	Sauerbruch-Coryllos tipo, 4 šarnyrinių lankstų sistema, masyvios, smarkiai praplatėjusios į distalinį galą, rankenos spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 310mm
26.	Žnyplės	Rottgen-Ruskin tipo arba lygiavertės, lenktos į šoną, ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinė dalis $5,5\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$ pločio, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis $240\text{mm} \pm 5\text{mm}$	1	Aesculap AG, FO521R	Rottgen-Ruskin tipo, lenktos į šoną, 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinė dalis 5mm pločio, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis 240mm
27.	Žnyplės	Beckmann-Laton tipo, septyniagis, aštrus, kabliukai susiliečia, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis $321\text{mm} \pm 10\text{mm}$	1	Aesculap AG, BV276R	Beckmann-Laton tipo, septyniagis, aštrus, kabliukai susiliečia, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 320mm
28.	Žnyplės	Adson tipo arba lygiavertės, kabliai 4×5 , pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis $322\text{mm} \pm 3\text{mm}$	1	Aesculap AG, BV273R	Adson tipo, kabliai 4×5 , pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 320mm
29.	Žnyplės	Norfolk and Norwich tipo arba lygiavertės, kabliai 4×5 , buki, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis $220\text{mm} \pm 10\text{mm}$	1	Aesculap AG, BV248R	Norfolk and Norwich tipo, kabliai 4×5 , buki, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 220mm

5.	Mikro peilis	Caspar tipo arba lygiavertis, kotas tiesus, distalinis galas kabliuko formos, bukas, rankena su išpjova nykščiu, instrumento ilgis 200mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FD347R	Caspar tipo, kotas tiesus, distalinis galas kabliuko formos, bukas, rankena su išpjova nykščiu, instrumento ilgis 200 mm
6.	Mikro disektorius	Caspar tipo arba lygiavertis, bajonetinis, distalinis galas nukreiptas žemyn, 2,1 $\pm$ 0,1 mm pločio, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, instrumento ilgis 230mm $\pm$ 5 mm	1	Aesculap AG, FF307R	Caspar tipo, bajonetinis, distalinis galas nukreiptas žemyn, 2,0 mm pločio, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, instrumento ilgis 230 mm
7.	Kabliukas	Caspar tipo arba lygiavertis, distalinis galas kabliuko formos su rutuliuku, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, su išpjova, instrumento ilgis 245mm $\pm$ 5 mm	1	Aesculap AG, B1090R	Caspar tipo, distalinis galas kabliuko formos su rutuliuku, rankena apvali, kryžmiškai dantyta, su išpjova, instrumento ilgis 245 mm
8.	Šaukštas	Darbinė dalis nežymiai lenkta, plotis 4,2mm $\pm$ 0,2 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiu, bendras ilgis 252mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FK703R	Darbinė dalis nežymiai lenkta, plotis 4,4 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiu, bendras ilgis 250 mm
9.	Šaukštas	Darbinė dalis smarkiai lenkta, plotis 4,2mm $\pm$ 0,1 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiu, bendras ilgis 252mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FK713R	Darbinė dalis smarkiai lenkta, plotis 4,4 mm, rankena masyvi, su išpjova nykščiu, bendras ilgis 250 mm
10.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (2x12) $\pm$ 0,5 mm, koto ilgis 160mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FF532R	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (2x12) mm, koto ilgis 160 mm
11.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) $\pm$ 0,5 mm, koto ilgis 160mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FF534R	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) mm, koto ilgis 160 mm
12.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, lenktos aukštyn 150 $\pm$ 3° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) $\pm$ 0,5 mm, koto ilgis 160mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FF543R	Caspar tipo, lenktos aukštyn 150° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) mm, koto ilgis 160 mm
13.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, lenktos aukštyn 150 $\pm$ 3° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) $\pm$ 0,5 mm, koto ilgis 160mm $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FF544R	Caspar tipo, lenktos aukštyn 150° kampu, juda viršutinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (4x14) mm, koto ilgis 160 mm
14.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, nukreiptos žemyn 150 $\pm$ 3° kampu, juda apatinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) $\pm$ 1,5 mm, koto ilgis 140mm $\pm$ 12mm	1	Aesculap AG, FF523R	Caspar tipo, nukreiptos žemyn 150° kampu, juda apatinė žiauna, dantytos, su kiauryme, darbinė dalis (plotis x ilgis): (3x12) mm, koto ilgis 140 mm
15.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 130 $\pm$ 3° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9mm $\pm$ 0,5 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavėriu sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 $\pm$ 10 mm	1	Aesculap AG, FK901B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 mm

26.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, su dantukais, juoda arba spalvota 38mm±5 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV870R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, su dantukais, juoda, 35 mm ilgio
27.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda arba spalvota 48mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV872R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda 45 mm ilgio
28.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda arba spalvota, 58mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV874R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda, 55 mm ilgio
29.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda arba spalvota, 65mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV876R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda, 65 mm ilgio
30.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 75mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV877R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 75 mm ilgio
31.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 85mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV878R	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 85 mm ilgio
32.	Žnyplės	Viena darbinė dalis dvidantė, kita su smeigu, skirtos mentelių pakeitimui ir pritvirtinimui prie retraktoriaus	1	Aesculap AG, BV399R	Viena darbinė dalis dvidantė, kita su smeigu, skirtos mentelių pakeitimui ir pritvirtinimui prie retraktoriaus
33.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 42mm±5 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV851R	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 40 mm ilgio
34.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 52±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV853R	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 50 mm ilgio
35.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 62mm±3 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV855R	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 60 mm ilgio
36.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda arba spalvota, 72mm±5 mm ilgio	1	Aesculap AG, BV857R	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 70 mm ilgio
37.	Instrumentų krepšelis	Su specialiu dėkle, skirtu sudėti visų aukščiau išvardinto retraktoriaus mentelėms ir skėtikliams, kitoms retraktoriaus dalims, kiekvienam instrumentui numatyta stabiliai įfiksuojanti vieta. Krepšelis su kojėlėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 mm 253 mm 75mm) ± 10 mm	2	Aesculap AG, FG171P, FG172P, JF223R	Su specialiu dėkle, skirtu sudėti visų aukščiau išvardinto retraktoriaus mentelėms ir skėtikliams, kitoms retraktoriaus dalims, kiekvienam instrumentui numatyta stabiliai įfiksuojanti vieta. Krepšelis su kojėlėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 mm 253 mm 76 mm)

3. Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas	Vieno vieneto įkainis, LTL be PVM	Kiekis (vnt.)	Suma LTL, be PVM	Vieno vieneto įkainis, EUR be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Bazinis instrumentų komplektas stuburo operacijoms	27 450,0000	1	27 450,0000	7 950,0695	7 950,0695
2.	Mikrodissektomijos instrumentų komplektas stuburo operacijoms	46 045,0000	1	46 045,0000	13 335,5538	13 335,5538
Bendra pasiūlymo kaina, LTL be PVM:				73 495,0000		
PVM tarifas (%):				21	PVM suma, LTL:	15 433,9500
Bendra pasiūlymo kaina, LTL su PVM*:						88 928,9500

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius-43

Juridinio asmens kodas 124243848

Sąskaita Nr. LT1507044060000325700

AB SEB bankas

banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas 242438412

Tel. (8 5) 216 9212

Faks. (8 5) 216 8984

UAB B.Braun Medical

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 11551739

Sąskaitos Nr. LT617044060001097040

AB SEB bankas

banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT115517314

Tel. (8 5) 2374333

Faks. (8 5) 2374344

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės

direktorius

A.V.

(parašas)

Dr. Algimantas Pamernockas

Uždarnosios akcinės bendrovės B.Braun Medical

direktorius

A.V.

(parašas)

Kęstutis Liauba



B. Ramanauskas
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Daina Balčėtienė
2015-04-16

- 6.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 6.3 Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Prieš pateikdamas užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo duoti Tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
- 6.4 Užtikrinimas pateikiamas čia.
- 6.5 Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Tiekėjo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 6.6 Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 6.7 Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

7 straipsnis. Sutarties vykdymo programa (grafikas)

- 7.1 Prekės tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdytų Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytų Prekės(-ių) atvežimų surinkimu, instaliavimu, išbandymu, paleidimu, personalo apmokymu ir kt. Prekės(-ių) pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijų pateikimu, kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalausti.
- 7.2 Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekės(-ių) tiekimo grafiko keitimas.

8 straipsnis. Prekės(-ių) naudojimo ir priežiūros instrukcijos

- 8.1 Jei tai numatyta Techninėse specifikacijose, Tiekėjas kartu su Preke(-ėmis) turi pateikti Pirkėjui naudojimo, valymo, dezinfekcijos (jeigu reikalinga sterilizacija) nurodymus ir priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti, atlikti techninį aptarnavimą ir taisyti bet kurias Prekės(-ių) dalis.
- 8.2 Techninėse specifikacijose turi būti nustatytas naudojimo ir priežiūros instrukcijų kopijų kiekis ir kalba. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės(-ių) dalys.

9 straipsnis. Sutarties kaina

- 9.1 Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymas yra teisingas ir apimantis viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant visų su Preke(-ėmis) susijusių kaštų įskaičiavimą į įkainius ir pasiūlymo kainą.
- 9.2 Tiekėjas į kainą privalo įskaičiuoti visus su Preke(-ėmis) susijusius kaštus, įskaitant:
- a) transportavimo išlaidas;
 - b) pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Preke(-ėmis) susijusias administracines išlaidas;
 - c) visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - d) pristatytos(-ų) Prekės(-ių) surinkimo vietoje ir/arba paleidimo ir/arba šių darbų priežiūros išlaidas;
 - e) aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytos(-ų) Prekės(-ių) surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;
 - f) naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas;
 - g) Prekės(-ių) garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;
 - h) Pirkėjo darbuotojų apmokymo Tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas.

10 straipsnis. Mokesčiai ir maitai

- 10.1 Jokie šalyje gaminamų Prekės(-ių) gamybai taikomi vidaus fiskaliniai mokesčiai neatlyginami.
- 10.2 Jokie į Pirkėjo šalį įvežamai Prekei(-ėms) taikomi maito ir kiti importo mokesčiai neatlyginami.

11 straipsnis. Sutarties pakeitimai

- 11.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje

A. P...

[Signature]

- d) sudaryti sutartį su trečiąja šalimi dėl nepristatytos(-ų) Prekės(-ių) tiekimo. Tiekėjas už šią Sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, jis privalo padengti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

16 straipsnis. Prekės kokybė

- 16.1 Prekės(-ių) kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas ir kitus brėžinius, kiekius, modelius, pavyzdžius, matmenis, kokybės standartus bei kitus Sutarties reikalavimus.

17 straipsnis. Mokėjimai

- 17.1 Mokėjimai atliekami eurais.
17.2 Pirkėjas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.
17.3 Apmokėjimas įvykdomas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pasirašytas Prekės(-ių) perdavimo-priėmimo aktas ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra, pervedant pinigus į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke.
17.4 Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui nesumokėjus per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02% per dieną nuo vėluojamų sumokėti sumos delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos.

18 straipsnis. Prekės pristatymas

- 18.1 Tiekėjas pristato Prekę(-es) pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklės „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir yra pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Iki Prekės(-ių) priėmimo visa atsakomybė dėl jos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti Sutarties specialųjų sąlygų 1 straipsnyje.
18.2 Tiekėjas pasirūpina, kad Prekė(-ės) būtų pristatyta(-os) į priėmimo vietą, suderintą su Pirkėju, kad ji galėtų įforminti Prekę(-ių) priėmimą.
18.3 Tiekiamą(-os) Prekė(-ės) turi būti paženklinama(-os) „CE“ ženklu, pateikiant „CE“ sertifikatą.
18.4 Pristatydamas Prekę(-es), Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, kad Prekė(-ės) atitinka Sutarties ir techninių specifikacijų reikalavimus. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekė(-ės) būtų supakuota(-os) taip, kad ją(-as) gabenant į Sutartyje nurodytą vietą, ji(-os) nebūtų apgadinta ir nepablogėtų jos(-ų) kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį, turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos. Po Prekės(-ių) priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas pakuotes išveža ir organizuoja utilizavimą savo lėšomis.

19 straipsnis. Patikrinimai

- 19.1 Pirkėjas turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti Prekę(-es), jos(-ų) dalis ir darbo kokybę, taip pat tikrinti Prekę(-ių) paruošimą ir gamybą, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimties. Visi minėti tikrinimai atliekami ruošimo ar gamybos vietoje ar priėmimo vietoje.
19.2 Prekė(-ės) nebus priimama(-os), kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Tiekėjo sąskaita. Patikrinimai ir bandymai gali būti atlikti iki išsiuntimo, pristatant Prekę(-es) į pristatymo vietą ir (arba) į galutinę paskirties vietą.
19.3 Pirkėjas iki Prekės(-ių) priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:
 - iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti Prekę(-es), kuri(-ios) neatitinka Sutarties reikalavimų;
 - pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančią Prekę(-es) tinkama Prekė(-ėmis) ir parengti ją(-as) darbui pagal Sutarties reikalavimus;
 - Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.
19.4 Šio straipsnio nuostatos neapleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

20 straipsnis. Prekės(-ių) priėmimas

- 20.1 Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekė(-ės) atitinka Sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatyta(-os), instaliuota(-os), išbandyta(-os) ir paleista(-os) bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.
20.2 Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį Prekės(-ių) priimti neįmanoma, Pirkėjas,

- b) kai Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - c) kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo leidimo;
 - d) kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - e) dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
- 24.2 Nutraukiant sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, ar sukviets juos į susirinkimą, inventorizuoja pristatytą(-as) Prekę(-es), atliktus darbus ir pristatytas, bet nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.
- 24.3 Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi, išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pasinaudojant Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

25 straipsnis. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

- 25.1 Tiekėjas, prieš 14 dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:
- a) Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - b) Pirkėjas stabdo Prekę(-ių) ar jos(-ų) dalių pristatymą daugiau kaip 180 dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.
- 25.2 Tokio nutraukimo atveju Pirkėjas atlygina Tiekėjui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

26 straipsnis. Nenugalima jėga

- 26.1 Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po pirkimo nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 26.2 Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
- 26.3 Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
- 26.4 Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei Pirkėjas nenurodo jam to daryti.
- 26.5 Jei, vykdydamas Pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal šio straipsnio 4 dalį, Tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti Pirkėjas.
- 26.6 Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties įvykdymo.

27 straipsnis. Ginčų sprendimas

- 27.1 Ginčai tarp Sutarties Šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.
- 27.2 Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

28 straipsnis. Etika

- 28.1 Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą sutarties įvykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

A. P.

[Signature]

- 28.2 Sutartyje numatytas atlyginimas yra Tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.
- 28.3 Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius-43

Juridinio asmens kodas 124243848

Sąskaita Nr. LT507044060000325700

AB SEB bankas

banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas 242438412

Tel. (8 5) 216 9212

Faks. (8 5) 216 8984

UAB B.Braun Medical

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 11551739

Sąskaitos Nr. LT617044060001097040

AB SEB bankas

banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT115517314

Tel. (8 5) 2374333

Faks. (8 5) 2374344

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorius

A.V.

(parašas)

Dr. Algimantas Pamernickas

Uždarnosios akcinės bendrovės B.Braun Medical

direktorius

A.V.

(parašas)

Kęstutis Liauba



B. Damny
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Daina Balčėtienė
2015-04-16

- suderinę su Tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei Pirkėjas per 15 dienų ar kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo priėmimo-perdavimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti Prekę(-es), laikoma, kad jis pasirašė priėmimo-perdavimo aktą paskutinę šio laikotarpio dieną.
- 20.3 Jei Sutarties vykdymo programoje numatytas Prekės(-ių) dalių pristatymas etapais, Pirkėjas pasirašo Prekės(-ių) priėmimo-perdavimo aktą po kiekvieno Prekės(-ių) dalių pristatymo etapo.

21 straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

- 21.1 Jei sutartyje nenumatyta kitaip, Tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatyta(-os) Prekė(-ės) yra nauja(-os), nenaudota(-os). Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Prekė(-ės) yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijos arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant Prekę(-es) Pirkėjo šalies sąlygomis. Ši garantija galioja tiek, kiek numatyta Sutartyje.
- 21.2 Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:
- a) atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;
 - b) atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;
 - c) buvo pastebėti Pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant Prekę(-es).
- 21.3 Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekės(-ių) dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas Pirkėjui priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei Sutartyje numatytas Prekės(-ių) priėmimas dalimis, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik tomis Prekės(-ių) dalimis, kurias buvo keičiamos ar taisomos.
- 21.4 Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu įspėja apie tai Tiekėją. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba iš Tiekėjo garantijų, arba galimi abu variantai.
- 21.5 Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Pirkėjas kuo greičiau informuoja Tiekėją apie atliktus darbus.
- 21.6 Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti numatyti techninėse specifikacijose. Jei garantinio laikotarpio trukmė nenurodyta, o Prekei(-ėms) pagal jos savybes turi būti taikoma garantija, tuomet ji yra 365 dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

22 straipsnis. Garantinių įsipareigojimų įvykdymas

- 22.1 Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, pasibaigus paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, Pirkėjas išrašo Tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą. Jame nurodoma diena, kai Tiekėjas Pirkėjui priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą Pirkėjas privalo išrašyti per 30 dienų nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei Pirkėjas per 30 dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutinę šio laikotarpio dieną.
- 22.2 Kol Pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra Pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

23 straipsnis. Sutarties pažeidimas

- 23.1 Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
- 23.2 Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę:
- a) reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 - b) reikalauti atlyginti nuostolius;
 - c) pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
 - d) reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
 - e) nutraukti sutartį.

24 straipsnis. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

- 24.1 Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
- a) kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik nesmines Sutarties sąlygas.

- 11.2 Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šio keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12 straipsnis. Subtiekejai ir jų keitimo tvarka

- 12.1. Tiekejais subtiekėjų nepasitelks. Sutarties vykdymo metu subtiekejai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą

13 straipsnis. Patentai ir licencijos

- 13.1 Jei sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekejais garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekės(-ių) pavadinimo ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

14 straipsnis. Sutarties vykdymas

- 14.1 Sutarties vykdymo laikotarpis prasideda Sutarties įsigaliojimo dieną (kai šalys pasirašo Sutartį ir yra pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikinimas) ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 14.2 Per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjas, jei reikia, turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.
- 14.3 Jei dėl nuo Tiekejo nepriklausančių aplinkybių Tiekejais negali pristatyti nurodyto modelio Prekės(-ių), sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekejais gali pristatyti kito modelio Prekės(-es) su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.
- 14.4 Tiekejais gali paprašyti pratęsti Sutarties vykdymo laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:
- dėl Pirkėjo nurodymų, keičiančių Sutarties įvykdymo terminą;
 - dėl ypatingų oro sąlygų Pirkėjo valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Prekės(-ių) instaliavimui ar montavimui;
 - kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - kai ne dėl Tiekejo kaltės sustabdytas Prekės(-ių) tiekimas ir (arba) įdiegimas;
 - dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;
 - dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Tiekejo kaltės.
- 14.5 Esant nenumatytoms aplinkybėms, Prekės(-ių) pristatymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip nurodyta specialiuju šios Sutarties sąlygų 1.2 punkte. Prekės(-ių) pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 14.6 Per 14 dienų raštišku pranešimu Tiekejui Pirkėjas pratęsia vykdymo laikotarpį arba informuoja Tiekeją, kad laikotarpis nebus pratęstas.

15 straipsnis. Pristatymo terminų nesilaikymas

- 15.1 Jei Tiekejais dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę (-es) iki sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Pirkėjo vėluojamos(-ų) pristatyti Prekės(-ių) kaina mažinama 0,02 % nuo Prekės(-ių) vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.
- 15.2 Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 10% bendros Sutarties sumos delspinigių, ji gali, raštu įspėjusi Tiekeją:
- a) išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekejui mokėtinų sumų;
 - b) pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
 - c) nutraukti Sutartį (šiuo atveju Tiekejui nepriklauso jokia kompensacija);

BENDROSIOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

1 straipsnis. Aiškinimai

- 1.1 Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2 Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2 straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

- 2.1 Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 2.2 Sutarties kalba apibrėžiama Specialiųjų pirkimo sutarties sąlygų 6 straipsnio 6.1 dalyje. Visi dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti, vykdydamas Sutartį, turi būti pateikiami Specialiųjų pirkimo sutarties sąlygų 6 straipsnio 6.1 dalyje nurodyta kalba.

3 straipsnis. Įsipareigojimų pagal Sutartį perleidimas

- 3.1 Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

4 straipsnis. Perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos

- 4.1 Jei reikia, per 10 dienų nuo Sutarties Pasirašymo Pirkėjas Tiekėjui nemokamai pateikia brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties dokumentų kopijas. Esant galimybei, Tiekėjas gali nusipirkti daugiau šių brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų kopijų.
- 4.2 Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui ir/ar jos trūkumų pašalinimui.
- 4.3 Pirkėjas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti Tiekėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

5 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 5.1 Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti Sutartį, savo lėšomis atvežti Prekę(-es) Pirkėjui jo buveinės adresu į sandėlį, priderinti Prekęs (-ių) prijungimą prie pratiestų kabelių bei kanalų, sumontuoti, instaliuoti, suderinti, parengti eksploatacijai, išbandyti paleisti, apmokėti personalą bei atlikti kitus darbus, numatytus Sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant Prekęs(-ių) defektų šalinimą, ir įforminti montavimo dokumentaciją. Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, griežtai vadovaujantis gamintojo nurodymais ir instrukcijomis. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.
- 5.2 Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Tiekėjo ar jo darbuotojų, vykdančių Sutartį ir garantuoja galimų nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai, jei jai būtų keliami tokie reikalavimai.
- 5.3 Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo teisetus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Tiekėjas mano, kad Pirkėjo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Pirkėjui per 5 dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.
- 5.4 Tiekėjas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
- 5.5 Jei nėra būtina Sutartčiai vykdyti, Tiekėjas be išankstinio Pirkėjo sutikimo neturi teisės Pirkėjo pateiktų brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.
- 5.6 Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Pirkėju. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimais be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo yra laikomas Sutarties pažeidimu.
- 5.7 Tiekėjas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

6 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 6.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, jog Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas gali parengti naują Sutartį ir išsiųsti ją pasirašyti kitam Tiekėjui, kurio pasiūlymus užėmė antrą vietą. Užtikrinimo suma ir galiojimo terminas nurodyti Sutartyje.

38.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais . Skirtas instrumentu sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitiktį EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) arba lygiavertčius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio uždarymo indikatorį, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę. 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas daugiau arba lygu 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600mm300mm160mm , ±10 mm	2	KLS Martin. 55-442-15	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais . Skirtas instrumentu sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitiktį EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertčius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorį, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę. 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600 mm 300 mm 160 mm
39.	Silikoniniai kilimėliai	Silikoniniai kilimėliai skirti , kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 465mm245mm, ±10 mm	2	Aesculap AG, JF948	Silikoniniai kilimėliai skirti , kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm
40.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Būtina		Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	
41.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Būtina		Siūloma įranga nauja, nesūdoma naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	
42.	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVCL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lošomis	Būtina		Pristatyti įrangą į VŠĮ RVCL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lošomis	
43.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Būtina		Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	
44.	CE ženklavimas	Būtinas. Būtina pateikti žymėjimą CE ženklų patvirtinančio dokumento kopiją.		CE ženklavimas	

	0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 55 ± 5 mm	skersine išpjova, bendras ilgis 55 mm. FB369R
45.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakoy tipo arba lygiavertis, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 21 ± 1 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 55 ± 5 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakoy tipo, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 21 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 50 mm. FB352R
46.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 20 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 44 ± 5 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 19 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm. FB330R
47.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 34 ± 2 mm	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 mm. FB328R
48.	Kabliukas. Desmarres tipo arba lygiavertis, didelės lenkimo kreivės kablų dydis (gylis x plotis): (9x9) ± 1 mm, bendras ilgis 140 ± 10 mm	Kabliukas. Desmarres tipo, didelės lenkimo kreivės kablų dydis (gylis x plotis): (9x9) mm, bendras ilgis 140 mm. OA310R
49.	Kabliukas. Desmarres tipo arba lygiavertis, didelės lenkimo kreivės kablų dydis (gylis x plotis): (11x14) ± 0,5 mm, bendras ilgis 140 ± 10 mm	Kabliukas. Desmarres tipo, didelės lenkimo kreivės kablų dydis (gylis x plotis): (11x14) mm, bendras ilgis 140 mm. OA312R
50.	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 245 ± 15 mm ilgio	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 260 mm ilgio. BC279R
51.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 195 ± 10 mm ilgio	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 200 mm ilgio. BC265R
52.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 165 ± 20 mm ilgio	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 145 mm ilgio. BC261R
53.	Žirklys. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	Žirklys. Tonnis-Adson tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm. BC273B
54.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 143 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm. BC261B
55.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 190 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm. BC263B
56.	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm. BC259B
57.	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 115 ± 10 mm	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 115 mm. BC257B
58.	Žirklys. Fomon tipo arba lygiavertis, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 135 ± 3 mm	Žirklys. Fomon tipo, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 135 mm. OK372R
59.	Žirklys. Thorek tipo arba lygiavertis, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 185 ± 10 mm	Žirklys. Thorek tipo, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 180 mm. BC636R
60.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 143 ± 10 mm ilgio	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 145 mm ilgio. BC261R

16.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų $130 \pm 3^\circ$ laipsnių kampą, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 11 ± 2 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 ± 3 mm	1	Aesculap AG, FK903B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampą, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 180 mm
17.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų $130 \pm 3^\circ$ laipsnių kampą, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas $11 \text{ mm} \pm 2$ mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis $200 \text{ mm} + 10$ mm	1	Aesculap AG, FK916B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampą, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 200 mm
18.	Instrumentų krepšelis	Nerūdijančio plieno, perforuotas, su kojelėmis, pagamintomis iš termostabilius plastiko arba lygiavertės medžiagos. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(540 \text{ mm} \times 255 \text{ mm} \times 73 \text{ mm}) \pm 10$ mm, Su silikoniniu kilimėliu: išmatavimai (ilgis x plotis): $(520 \text{ mm} \times 240 \text{ mm}) + 10$ mm	1	Aesculap AG, JF223R, JF949	Nerūdijančio plieno, perforuotas, kojelėmis, pagamintomis iš termostabilius plastiko. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(540 \text{ mm} \times 253 \text{ mm} \times 76 \text{ mm})$, Su silikoniniu kilimėliu: išmatavimai (ilgis x plotis): $(517 \text{ mm} \times 242 \text{ mm})$
19.	Instrumentų krepšelis	Pritaikytas sudėti kaulines žnyples, su silikoniniais fiksatoriais, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(240 \text{ mm} \times 225 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}) \pm 10$ mm	1	Aesculap AG, JF120R	Pritaikytas sudėti kaulines žnyples, su silikoniniais fiksatoriais, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(240 \text{ mm} \times 225 \text{ mm} \times 161 \text{ mm})$
20.	Retraktorius mikrodisektoriui	Su dviem lankstais, viena ranka tvirtinama prie skirtingų dydžių sketiklių ir medialinių mentelių, kita prie skirtingų dydžių lateralinių mentelių, užsifiksuojančio mechanizmo rankenėle	1	Aesculap AG, BV812R	Su dviem lankstais, viena ranka tvirtinama prie skirtingų dydžių sketiklių ir medialinių mentelių, kita prie skirtingų dydžių lateralinių mentelių, užsifiksuojančio mechanizmo rankenėle
21.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos arba spalvotas $45 \text{ mm} \pm 3$ mm ilgio	3	Aesculap AG, BV800R	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 45 mm ilgio
22.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos arba spalvotas $55 \text{ mm} \pm 3$ mm ilgio	1	Aesculap AG, BV802R	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 55 mm ilgio
23.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos arba spalvotas $62 \text{ mm} \pm 3$ mm ilgio	2	Aesculap AG, BV804R	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos 65 mm ilgio
24.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos arba spalvotas, $75 \text{ mm} \pm 3$ mm ilgio	1	Aesculap AG, BV806R	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 75 mm ilgio
25.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos arba spalvotas $85 \text{ mm} \pm 3$ mm ilgio	1	Aesculap AG, BV808R	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos 85 mm ilgio

30.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitiktį EN285:2009. 93/42/EEC(MDD) arba lygiavertius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorį, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas daugiau arba lygu 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600mm300mm140mm, +10 mm	1	KLS Marrin, 55-442-13	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitinka EN285:2009. 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorį, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas daugiau 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600 mm 300 mm 140 mm
31.	Silikoniniai kilimėliai	Silikoniniai kilimėliai skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 395mm245mm, -10 mm	1	Aesculap AG, JF947	Silikoniniai kilimėliai skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 394 mm 242 mm
Mikrodissektomijos instrumentų komplektas stuburo operacijoms			1 kompl.		
1.	Retraktorius	Weitlaner tipo arba lygiavertis, kabliai 3x4, aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 130mm + 10 mm	1	Aesculap AG, BV071R	Weitlaner tipo, kabliai 3x4, aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 130 mm
2.	Retraktorius	Dockhorn tipo arba lygiavertis, lovelio formos kablo dydis (gylis x plotis): (55x14) – 5 mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 205 ± 5 mm	1	Aesculap AG, DO439R	Dockhorn tipo, lovelio formos kablo dydis (gylis x plotis): (55x14) mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 210 mm
3.	Retraktorius	Caspar tipo arba lygiavertis, lovelio formos kablo dydis (gylis x plotis): (67x17) – 3 mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 215mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, BT465R	Caspar tipo, lovelio formos kablo dydis (gylis x plotis): (67x17) mm, galas nulenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 210 mm
4.	Kablų	Caspar tipo arba lygiavertis, nervinėms šaknelėms, išlenktas kampais atgal ir pirmyn, 6 mm plūčiu, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240mm + 5 mm	1	Aesculap AG, FF699R	Caspar tipo, nervinėms šaknelėms, išlenktas kampais atgal ir pirmyn, 6 mm pločio, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240 mm

		instrumento ilgis 300mm + 5 mm			
15.	Mentelė	Olivecrona tipo arba lygiavertė, dvipusė, lenkta kampais į abi puses, plotis atitinkamai 11 mm ir 13 mm, lanksti, bendras ilgis 180mm ± 5 mm	1	Aesculap AG, FF217R	Olivecrona tipo, dvipusė, lenkta kampais į abi puses, plotis atitinkamai 11 mm ir 13 mm, lanksti, bendras ilgis 180 mm
16.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 130° ± 3° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9mm+1 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230mm – 10 mm	1	Aesculap AG, FK925B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm
17.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 130° ± 3° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10mm+1 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230mm – 10 mm	1	Aesculap AG, FK926B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm
18.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 130° ± 3° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12mm+1 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230mm ± 10 mm	1	Aesculap AG, FK927B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm
19.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 130° ± 3° kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12mm±1 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230mm + 10mm	1	Aesculap AG, FK928B	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° kampų, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm
20.	Žnyplės įvairios	Wagner tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,3mm + 0,3 mm, koto ilgis 200mm ± 10 mm	1	Aesculap AG, FF808R	Wagner tipo, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,5 mm, koto ilgis 200 mm
21.	Žnyplės	Tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,2mm ± 0,2 mm, koto ilgis 252 mm ± 10 mm	1	Aesculap AG, ND087R	Tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,3 mm, koto ilgis 250 mm
22.	Žnyplės	Caspar tipo arba lygiavertės, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 3mm±1 mm, koto ilgis 150mm ± 10 mm	1	Aesculap AG, FF833R	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 3 mm, koto ilgis 150 mm

16.	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo išlomis	Būtin a	Pristatyti įrangą į VŠĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo išlomis
17.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Būtin a	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
18.	CE ženklavimas		CE ženklavimas

3. Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas	Vieno vieneto įkainis, LTL be PVM	Kiekis (vnt.)	Suma LTL, be PVM	Vieno vieneto įkainis, EUR be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Amputacinių instrumentų rinkiniai	7 947,0000	1	7 947,0000	2 301,6103	2 301,6103
Bendra pasiūlymo kaina, LTL be PVM:				7 947,0000		
PVM tarifas (%): 21				PVM suma, LTL:	1 668,8700	
Bendra pasiūlymo kaina, LTL su PVM*:				9 615,8700		

Pirkimo dalis Nr. 12: Operaciniai instrumentų komplektai stuburo operacijoms

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedais „arba lygiavertis“.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Kiekis	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir prekės modelis (arba gamintojo suteiktas prekės kodas)	Parametro reikšmės atitikimas reikalavimams
	Bazinis instrumentų komplektas stuburo operacijoms		1 kompl.	Siūlomos prekės iš "Katalogas_12_pirkimo_dalis"	
1.	Kabliai	Caspar tipo arba lygiavertis, nervinėms šaknelėms, išlenktas kampais atgal ir pirmyn, 6 mm pločio, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240mm + 3 mm	2	Aesculap AG, FI 699R	Caspar tipo, nervinėms šaknelėms, išlenktas kampais atgal ir pirmyn, 6 mm pločio, distalinis galas lenktas ir nusmailėjantis, instrumento ilgis 240 mm
2.	Kabliai	Love tipo arba lygiavertis nervinių šaknelių retraktorius, išlenktas 90 laipsnių kampų, instrumento ilgis 205mm-15 mm	2	Aesculap AG, FF703R	Love tipo nervinių šaknelių retraktorius, išlenktas 90 laipsnių kampų, instrumento ilgis 220 mm
3.	Kabliai	Brunner tipo arba lygiavertis, stačiu kampu užlenkto kablo dydis (gylis x plotis): (180x30) ± 3 mm, rankena su skylėmis, instrumento ilgis 265mm + 15 mm	3	Aesculap AG, BT530R	Brunner tipo, stačiu kampu užlenkto kablo dydis (gylis x plotis): (180x30) mm, rankena su skylėmis, instrumento ilgis 275 mm

Pirkimo dalis Nr. 11: Amputaciniai instrumentų rinkiniai**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodymus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamyją (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarplautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įsitaigijusios techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedais „arba lygiavertis“.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Kiekis vnt.	Parametras reikšmė	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir prekės modelis (arba gamintojo suteiktas prekės kodas)	Parametro reikšmės atitikimas reikalavimams
1.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 179 + 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC263R	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm
2.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 179 + 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC263B	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm
3.	Žirklys. Tonus-Adson tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC273B	Žirklys. Tonus-Adson tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm
4.	Žirklys. Mayo tipo arba lygiavertis, lenktos, nusklenbtomis briaunomis, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 169 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC253B	Žirklys. Mayo tipo, lenktos, nusklenbtomis briaunomis, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 170 mm
5.	Adarkotis. Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, paviršius kryžmiškai dantytas, instrumento ilgis 185 + 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM236R	Adarkotis. Mayo-Hegar tipo, paviršius kryžmiškai dantytas, instrumento ilgis 185 mm
6.	Adarkotis. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatomis, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 185 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM066R	Adarkotis. Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatomis, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 185 mm

	prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 ± 15 mm				
22.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 ± 5 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Butina	Aesculap AG, FB418R	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 65 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm
23.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, lenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 ± 2 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB329R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, lenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 mm
24.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 18 ± 0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 44 ± 3 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB330R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 18 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm
25.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 ± 0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 ± 3 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BI1022R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 14 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 48 mm
26.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, LENKTAS, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 19 ± 0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 ± 2 mm	2	Butina	Aesculap AG, FB331R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, LENKTAS, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 19 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm
27.	Retraktorius. Metalinis strypas su adapteriu surinkimui prie operacinio stalo, dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu; Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais. Komplektacijoje ne mažiau 6 vnt. mentelių, kurių išmatavimai (gylis x plotis): (220x70) ± 5 mm, (220x50) ± 5 mm, (220x40) ± 5 mm	1	Būtina	Aesculap AG, "Munster": BV846R; BV844R; BV822R; BV825R- BV840R; BV966R; BV967R; BV956R; BV955R; RT092R; BV842R; RT069R; BV843R	Retraktorius. Metalinis strypas su adapteriu surinkimui prie operacinio stalo, dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu; Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais. Komplektacijoje ne mažiau 6 vnt. mentelių, kurių išmatavimai (gylis x plotis): (220x70) mm, (220x50) mm, (220x40) mm

	ilgis 26,5 ± 10 mm				
2.	Kablų. Brunner tipo arba lygiavertis, kablų dydis (gylis x plotis): (180x30) ± 2 mm, tolygus plotis, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 250 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BT513R	Kablų. Brunner tipo, kablų dydis (gylis x plotis): (180x30) mm, tolygus plotis, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 250 mm
3.	Kablų. Harrington-Pemberton tipo arba lygiavertis, dydis (gylis x plotis): (175x64) ± 2 mm, lankstus, distalinis galas širdies formos	1	Būtina	Aesculap AG, BT553R	Kablų. Harrington-Pemberton tipo, dydis (gylis x plotis): (175x64) mm, lankstus, distalinis galas širdies formos
4.	Kablų. Kocher tipo arba lygiavertis, kablų dydis (gylis x plotis): (40x18) ± 2 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 230 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BT369R	Kablų. Kocher tipo, kablų dydis (gylis x plotis): (40x18) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 230 mm
5.	Kablų. Kocher tipo arba lygiavertis, kablų dydis (gylis x plotis): (95x35) ± 5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 280 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BT498R	Kablų. Kocher tipo, kablų dydis (gylis x plotis): (94x36) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 280 mm
6.	Žirklių. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertin sluoksniu. Žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC271B	Žirklių. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm
7.	Žirklių. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais. Žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC275R	Žirklių. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm
8.	Žirklių. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC277R	Žirklių. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm
9.	Žirklių. Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC279R	Žirklių. Nelson-Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 mm
10.	Adatkotis. Hogar tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, stambus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 245 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM078R	Adatkotis. Hogar tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, stambus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 245 mm
11.	Adatkotis. Wangenstein tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 275 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BM042R	Adatkotis. Wangenstein tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 275 mm
12.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 82 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 280 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BJ106R	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 82 mm ilgio, bendras ilgis 280 mm

58.	Žirklys. Fomon tipo arba lygiavertės, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 135 ± 3 mm	1	Būtina	Aesculap AG, OK372R	Žirklys. Fomon tipo, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 135 mm
59.	Žirklys. Thorek tipo arba lygiavertės, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 185 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC636R	Žirklys. Thorek tipo, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 180 mm
60.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 143 ± 10 mm ilgio	1	Būtina	Aesculap AG, BC261R	Žirklys. Metzenbaum tipo, disekcinės, užapvalintais galiukais, lenktos, darbinės dalys su karbido indėklais, instrumento ilgis 145 mm ilgio
61.	Venų ekstraktoriaus. Nabatoff tipo arba lygiavertis, lankstus antgalis su plastikiniu galu ir metaliniais antgaliais: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Kitos sudedamosios dalys: T formos rankena su lanksčiu zondų, 900 ± 20 mm ilgio, metalinis dėklas su dangteliu visam rinkiniui	1	Būtina	Aesculap AG, 1B030R	Venų ekstraktoriaus. Nabatoff tipo, lankstus antgalis su plastikiniu galu ir metaliniais antgaliais: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Kitos sudedamosios dalys: T formos rankena su lanksčiu zondų, 900 mm ilgio, metalinis dėklas su dangteliu visam rinkiniui
62.	Disektorius. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenkti abu galai, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB120R	Disektorius. Varady tipo, dvipusis, lenkti abu galai, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm
63.	Fleboekstraktoriaus. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, disektorius/mažas kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB121R	Fleboekstraktoriaus. Varady tipo, dvipusis, disektorius/mažas kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm
64.	Fleboekstraktoriaus. Varady tipo arba lygiavertis, dvipusis, disektorius/didelis kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB122R	Fleboekstraktoriaus. Varady tipo, dvipusis, disektorius/didelis kabliukas, rankena šešiakampė, skersai dantyta, bendras ilgis 180 mm
65.	Mikro adarkotis. Tiesus, darbinės dalys padengtos deimantiniu paviršiumi, 5/0 ir mažesniems siūlams, rankenos spyruoklinuojančios, plokščios arba apvalios, skersai dantytos su užrakinimu, instrumento ilgis 185 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FM564R	Mikro adarkotis. Tiesus, darbinės dalys padengtos deimantiniu paviršiumi, 5/0 ir mažesniems siūlams, rankenos spyruoklinuojančios, apvalios, skersai dantytos su užrakinimu, instrumento ilgis 185 mm
66.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitiktį EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) standartus arba lygiavertius. Konteineris su indikatoriais galimybė, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 150 mm $\pm$ 30 mm.	1	Būtina	Aesculap AG, JK442; JP001-JP006; JG744	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, atitiktį EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteineris su indikatoriais galimybė, kuris informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio apatinė dalis ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobų barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrus, ne mažiau 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm

38.	Spaustukas. Derra-Cooley arba lygiavertis, atraumatinis, rankenos lenktos kampu į išorę, distalinis galas užlenktas kampais į vidų, žiaunos visame paviršiuje susikabina dantukais, su išilgine centrine ertme, darbinės dalies lanko ilgis 17 ± 2 mm, bendras ilgis 170 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB725R	Spaustukas. Derra-Cooley, atraumatinis, rankenos lenktos kampu į išorę, distalinis galas užlenktas kampais į vidų, žiaunos visame paviršiuje susikabina dantukais, su išilgine centrine ertme, darbinės dalies lanko ilgis 16 mm, bendras ilgis 170 mm
39.	Spaustukas. Castaneda tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunų galai užlenkti kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 ± 3 mm, darbinės dalies ilgis 46 ± 6 mm, instrumento ilgis 155 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB591R	Spaustukas. Castaneda tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunų galai užlenkti kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 mm, darbinės dalies ilgis 52 mm, instrumento ilgis 155 mm
40.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB448R	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm
41.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB449R	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm
42.	Aortos spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 55 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 95 ± 5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 305 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, MB676R	Aortos spaustukas. De Bakey tipo, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos nežymiai išlenktos į išorę, žiaunos lenktos puslankiu į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 60 mm, darbinės dalies ilgis 100 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 300 mm
43.	Spaustukas. De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos gali būti išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 45 ± 5 mm, darbinės dalies ilgis 65 ± 5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 195 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB461R	Spaustukas. De Bakey lygiavertis, atraumatinis su dantukais ir grioveliais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, rankenos gali būti išlenktos į išorę, žiaunos lenktos kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 47 mm, darbinės dalies ilgis 70 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 195 mm
44.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo arba lygiavertis, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tolygiai išlenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis $20 \pm 0,5$ mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 55 ± 5 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB369R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tolygiai išlenktas, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 20 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 55 mm
45.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo arba lygiavertis, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 21 ± 1 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 55 ± 5 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB352R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". De Bakey tipo, su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 21 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 50 mm
46.	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 20 ± 2 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 44 ± 5 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB330R	Atraumatinis spaustukas "šuniukas". Su dantukais 1x2 visame darbiniam paviršiuje, tiesus, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 19 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 45 mm

	žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm				instrumento ilgis 200 mm
15.	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC259B	Žirklys. Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm
16.	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC259B	Žirklys. Lenktos, smulkios, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm
17.	Žirklys. Ligatūrinės, bukos, darbinė dalis su karbido indėklais, vienos branduolio asmenys dantyti, ilgalaikis vienodas pjūvimo branduolio smaigalyje ir gale, vienas žiedas gali būti spalviškai pažymėtas, instrumento ilgis 180 ± 10 mm ilgio	2	Būtina	Aesculap AG, BC295W	Žirklys. Ligatūrinės, bukos, darbinė dalis su karbido indėklais, vienos branduolio asmenys dantyti, ilgalaikis vienodas pjūvimo branduolio smaigalyje ir gale, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, instrumento ilgis 180 mm ilgio
18.	Žirklys. Fomon tipo arba lygiavertės, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 150 ± 15 mm	1	Būtina	Aesculap AG, OK372R	Žirklys. Fomon tipo, stipriai lateraliai lenktos, bukos, bendras ilgis 135 mm
19.	Žirklys. Thorek tipo arba lygiavertės, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 180 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BC636R	Žirklys. Thorek tipo, stipriai užlenktos, bukos, bendras ilgis 180 mm
20.	Spaustukas. Baby-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH105R	Spaustukas. Baby-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100 mm
21.	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH111R	Spaustukas. Halsted-Mosquito tipo, hemostatinis, lenktas į vidų, smulkus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm
22.	Spaustukas. Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova, bendras ilgis 150 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH161R	Spaustukas. Leriche tipo, lenktas, su skersine išpjova, bendras ilgis 150 mm
23.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 38 ± 2 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB447R	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 40 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 155 mm
24.	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 45 ± 5 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160 ± 10 mm	1	Būtina	Aesculap AG, FB446R	Spaustukas. De Bakey-Bainbridge tipo, atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 40 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 155 mm
25.	Spaustukas. Atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 20 ± 1 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, FB441R	Spaustukas. Atraumatinis, su 1x2 dantukais visame darbiniam 20 mm ilgio paviršiuje, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm
26.	Spaustukas. Crafoord tipo arba lygiavertis, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 65 ± 10 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 245 ± 10 mm	2	Būtina	Aesculap AG, BH225R	Spaustukas. Crafoord tipo, hemostatinis, delikatus, lenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 72 mm ilgio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 245 mm

Komentaras (0) Veiksmai			
☐ Igaliojimas Graina B.Braun Medical.pdf (Igaliojimas Graina B.Braun Medical.pdf)		75	2014-09-17 09:32
Komentaras (0) Veiksmai			
☐ Igaliojimas KLS Martin.pdf (Igaliojimas KLS Martin.pdf)		136	2014-09-17 09:32
Komentaras (0) Veiksmai			
☐ Braun Draudimo polisas_0584-s0821.pdf (Braun Draudimo polisas_0584-s0821.pdf)		6450	2014-09-24 12:36
Komentaras (0) Veiksmai			
☐ Pasiūlymo laidavimo rėstas.pdf.pdf (Pasiūlymo laidavimo rėstas.pdf.pdf)		423	2014-09-24 12:36
Komentaras (0) Veiksmai			

Kainos pasiūlymo dokumento pabaiga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalis Nr. 9: Kraujagyslių instrumentų rinkiniai

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkandčiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priešais „arba lygiavertis“.

2. Perkandčiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

EH. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Kieki s vnt.	Param etro reikšm ė	Sinlomos prekės gamintojo pavadinimas ir prekės modelis (arba gamintojo suteiktas prekės kodas)	Parametro reikšmės atitikimas reikalavimams
1.	Plėtėjas. Adson tipo arba lygiavertis, kabliai 4x5, aštrūs arba pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 260 ± 50 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BV273R	Plėtėjas. Adson tipo, kabliai 4x5, pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 320 mm
2.	Plėtėjas. Adson tipo arba lygiavertis, kabliai 4x5, aštrūs arba pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 150 ± 15 mm	1	Būtina	Aesculap AG, BV094R	Plėtėjas. Adson tipo, kabliai 4x5, pusiau aštrūs, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 165 mm

06 El. paštas

mantas.avagzdys@bbr.un.lt

Pasiūlymo duomenys

Klausimų skaičius: 1

- 07 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kuname dalyvauti kvietimą gavome/kuris buvo paskelbtas (nurodyti datą): 2014 08 04
- 08 Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 09 Pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus, įskaitant pirkimo sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus (jei tokie buvo).
- 10 Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes priimsime riziką už visas išlaidas, kunas, teikdami pasiūlymą ir laikydami pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pasiūlymo kaina

Klausimų skaičius: 1

- 11 Pridedame elektroninėje byloje „xlsx“ formatu užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“. Pridedame

PASTABOS:

1. Pasiūlymas turi būti teikiamas nepadarius jokių perkančiosios organizacijos parengtos elektroninės bylos pakeitimų.

2. Įkeliami dešinėje pusėje spaudžiant "aplanko" ikonėlę su raudonu šauktuku.

Kiti dokumentai ir informacija

Klausimų skaičius: 5

- 13 Kvalifikacijos atitikties deklaracija (parengta pagal su pirkimo dokumentais skelbiama formą). ✓Pridedame

PASTABOS:

1) Atliktą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų, nurodytų skelbime apie pirkimą skaitmeninės kopijos bus reikalaujamos tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymą pagal vertinimo rezultatus bus numatoma pripažinti laimėjusiu.

2) Skelbime apie pirkimą nurodytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas turi atitikti pasiūlymo pateikimo dieną ir gavus perkančiosios organizacijos prašymą pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

- 14 Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Netaikoma

- 15 Dokumento, įgaliojančio tiekėją atstovaujantį asmenį pasirašyti pasiūlymą skaitmeninė kopija (jei pasiūlymą pasirašo ne pasiūlymą teikiančio juridinio asmens vadovas, o įgaliotas asmuo). Pridedame

- 16 Numatomų pasitelkti subteikėjų, subteikėjų ar subrangovų pavadinimai. Subteikėjai, subteikėjai ar subrangovai sutarties vykdymui nebus pasitelkiami.

PASTABA. Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, subteikėjai ar subrangovai. Jeigu tiekėjas informacine

Kvalifikacija

1

23.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos 65 mm ilgio. BV804R
24.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos, 75mm ilgio. BV806R
25.	Sketiklis	Laiptuotas, fenestruotas, distalinis galas su dantukais, užlenktas į išorę, juodos spalvos 85 mm ilgio. BV808R
26.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, su dantukais, juoda. 35 mm ilgio. BV870R
27.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda 45 mm ilgio. BV872R
28.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda. 55 mm ilgio. BV874R
29.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į išorę, juoda. 65 mm ilgio. BV876R
30.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 75 mm ilgio. BV877R
31.	Mentelė	Lateralinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 85 mm ilgio. BV878R
32.	Žnyplės	Viena darbinė dalis dvidantė, kita su smeigu, skirtos mentelių pakeitimui ir pritvirtinimui prie retraktoriaus. BV399R
33.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 40 mm ilgio. BV851R
34.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 50 mm ilgio. BV853R
35.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 60 mm ilgio. BV855R
36.	Mentelė	Medialinė, darbinis paviršius įgaubtas, distalinis galas užlenktas į vidų, juoda, 70 mm ilgio. BV857R
37.	Instrumentų krepšelis	Su specialiu dėkle, skirtu sudėti visų aukščiau išvardinto retraktoriaus mentelėms ir sketikliams, kitoms retraktoriaus dalims, kiekvienam instrumentui numatyta stabiliai įfiksuojanti vieta. Krepšelis su kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 mm 253 mm 76 mm). FG171P; FG172P, JF223R
38.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentu sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. atitikti EN285:2009, 93/42/EEC(MDD) lygiavertius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorius, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas. Konteinerio dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą MicroStop barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtri, efektyvumas 99,99997. Turi integruotus žymėjimo etiketę laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai 600 mm 300 mm 160 mm. 55-442-15
39.	Silikoniniai kilimėliai	Silikoniniai kilimėliai skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm. JF948
40.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
41.	Situloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Situloma įranga nauja, nesiūloma naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
42.	Pristatyti įrangą į VėĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis	Pristatyti įrangą į VėĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis
43.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
44.	CE ženklavimas	CE ženklavimas

4.	Kabliai	Pagamintas iš anglies pluošto polimero medžiagos, pralaidus rentgeno spinduliams, juodos spalvos, itin lengvas, kablo dydis (gylis x plotis): (140x40) mm, rankena su skylemis ir atramomis, instrumento ilgis 255 mm. BT545P
5.	Disektoriai	Mac Donald tipo, dvipusis, viena lopetėlė tiesi, kita lenkta, bukas/bukas, abiejų distaliniai galai 5 mm pločio, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 190 mm. FK291R
6.	Disektoriai	Killian tipo, dvipusis, viena lopetėlė nežymiai lenkta, kita lenkta, aštrus/bukas, rankena apvali, skersai dantyta paviršiumi, bendras ilgis 185 mm. OL170R
7.	Raspatoriai	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 10 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm. FK146R
8.	Raspatoriai	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 13 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm. FK147R
9.	Raspatoriai	Cobb tipo, darbinė dalis per vidurį susiaurėjanti, distaliniam gale išplatėjanti, ovali, plokščia, 19 mm pločio, rankena masyvi, apvali, kryžmiškai dantyta, bendras ilgis 280 mm. FK148R
10.	Kaltas	Stille tipo, darbinis paviršius lovelio formos, 12mm pločio, rankena masyvi, su gumbu patogiam kalimui, bendras ilgis 205 mm. FL574R
11.	Šaukštas	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, nulinio dydžio, tiesi, nukreipta aukštyn, bendras ilgis 240 mm. MI296R
12.	Šaukštas	Bajoneto formos rankena, darbinė dalis ovali, pirmo dydžio, nukreipta įstrižu kampu aukštyn, bendras ilgis 240 mm. MI300R
13.	Šaukštas	Caspar tipo, profilis nežymiai lenktas, darbinė dalis ovali, 3,6 mm pločio, rankena pagaminta iš PEEK medžiagos, bendras ilgis 220 mm. FK773R
14.	Mentelė	Harrington-Pemberton tipo, dydis (gylis x plotis): (175x64) mm, lankstus, distalinis galas širdelės formos, instrumento ilgis 295 mm. BT553R
15.	Mentelė	Olivocuna tipo, dvipusė, lenkta kampais į abi puses, plotis atitinkamai 11 mm ir 13 mm, lanksti, bendras ilgis 180 mm. FF217R
16.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm. FK925B
17.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm. FK926B
18.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° laipsnių kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm. FK927B
19.	Žnyplės kaulinės	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 130° kampu, išardomos, žemo profilio, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, visas instrumentas padengtas apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, su ežektoriumi, bendras ilgis 230 mm. FK928B
20.	Žnyplės įvairios	Wagner tipo, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,5 mm, koto ilgis 200 mm. FF808R
21.	Žnyplės	Tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,3 mm, koto ilgis 250 mm. ND087D
22.	Žnyplės	Caspar tipo, tiesios, juda viršutinė dalis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 3 mm, koto ilgis 150 mm. FF833R
23.	Žnyplės	Caspar tipo, nukreiptos į viršų 150° kampu, juda viršutinė dalis, darbinė dalis 3 mm pločio, koto ilgis 150 mm. FF843R
24.	Žnyplės	Caspar tipo, nukreiptos žemyn 150° kampu, juda apatinė dalis, darbinė dalis 3 mm pločio, koto ilgis 150 mm. FF853R
25.	Žnyplės	Sauerbruch-Coryllos tipo, 4 šarvyrių lankstų sistema, masyvos, smarkiai praplatėjusios į distalinį galą, rankenos spyruokliuojančios, su atrama, bendras ilgis 310 mm. FO570R
26.	Žnyplės	Rollgen-Ruskin tipo, lenktos į šoną, 4 šarvyrių lankstų sistema, darbinė dalis 5 mm pločio, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis 240 mm. FO521R
27.	Žnyplės	Beckmann-Faton tipo, septyniagis, aštrus, kabliukai susiliočia, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 320 mm. BV276R
28.	Žnyplės	Adson tipo, kabliai 4x5, pusiau aštrus, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, su lankstais, reguliuojasi kablių pasvyrimo kampas, instrumento ilgis 320 mm. BV273R
29.	Žnyplės	Norfolk and Norwich tipo, kabliai 4x5, luki, kabliukai persipina, rankena su užrakinimu, instrumento ilgis 220 mm. BV248R
30.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais. Skirtas instrumentu sterilizavimui, gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui, turi atitinka EN285:2009, 93/42/EFC(MDD) lygiavertius standartus. Konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorius, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar

	turi apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 600 mm 300 mm 150 mm ± 30 mm.	saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama. Dangtis turi įmontuotą mikrobu barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, turi 2 daugkartinio naudojimo filtrus, ne mažiau 5000 ciklų. Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Išmatavimai: 592 mm 285 mm 157 mm, JK442: JP001-JP006; JG744
29.	Silikoniniai kilimėliai. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 460 mm 250 mm, ± 30 mm	Silikoniniai kilimėliai. Skirti, kaip apsaugos sterilizuojant instrumentus frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Išmatavimai 472 mm 242 mm. JP948
30.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpis tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 24 mėn. laikotarpis tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
31.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.	Siūloma įranga nauja, nesiūloma naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
32.	Pristatyti įrangą į VSĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis	Pristatyti įrangą į VSĮ RVUL. Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų. Pakuotes išvežti ir utilizuoti tiekėjo lėšomis
33.	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis	Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir sterilizavimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis
34.	CE ženklavimas	CE ženklavimas

II DALIS

Amputaciniai instrumentų rinkiniai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė su nuoroda į gaminto kodą kataloge, psl. Nr.
1.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 179 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm. BC263R
2.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 179 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm. BC263B
3.	Žirklys. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 ± 10 mm	Žirklys. Tonnis-Adson tipo, lenktos, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 175 mm. BC273B
4.	Žirklys. Mayo tipo arba lygiavertės, lenktos, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 169 ± 10 mm	Žirklys. Mayo tipo, lenktos, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 170 mm. BC253B
5.	Adaktotis. Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, paviršius kryžmiškai dantytas, instrumento ilgis 185 ± 10 mm	Adaktotis. Mayo-Hegar tipo, paviršius kryžmiškai dantytas, instrumento ilgis 185 mm. BM236R
6.	Adaktotis. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatomis, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 185 ± 10 mm	Adaktotis. Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, delikatus, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir smulkesnėms chirurginėms adatomis, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 185 mm. BM066R
7.	Raspatorius. Mc Kisco tipo arba lygiavertis, darbinė dalis išplatėjanti, plokščia, nusmailinta įžambiai, 12 + 1 mm pločio, rankena masyvi, bendras ilgis 195 ± 10 mm	Raspatorius. Mc Kisco tipo, darbinė dalis išplatėjanti, plokščia, nusmailinta įžambiai, 11 mm pločio, rankena masyvi, bendras ilgis 195 mm. FK379R

	kiaurymėmis, bendras ilgis 250 ± 10 mm	250 mm. BT513R
3.	Kablų. Harrington-Pemberton tipo arba lygiavertis, dydis (gylis x plotis): $(175 \times 64) + 2$ mm, lankstus, distalinis galas širdelės formos	Kablų. Harrington-Pemberton tipo, dydis (gylis x plotis): (175×64) mm, lankstus, distalinis galas širdelės formos. BT553R
4.	Kablų. Kocher tipo arba lygiavertis, kablų dydis (gylis x plotis): $(40 \times 18) \pm 2$ mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 230 ± 10 mm	Kablų. Kocher tipo, kablų dydis (gylis x plotis): (40×18) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 230 mm. BT369R
5.	Kablų. Kocher tipo arba lygiavertis, kablų dydis (gylis x plotis): $(95 \times 35) + 5$ mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 280 ± 10 mm	Kablų. Kocher tipo, kablų dydis (gylis x plotis): (94×36) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 280 mm. BT498R
6.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiavertiu sluoksniu, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido sluoksniu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm. BC271B
7.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm. BC275R
8.	Žirklys. Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 ± 10 mm	Žirklys. Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm. BC277R
9.	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai gali būti spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 ± 10 mm	Žirklys. Nelson-Metzenbaum tipo, lenktas, užapvalintais siaurėjančiais galiukais, darbinės dalys su karbido indėklais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 mm. BC279R
10.	Adaktotis. Hegar tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su karbido indėklais, stambus, paviršius kryžmiškai dantytas $0,5$ mm žingsniu, tinkamas $3/0$ ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 245 ± 10 mm	Adaktotis. Hegar tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, stambus, paviršius kryžmiškai dantytas $0,5$ mm žingsniu, tinkamas $3/0$ ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 245 mm. BM078R
11.	Adaktotis. Wangenstein tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas $0,5$ mm žingsniu, tinkamas $3/0$ ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 275 mm	Adaktotis. Wangenstein tipo, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas $0,5$ mm žingsniu, tinkamas $3/0$ ir smulkesnioms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 275 mm. BM042R
12.	Disektorius. Gemini tipo arba lygiavertis, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 82 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 280 ± 10 mm	Disektorius. Gemini tipo, lenktas, siauras, dantytos dalies ilgis 82 mm ilgio, bendras ilgis 280 mm. BJ106R
13.	Disektorius. Rumel tipo arba lygiavertis, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 38 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 240 ± 10 mm	Disektorius. Rumel tipo, stipriai lenktas, dantytos dalies ilgis 37 mm ilgio, bendras ilgis 240 mm. BJ045R
14.	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytos dalies ilgis 39 ± 2 mm, bendras ilgis 230 ± 10 mm	Disektorius. Overholt-Geissendoerfer tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 39 mm, bendras ilgis 230 mm. BJ025R
15.	Disektorius. Baby-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytos dalies ilgis 15 ± 2 mm ilgio, bendras ilgis 185 ± 10 mm	Disektorius. Baby-Adson tipo, lenktas, dantytos dalies ilgis 15 mm ilgio, bendras ilgis 185 mm. BJ014R
16.	Spaustukas. De Bakky tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1×2 dantukais visame darbiniam 80 ± 2 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakky tipo, atraumatinis, su 1×2 dantukais visame darbiniam 80 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240 mm. FB456R
17.	Spaustukas. De Bakky tipo arba lygiavertis, atraumatinis, su 1×2 dantukais visame darbiniam 50 ± 2 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 ± 10 mm	Spaustukas. De Bakky tipo, atraumatinis, su 1×2 dantukais visame darbiniam 50 mm ilgio paviršiuje, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 170 mm. FB552R