

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LS- 268

2016 m. gruodžio mėn. 30 d., Alytus

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, veikiančio pagal ligoninės įstatus, ir UAB „Vitrolab“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujama Vytautas Jančiauskis, laimėjusi 2016 m. gruodžio mėn. 27d. vykdytas neskelbiamas derybas, „**Laboratoriniai reagentai**“ (toliau – **Prekės**), kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

1.2. Sutarties dalykas yra **laboratoriniai reagentai** (toliau - „**Prekės**“), kurių specifikacija ir kaina nurodyta sutarties priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Tiekiamos Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.

2.2. Tiekiamos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2.3. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.4. Prekės pateikimo momentu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei vieneri kalendoriniai metai.

2.5. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis 5 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

2.6. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

2.7. Prekių kokybė ir pavadinimas turi atitikti konkursui pateiktų pavydžių kokybę ir pavadinimą.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Šalys susitarė, kad **sutarties suma yra 70 629,07(septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni Eur 07 ct) su PVM.**

3.2 Prekių kaina sąskaitose-faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.3 Prekių kainos nurodytos neskelbiamų derybų pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 8.1. punkte nurodytai sąlygai.

3.4 Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš VLK (PSDF) bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.5 Į Prekių kainą įeina PVM, transportavimo, krovimo, įpakavimo, ženklinimo, taros ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

4. Prekių perdavimas ir priėmimas

4.1 Pardavėjas perduoda Prekes pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą. Pirkėjas užsakymus vykdo kiekvieną mėnesį.

4.2 Pardavėjas garantuoja numatytą Prekių tiekimą pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą.

4.3 Užsakytas Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui, per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo į Ligoninės laboratoriją adresu Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus.

4.4 Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4.5 Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir 7 kalendorinių dienų laikotarpyje pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 30% nepristatytų prekių vertės bauda.

5.3. Už prievolių, numatytų šioje sutartyje nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo visos sutarties sumos.

5.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigių po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

7. SubtiekJai (jeigu pasitelkiami)

7.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtieKėjus _____ (išvardinti subtieKėjus) tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti _____ (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

7.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtieKėjus, tačiau pakeisti subtieKėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtieKėjai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtieKėjai, draudžiama.

8. Kitos sutarties sąlygos

8.1. Sutarties prekių kaina ir (ar) atskirų prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Pardavėjo tiekiamų prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

8.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo datos.

8.3. Kitos pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8.4. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs (orientaciniai). Prekės užsakymo vykdymo laikotarpiu perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų Sutartyje nurodytų prekių kiekį per užsakymo vykdymo laiką. Perkančioji organizacija gali nupirkti ir didesnę prekių kiekį, nei nurodyta, bet ne daugiau kaip 30 procentų.

8.5. Pateiktos prekės turi būti supakuotos ir sudėtos dėžėse. Kiekvienoje dėžėje turi būti reagentų anotacija lietuvių kalba. Ant kiekvieno vieneto nurodomas serijos numeris (atitinkantis nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje) ir reagentų galiojimo laikas. Pristatant reagentus nuo jų galiojimo laiko turi būti praėję ne daugiau kaip 20% viso galiojimo laiko.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio mėn. 30d. ir galioja 6 mėn.

9.2. Šia Sutartimi Pirkėjas Prekių užsakymus vykdo nuo 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. iki 2017 m. birželio mėn. 29 d.

9.3. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

9.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimo atveju, šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, turi sumokėti kitai šaliai 10% baudą skaičiuojamą nuo visos sutarties sumos.

9.5. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

Pirkėjas:

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus

Įmonės kodas 190272175

a/sLT737300010091752982

AB Swedbank, b/k 73000

Tiekėjas:

UAB „Vitrolab“



Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas

Įmonės kodas 235279070

a/s LT82 7044 0600 0288 6700

AB SEB bankas, b.k. 70440

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

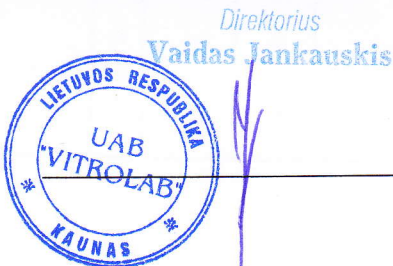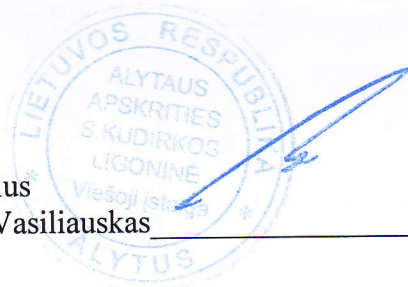

Eil. Nr.	Tyrimas	Preliminarus tyrimų skaičius 6 mėnesių laikotarpiui	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Siūloma pakuotė	Poreikis pakuotėms pagal nurodytą tyrimų skaičių	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Bendra suma EUR su PVM	Komercinis pavadinimas, gamintojas, pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	8 pirkimo objekto dalis REAGENTAI AUTOMATINIŲ IMUNOHISTOKEMIŠKŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI									
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai automatiniam imunohistokemiškam analizatoriui Turi būti visiškai automatizuota testavimo sistema skirta kraujo grupės, antikūnams ir suderinamumo testavimui. Sistema turi turėti automatinių skysčių pipetavimą, kasetės laikymą, inkubaciją, centrifugavimą ir reakcijos gradavimą ir interpretavimą. Turi būti galimybė į analizatorių vienu metu įdėti įvairių parametrų tyrimų asortimento kasetes pagal poreikį. Turi būti užtikrinta STAT funkcija eksperimentams tyrimams t.y. be pauzų, netaikant rutininių tyrimų atlikimo, ne mažiau nei šešiams tyrimams. Vienu metu iš to paties mėginio turi būti galimybė atlikti visą reikiamų parametrų spektrą. Turi būti galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, nuskaitytomis iš abiejų kortelės pusių, su galimybe išsiskirti vaizdą.									
	Kraujo grupių ir rėzus antigenų nustatymas(Anti A-B-D ir CDE nustatymas)	70	Monokloniniai reagentai. Plastikinė kortelė iš šešių stulpelių paruošta naudoti. Centrifugavimas ne ilgiau 5min. Antiglobulinas IgG,- C3d, polispecifinis(Kumbo reagentas) paruoštas naudoti. Centrifugavimas ne ilgiau 5min. Antigenų anti-D(D VI) ir anti- D(D IAT) reagentas skirtas kokybiniam in vitro žmogaus kokybiniam RHD aptikimui, taikant tiesioginį aglutinacijos ir netiesioginį antiglobulino testą. Visi tyrimai turi būti tinkamai atlikti ir rankiniu būdu.	Atitinka	20 kort.x 6st.					
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Kraujo grupės patvirtinimas ABD*ABD	300			20 kort.x 6st.					
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Kraujo grupės nustatymas silpnam D	5			20 kort.x 6st.					
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Kraujo grupės nustatymas kartu su reversu ir su kontrole	600			20 kort.x 6st.					
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Antikūnų nustatymas	1000								
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (rašyti tikslus pavadinimus)				20 kort.x 6st.					
	Suderinamumo mėginys	500			20 kort.x 6st.					

[illegible]


Eil. Nr.	Tyrimas	Preliminarus tyrimų skaičius 6 mėnesių laikotarpiui	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Siūloma pakuotė	Poreikis pakuotėms pagal nurodytą tyrimų skaičių	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Bendra suma EUR su PVM	Komercinis pavadinimas, gamintojas, pastabas
	Troponinas I	2500	Matavimo ribos 0,1-22µg/L. Reagento stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 15d. Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne didesnis nei 10%CV nuokrypis. Matavimo laikas ne ilgiau 20min. Metodas fluorometrinis.	ATITINKA	10x16 tyr.	16				
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomų analizatorių (rašyti tikslus pavadinimus)									
	NT- pro BNP (natriuretinis peptidas)	1200	Matavimo ribos 15-3400ng/L. Reagento stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 21d. Matavimo laikas ne ilgiau 10min. metodas fluorometrinis.	ATITINKA	10x16 tyr.	7,5				
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomų analizatorių (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Prokalcitoninas	500	Matavimo ribos 0,15 -100 ng/ml. Reagento stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 7d. Matavimo laikas ne ilgiau 20min. Metodas fluorometrinis.	ATITINKA	10x8 tyr.	6,25				
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomų analizatorių (rašyti tikslus pavadinimus)									
	C-reaktyvus baltymas	600	Matavimo ribos 5 -500 mg/L. Reagento stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 14d. Matavimo laikas ne ilgiau 15min. metodas fluorometrinis.	ATITINKA	10x8 tyr.	7,5				
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomų analizatorių (rašyti tikslus pavadinimus)									
	Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatacijai									
	AQT90 FLEX Multi CHECK komplektas				komplektas (3 lygiai)	2				
	AQT90 FLEX PCT CHECK komplektas				komplektas (2 lygiai)	2				
	AQT90 FLEX LQC CRP CHECK komplektas				komplektas (2 lygiai)	2				

4

Eil. Nr.	Tyrimas	Preliminarus tyrimų skaičius 6 mėnesių laikotarpiui	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Siūloma pakuotė	Poreikis pakuotėmis pagal nurodytą tyrimų skaičių	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Bendra suma EUR su PVM	Komercinis pavadinimas, gamintojas, pastabos
	pH, Kraujo dujos (pO ₂ , pCO ₂), Elektrolitai (K, Na, Cl, Ca jonizuotas), Metabolitai (GLU, LAC, tBIL), Oksimetrijos parametrai (tHb, sO ₂ , COHb, HbF, HHb, MetHb, O2Hb)	2000	Matavimo ribos: pH 6,0 - 7,9. Elektrodo stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 15 mėn. pO ₂ 0-790 mm/Hg. pCO ₂ 5-245 mm/Hg. Elektrodo stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 15 mėn. K-0,6-24 mmol/L, Na-8-240 mmol/L, Cl-8	ATITINKA						
					1 but (200 ml)	6				
					1 but (200 ml)	3				
					1 but (600 ml)	18				
					1 but	1				
					1 pak.	1				
					1 but (175 ml)	5				
	Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatavimui									
	942-058 Referentinės membranos D711				1 pak. (4 membr.)	0,5				
	942-059 K membranos D722				1 pak. (4 membr.)	0,25				
	942-060 Ca membranos D733				1 pak. (4 membr.)	0,25				
	942-061 Cl membranos D744				1 pak. (4 membr.)	0,25				
	942-062 Na membranos D755				1 pak. (4 membr.)	0,25				
	942-063 pCO ₂ membranos D788				1 pak. (4 membr.)	0,5				
	942-064 pO ₂ membranos D799				1 pak. (4 membr.)	0,5				
	942-065 Gliukozės membranos D7066				1 pak. (4 membr.)	1				
	942-066 Laktoato membranos D7077				1 pak. (4 membr.)	1				
	944-074 S7735 AutoCheck TM 5+ 1 lygis				30 amp.x2ml	1				
	944-075 S7745 AutoCheck TM 5+ 2 lygis				30 amp.x2ml	1				
	944-076 S7755 AutoCheck TM 5+ 3 lygis				30 amp.x2ml	1				
	944-077 S7765 AutoCheck TM 5+ 4 lygis				30 amp.x2ml	1				
	962-169 Kalibravimo dujos 1, 10 bar				1 bal.	2				
	962-170 Kalibravimo dujos 2, 10 bar				1 bal.	1				
	956-616 safePICO švirkštas				1 pak. (100 vnt.)	2				
	942-880 C limitubės TM 5x50vnt. D957G-70-125x5				1 pak. (250 vnt.)	8				

Eil. Nr.	Tyrimas	Preliminarus tyrimų skaičius 6 mėnesių laikotarpiui	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Sitūlama pakuotė	Poreikis pakuotėmis pagal nurodytą tyrimų skaičių	Si
	906-020 Krešulių gaudytuvas ABL				1 pak.	2	
	Termo popierius				1 rul.	3	
11 pirkimo dalies suma							10 278,68
12.	12 pirkimo objekto dalis REAGENTAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS ATLEKAMIEMS AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ						ESD analizatorius
	Turi būti automatinis nusėdimų greičio analizatorius nurodantis nusėdimo greitį mm³/val. Testavimas atliekamas naudojant EDTA/ kraujo mėginius, paimtus iš venos ir mikromėgintuvėlius su kapiliariniu krauju viliama. Turi atlikti tyrimą tiesiogiai iš necentrifuguoto, neakimšto ir be jokio rankinio išpildymo mėgintuvėlio. Labai mažas mėginio tūris, leidžiantis jį to paties mėgintuvėlio atlikti ir kitus tyrimus (pvz: Bendras kraujo tyrimas). Gamyklinė kalibracija neriboto galiojimo ir nereikalaujanti perkalibravimo. Našumas ne mažiau 180 tyrimų per val., pirmojo rezultato išdavimas ne ilgiau 20sek. Nereikalaujantis kasdieninės priežiūros ir visada pasruošęs atlikti tyrimus. Turi būti atliekama kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių ir ilkių stabilų ne mažiau 3 mėn.						
	ENG- Eritrocitų nusėdimo greitis	1200	Referentinės reišmės išdiferencijuotos pagal amžių. Matavimo laikas ne ilgiau nei 20 sek. Reagentų/ tyrimo kortelės stabilumas analizatoriuje neriboto galiojimo pilnai išnaudojamas	ATITINKA	1 pak. (5000 tyr.)	1	3,000,
	11205000 Tyrimų kortelė						
	Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatacijai						
	DSC06 Kokybės kontrolė Seditol QC (normali ir patologinė)				1 pak.	1	260,0
	Ploviklis IWASH				1000 ml (1 l)	5	10,00
12 pirkimo dalies suma							3,463,30
Viso:							70 629,07

Direktorius Artūras Vasiliauskas



Direktorius Valdas Jančiauskis