


DERIVO® embolizavimo įrenginys

Išplėstinis srauto nukreipimas su unikalia matomumo koncepcija

Srautinio nukreipimo technika, naudojant embolizacijos įtaisus, esančius pagrindinėje arterijoje, yra naujas požiūris gydant intrakranijinius aneurizmus, ypač fusiforminius ir didelius su plačiu kaklu.

Šie įtaisai turi didelę kraujagyslių sienelių aprėptį ir gebėjimą pakeisti hemodinamines jėgas ir vektorius segmente, turinčiame aneurizmą.

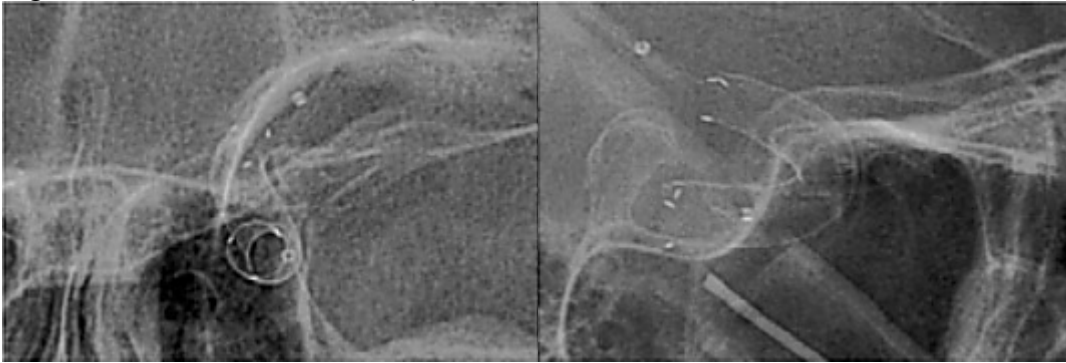

„DERIVO® embolizavimo įrenginys“

naujos kartos srauto nukreipimas:

Unikalus rentgeno matomumas

2,5–6,0 mm laivo skersmuo

3D dydžio modeliavimas

Tikra savęs plėtra


Nusileidimas

Padidėjęs atsparumas korozijai ir mažesnis trombogeniškumas dėl „BlueXide“ paviršiaus apdailos

Dabar ilgus pažeidimus galima gydyti vienu DERIVO, o ne naudoti kelis prietaisus teleskopiniu būdu.

Subalansuotos mechaninės savybės užtikrina puikų klinikinį efektyvumą

Didelio dešiniojo ICA aneurizmos gydymas DERIVO 4.0mm x 30mm

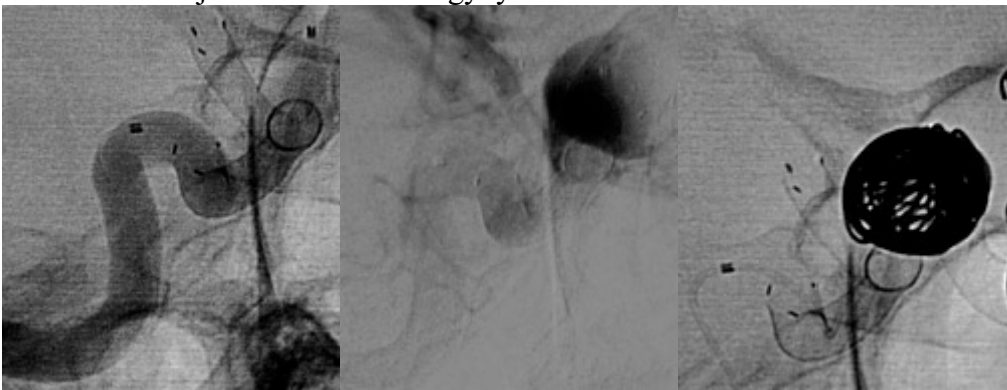

Puikus klinikinis efektyvumas

Saugus tvirtinimas prie sienos

Pagerintas atsparumas korozijai ir mažesnis trombogeniškumas¹, susijęs su „BlueXide®“ paviršiaus apdaila

¹ rezultatai gauti iš in vitro tyrimų

Vertimas tikras

Viktoras Sidaravičius

2018 05 31

