

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LS-45

Alytus

2017m. vasario mėn. 15 d.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, toliau vadinama PIRKĖJU, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko ir UAB „Slaugivita“, toliau vadinama TIEKĖJU, atstovaujama rinkodaros ir pardavimų direktorės Tatjanos Rogovos, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas

Tiekėjas remiantis supaprastinto atviro konkurso „Medicininė įranga“, pirkimo Nr.182382 įvykusio 2017m. sausio mėn. 16 d. rezultatais, įsipareigoja parduoti medicininę įrangą – **mobiliuos lovas**, toliau vadinamus Preke, pagal specifikaciją (Priedas Nr.1), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti ir sumokėti už jas sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Prekių pristatymo ir apmokėjimo tvarka

2.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti prekę savo transportu ne vėliau kaip per 45 dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Transporto paslaugų vertė įeina į prekės kainą.

2.2. Už kokybišką prekę Pirkėjas apmoka Tiekėjui pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota pasikeitus įstatymo numatytam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties pakeitimas įforminamas abiejų šalių pasirašytu susitarimu. Perkamos prekės specifikacija nurodomi sutarties priede Nr.1.

2.4. **Perkamų prekių kaina - 14990,00 Eur.** (keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt Eur.).

3. Prekių kokybė, ženklavimas ir priėmimo tvarka

3.1. Prekės turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

3.2. Prekių kokybės dokumentus saugo Tiekėjas, o Pirkėjui pateikia kokybės dokumentų kopijas.

3.3. Pirkėjo įgaliotas asmuo, priėmęs prekes, privalo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti, uždėti antspaudą ir vieną sąskaitos egzempliorių grąžinti tiekėjui.

3.4. Pretenzijas dėl prekių kokybės Pirkėjas pareiškia Tiekėjui per 15 dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.5. Tiekėjas negali vienų prekių pakeisti kitomis (analogais).

4. Šalių atsakomybė

4.1. Už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

4.2. Šios sutarties vykdymas gali būti visiškai ar laikinai sustabdytas iškilus Force Majeure aplinkybėms. Į šią sąvoką įeina, karas, maištai, stichinės nelaimės, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sproginiai, gaisrai, streikai, lokautai, teisėti ir neteisėti valstybinių institucijų veiksmai ir panašios priežastys. Force Majeure atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatomis.

5. Ginčų sprendimo tvarka

5.1. Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo būtų sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka

6.1. Sutartis galioja kai ją pasirašo Pirkėjas ir Tiekėjas ir galioja 12 mėnesius. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 30% nepristatytų prekių vertės bauda.

6.2. Pirkėjo iniciatyva ši sutartis gali būti nutraukta ankščiau termino, jeigu Tiekėjas pateikia nekokybiškas prekes. Šiuo atveju apie sutarties nutraukimą Pirkėjas informuoja Tiekėją raštu per protingą terminą.

7. Kitos sąlygos

7.1 Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

7.2. Visi kiti, šia sutartimi nereguluoti klausimai, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

7.3 Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, kurių abu turi vienodą juridinę galią.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

8. Sutarties priedai.

Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 1

9. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114, Alytus
Tel. 8-315-56 301,
faks. 8-315-75 530
Im.kodas 190272175
A/s LT737300010091752982
AB Swedbankas

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

.....
(parašas)



Tiekėjas

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įmonės kodas 145440368
PVM mok. kodas LT454403610
A.s. LT98 7300 0100 8946 0228
Bankas AB Swedbank

Rinkodaros ir pardavimų direktorė
Tatjana Rogova

.....
(parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobili lova (10 vnt.)


Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Lovos tipas	Funkcinė elektrinė ligoninės lova su žirkliniu kėlimo mechanizmu. Turi būti su plastikiniu važiuoklės dangčiu, dengiančiu visą apatinį lovos rėmą.	Funkcinė elektrinė ligoninės lova su žirkliniu kėlimo mechanizmu. Su plastikiniu važiuoklės dangčiu, dengiančiu visą apatinį lovos rėmą.
2.	Gulimas paviršius	Ne mažiau kaip keturių dalių. Paviršiaus dalys pagamintos iš tvirtų ABS plastiko plokščių, su ventiliacinėmis angomis. Visos dalys turi būti išimamos be įrankių (valymo tikslais).	Keturių dalių. Paviršiaus dalys pagamintos iš tvirtų ABS plastiko plokščių, su ventiliacinėmis angomis. Visos dalys išimamos be įrankių (valymo tikslais).
3.	Lovos dalių valdymas	Elektrinis nugaros atramos pakėlimas $\geq 70^\circ$ Elektrinis kelių sulenkimo kampas $\geq 40^\circ$ Mechaninis blauzdų pakėlimas, fiksuojamas keliose padėtyse $\geq 25^\circ$. Visi varikliai turi būti žemos įtampos, turi būti su apsauga nuo per didelio svorio ar kliūties (nustoja kelti). Lovos aukštį valdantis variklis turi turėti apsaugas nuo kritimo.	Elektrinis nugaros atramos pakėlimas 73° Elektrinis kelių sulenkimo kampas 40° Mechaninis blauzdų pakėlimas, fiksuojamas keliose padėtyse 25° . Visi varikliai žemos įtampos, su apsauga nuo per didelio svorio ar kliūties (nustoja kelti). Lovos aukštį valdantis variklis turi apsaugas nuo kritimo.
4.	Lovos prailginimas	Dudens srities praplatėjimas sėdimoje pozicijoje ≥ 18 cm. Taip pat turi būti integruotas lovos prailginimas ties kojūgaliu ≥ 20 cm. Prailginta lova turi būti su integruota atrama čiužiniui.	Dudens srities praplatėjimas sėdimoje pozicijoje 18 cm. Taip pat yra integruotas lovos prailginimas ties kojūgaliu 20 cm. Prailginta lova yra su integruota atrama čiužiniui.
5.	Ratukai	Ratų diametras ≥ 15 cm. Ne mažiau kaip 2 valdymo pedalai, sumontuoti prie kojūgalio esančių ratukų. Ne mažiau kaip 3 valdymo padėtyse: - Visi ratukai stabdomi. - Visi ratukai nestabdomi. - Bent vienas ratukas fiksuota kryptimi (nesisuka vertikalia kryptimi).	Ratų diametras 15 cm. 2 valdymo pedalai, sumontuoti prie kojūgalio esančių ratukų. 3 valdymo padėtyse: - Visi ratukai stabdomi. - Visi ratukai nestabdomi. - Bent vienas ratukas fiksuota kryptimi (nesisuka vertikalia kryptimi).
6.	Apkrovimas	Maksimali apkrova ≥ 250 kg	Maksimali apkrova 250 kg
7.	Lovos pakėlimas	Aukščio reguliavimas pultelio pagalba $\geq 40 - 79$ cm	Aukščio reguliavimas pultelio pagalba 40 - 79 cm
8.	Šoninės apsaugos	Pagamintos iš metalo, nuleidžiamos susilanksto, ≥ 4 skersinių. Apsaugo nuo pirštų prispaudimo. Turi atitikti saugumo standartą EN 60601-2-52.	Pagamintos iš metalo, nuleidžiamos susilanksto, 4 skersinių. Apsaugo nuo pirštų prispaudimo. Atitinka saugumo standartą EN 60601-2-52.
9.	Lovagaliai	Turi būti dengti plastikų. Lengvai išimami be įrankių, su fiksavimo mechanizmu (apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo), neturi klibėti. ryškios	Dengti plastikų. Lengvai išimami be įrankių, su fiksavimo mechanizmu (apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo), nekliba, ryškios

		spalvos užfiksavimo rankenėlės, fiksuoja lovagalius be kaiščio. Ne mažiau kaip 2 išėmos (rankena įsikibimui).	spalvos užfiksavimo rankenėlės, fiksuoja lovagalius be kaiščio. 2 išėmos (rankena įsikibimui).
10.	Gaivinimas	Lovoje turi būti sumontuotas greitas mechaninis nugaros atramos nuleidimas dėl paciento gaivinimo (CPR).	Lovoje sumontuotas greitas mechaninis nugaros atramos nuleidimas dėl paciento gaivinimo (CPR).
11.	Lovos išmatavimas	Lovos plotis ribose 215 x 97(±3)cm – 5 vnt., lovos plotis 215 x 102 (±3)cm.- 5 vnt.	Lovos plotis ribose 215 x 97 cm – 5 vnt., lovos plotis 215 x 102 cm - 5 vnt.
12.	Pultelis	Mygtukai turi visada šviesti tamsoje. Turi būti viso pultelio arba atskirų funkcijų užrakinimas (turi magnetinį raktą).	Mygtukai visada šviečia tamsoje. Yra viso pultelio arba atskirų funkcijų užrakinimas (turi magnetinį raktą).
13.	Kampų apsaugos	Visuose keturiuose kampuose sumontuotos apsaugos nuo sienų trunkymo.	Visuose keturiuose kampuose sumontuotos apsaugos nuo sienų trunkymo.
14.	Priedų laikiklis	Ne mažiau 4 kabliukai įvairiems priedams laikyti. Visuose keturiuose lovos kampuose angos pasikėlimo rankenoms tvirtinti. Turi būti ištraukimas kojūgalyje, nerūdijančio plieno arba chromuotas, patalynės laikiklis.	4 kabliukai įvairiems priedams laikyti. Visuose keturiuose lovos kampuose angos pasikėlimo rankenoms tvirtinti. Ištraukimas kojūgalyje, nerūdijančio plieno arba chromuotas, patalynės laikiklis.
15.	Sertifikatai	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
16.	Garantija	Nemažiau kaip 3 metai.	3 metai.
17.	Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams.	Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais. Pateikti gamintojo įgaliojimą parduoti ir atlikti gaminių aptarnavimą Lietuvos rinkai. Pareikalavus pirkimo komisijos pateikti gamintojo originalias brošiūras, gamintojo Pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio gaminio aprašymus, įrodančius gaminio atitikimą, gaminio pavyzdį.	Pateiktas gamintojo paruoštas, originalo kalba ir lietuviškas gaminio aprašymas su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais. Pateiktas gamintojo įgaliojimas parduoti ir atlikti gaminių aptarnavimą Lietuvos rinkai. Pareikalavus pirkimo komisijos pateiksime gamintojo originalias brošiūras. Pateiksime nuorodą į gamintojo internetinio puslapio gaminio aprašymus, įrodančius gaminio atitikimą, gaminio pavyzdį.
18.	Dokumentai, patvirtinantys gaminio kokybę	Jeį siūlomas modelis turi pakeitimus ir šie parametrai nėra paminėti brošiūrose arba techninių duomenų lape, Tiekėjas turi pateikti gamintojo siūlomo modelio tipo testą, patvirtinantį, kad siūlomas modelis su CE ženklų gali turėti šiuos pakeitimus ir nepažeidžia CE ženklinimo suteikimo taisyklių	Jeį siūlomas modelis turi pakeitimus ir šie parametrai nėra paminėti brošiūrose arba techninių duomenų lape, Tiekėjas turi pateikti gamintojo siūlomo modelio tipo testą, patvirtinantį, kad siūlomas modelis su CE ženklų gali turėti šiuos pakeitimus ir nepažeidžia CE ženklinimo suteikimo taisyklių
19.	Tiekėjas privalo atlikti siūlomo gaminio	Pateikti parengtus tikrinimo protokolus ir procedūrų aprašą arba lygiavėčius	Pateiktas parengtas tikrinimo protokolai ir procedūrų aprašai arba

	techninė būklės tikrinimą	dokumentus (lietuvių kalba).	lygiaverčius dokumentus (lietuvių kalba).
--	------------------------------	------------------------------	--

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

.....
(parašas)

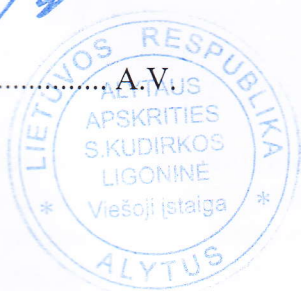

Rinkodaros ir pardavimų direktorė
Tatjana Rogova

.....
(parašas)

