

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Vilnius, 2015 m. liepos 09 d.

VG TU sutarčių
registro Nr. 13004

VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, toliau vadinamas Pirkėju arba VG TU, atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą, ir UAB „ARM GATE“, toliau šiame tekste vadinama Pardavėju, atstovaujama l.e. direktoriaus pareigas Viktorijos Darčanovienės, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį.

Sutartis sudaryta vadovaujantis apklausos raštu rezultatais.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nustatytais terminais pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn naują dujų chromatografą su liepsnos jonizaciniu detektoriumi, kurio techninė specifikacija nurodyta šios Sutarties Priede Nr. 1 (toliau Sutartyje – Įranga), o Pirkėjas įsipareigoja kokybišką įrangą priimti ir už ją sumokėti 2.1 punkte nurodytą sumą.
- 1.2. Šios Sutarties priedai yra neatskiriamos šios sutarties dalys.
- 1.3. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamos Įrangos kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir Įranga yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
- 1.4. Įrangos nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

2. KAINA

- 2.1. Bendra Įrangos kaina yra 4 840,00 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct), įskaitant pristatymo, sumontavimo išlaidas, pridėtinės vertės ir kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. Įrangą, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo;
- 3.1.2. Įrangą pristatomi Sutarties Priede Nr. 1 nurodytais adresais;
- 3.1.3. pristatant Įrangą pateikti perdavimo-priėmimo aktą bei PVM sąskaitą faktūrą;
- 3.1.4. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti VG TU sutarčių registro numerį, kuris sutarčiai bus suteiktas po jos pasirašymo;
- 3.1.5. sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu Pirkėjui aptikus įrangos defektą ar jiems ir raštu informavus apie tai Pardavėją, savo sąskaita pašalinti juos ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas po raštiško Pirkėjo pranešimo apie defektus. Nustačius, kad defektai atsirado dėl Pirkėjo netinkamos Įrangos eksploatacijos, išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, apmoka Pirkėjas;
- 3.1.6. skirti Viktoriją Darčanovienę, tel.: +37052789573, el. paštas viktorija@armgate.lt, atsakingu asmeniu šios sutarties vykdymui;
- 3.1.7. užtikrinti prievolių įvykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos. Sutartį pažeidęs Pardavėjas įsipareigoja sumokėti 10% baudą nuo bendros sutarties sumos;
- 3.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.2.1. už pristatytą Įrangą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;
- 3.2.2. skirti Praną Baltrėną, VG TU Aplinkos apsaugos instituto direktorių, tel. +370 52744723; el. paštas: pranas.baltrenas@vgtu.lt, atsakingu už sutarties vykdymą be teisės keisti sutarties sąlygas ir įgalioti pasirašyti Įrangos perdavimo-priėmimo aktus;
- 3.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 3.3. Pirkėjas turi teisę patikrinti ir/ar išbandyti Įrangą, kad patvirtintų jos atitikimą techninei specifikacijai. Jeigu Įranga nevisiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, Pirkėjas tokios Įrangos nepriima ir Pardavėjas privalo nedelsdamas atsiimti tokią Įrangą. Pirkėjas sumoka Pardavėjui tik už tą Įrangą, kuri visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Pavėlavus pristatyti ir sumontuoti Įrangą pagal sutarties 3.1.1 punkte nustatytą terminą, Pardavėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,06 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos.
- 4.2. Pirkėjas, laiku neįvykdęs apmokėjimo kaip numatyta sutarties 3.2.1 punkte, pagal Pardavėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,06 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 4.3. Pardavėjas laiku neatlikęs garantinio remonto pagal sutarties 3.1.5 punktą, Pirkėjo pareikalavimu moka delspinigius – po 0,2 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties sumos.
- 4.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal šią sutartį tinkamo įvykdymo. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 4.6. Šalys neatsako už šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu jos įrodo, kad sutarties įsipareigojimai neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės buvimas nustatomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes sutarties šalis privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 dienos nuo šių aplinkybių atsiradimo, priešingu atveju ši šalis bus atsakinga už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

5. GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas Įrangai suteikiama nemažiau kaip 12 mėnesių garantija (skaičiuojant nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos). Pardavėjas garantuoja nemokamą nekokybiškos Įrangos remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu pagal Sutarties 3.1.5 punkto sąlygas.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
- 6.2. Šią sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
 - 6.2.1. vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus Pardavėjui prieš 7 dienas, jeigu šis per Sutarties 3.1.1 punkte nurodytą terminą nepristato Įrangos arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai Pardavėjas nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pardavėjas per 10 dienų privalo grąžinti visą sumą, kurią Pirkėjas jau yra jam sumokėjęs bei atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą bei kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant perkamą Įrangą iš trečiųjų asmenų;
 - 6.2.2. vienašališkai Pardavėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus Pirkėjui prieš 7 dienas, jeigu šis iki sutarties 3.2.1 punkte nurodyto termino nesumoka sutartyje nustatytos sumos už pristatytą bei perduotą Įrangą arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai Pirkėjas nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pirkėjas privalo atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą;
 - 6.2.3. abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Nei viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai.
- 7.2. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 7.3. Jeigu keičiasi sutartį pasirašiusios šalies rekvizitai, šalis privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą šalį. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
- 7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
- 7.5. Sutarties Priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalimi:
 - 7.5.1. Sutarties priedas Nr. 1 – techninė specifikacija, 3 lapai.
- 7.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

7.7. Visi kiti, šia Sutartimi nereguliuoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.

7.8. Visa su šia sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Tel. (8 5) 274 5030
Faks. (8 5) 270 0112
A/s LT327300010002459012
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rektorius
Alfonsas Daniūnas




PARDAVĖJAS

UAB "ARM GATE"

J.Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius
Tel.+37052789573
El. paštas: info@armgate.lt
Įmonės kodas 135218757
PVM mokėtojo kodas LT352187515
Sąskaitos Nr. LT 827300010074437059
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000

L.e. direktoriaus pareigas
Viktorija Darčanovienė

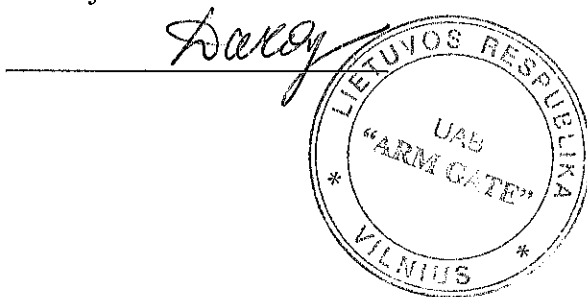

*resos Apšinkos
apsaugos instituto*
[Handwritten signature]

Pranas Baltrėnas
Prof., habil. dr.

[Handwritten signature]
2015-09-01

Dr. G. Arūnas Komša
VGTU kancelerinė

[Handwritten signature]
Romualdas Česnavičius
VGTU finansų direktijos
direktorius

2015-09-01

VGTU Teisės direktijos
vyriausiasis specialistas

Mantas Račkauskas

2015-07-27

LABORATORINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Padalinio pavadinimas: VGTU Aplinkos apsaugos institutas

Pristatymo adresas: VGTU Aplinkos apsaugos institutas

1 lentelė.


Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikaujamų techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (būtina nurodyti gamintojo pavadinimą bei įrangos modelį, markę ir pan.)	Kaina, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi	1	Kolonų termostato darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450°C. Termostato nustatytos temperatūros tikslumas ne blogesnis nei ±0,1°C. Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius ne mažesnis kaip 20. Maksimali galima temperatūros programos trukmė ne mažesnė nei 9999 min. Termostato temperatūra nustatoma programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kėlimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min. Kolonėlių temperatūrinė apsauga dviguba. Srauto ir slėgio kontrolė programinė pneuminė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas. Dujų taupymo funkcija būtina, programuojama.	GC2010 Shimadzu Corp, Japonija Kolonų termostato darbinės temperatūros intervalas nuo 5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450°C. Termostato nustatytos temperatūros tikslumas ±0,1°C. Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius 20. Maksimali galima temperatūros programos trukmė 9999 min. Termostato temperatūra nustatoma programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kėlimo greitis iki 250°C/min. Kolonėlių temperatūrinė apsauga dviguba. Srauto ir slėgio kontrolė programinė pneuminė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas. Dujų taupymo funkcija yra, programuojama.	4000,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Išrangos pavadinimas</i>	<i>Kiekis, vnt.</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos</i>	<i>Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (būtina nurodyti gamintojo pavadinimą bei įrangos modelį, markę ir pan.)</i>	<i>Kaina, EUR (be PVM)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi		Grafinis ekranas privalomas, visų chromatografo parametrų ir būsenos (įskaitant chromatogramą) atvaizdavimui. Valdymas personaliniu kompiuteriu ir/arba integruotu mikroprocesoriumi. Darbo apskaitos žurnalas būtinas, su skaitikliais prevenciskai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų, ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai. Dujų nešėjų srauto kontrolė turi būti nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonelių termostato programos. „Split/Splitless“ tipo injektorius arba lygiavertis pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms. Maksimali injektoriaus temperatūra ne žemesnė nei 450°C. Srauto nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min. H₂ arba He dujoms. Detektorius liepsnos jonizacinis (JLD). Detektoriaus dujų tiekimo ir slėgio kontrolė - elektroninė - pneumatinė. Maksimali darbinė detektoriaus temperatūra ne mažesnė nei 450 °C. Linijinis dinaminis intervalas ne mažiau nei 10⁷. Mažiausia aptikimo riba 1,5 pg C/s dodekanui. Duomenų nuskaitymo dažnis ne mažiau nei 250 Hz. Švirkštai automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 10 µl, 2 vnt.	GC2010 Shimadzu Corp, Japonija Grafinis ekranas yra, visų chromatografo parametrų ir būsenos (įskaitant chromatogramą) atvaizdavimui. Valdymas personaliniu kompiuteriu ir/arba integruotu mikroprocesoriumi. Darbo apskaitos žurnalas yra, su skaitikliais prevenciskai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų, ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai. Dujų nešėjų srauto kontrolė yra, nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonelių termostato programos. „Split/Splitless“ tipo injektorius pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms. Maksimali injektoriaus temperatūra 450°C. Srauto nustatymo diapazonas nuo 0 iki 1200 ml/min. H₂ arba He dujoms. Detektorius liepsnos jonizacinis (JLD). Detektoriaus dujų tiekimo ir slėgio kontrolė - elektroninė-pneumatinė. Maksimali darbinė detektoriaus temperatūra 450 °C. Linijinis dinaminis intervalas 10⁷. Mažiausia aptikimo riba 1,5 pg C/s dodekanui. Duomenų nuskaitymo dažnis 250 Hz. Švirkštai automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui 10 µl, 2 vnt.	4000,00

eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (būtina nurodyti gamintojo pavadinimą bei įrangos modelį, markę ir pan.)	Kaina, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi			GC2010 Shimadzu Corp, Japonija	4000,00
		Garantija	Prietaisas gali būti naudotas ne daugiau kaip 2 metus. Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	Prietaisas naudotas ne daugiau kaip 2 metus. 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	
		Pristatymo terminai	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.	
	Papildomi reikalavimai		1. Techninis prietaiso aptarnavimas. 2. Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos prietaisų registrą. 3. Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas.	1. Techninis prietaiso aptarnavimas. 2. Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos prietaisų registrą. 3. Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas.	

PIRKĖJAS


Vsį Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Tel. (8 5) 274 5030
Faks. (8 5) 270 0112
A/s LT327300010002459012
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

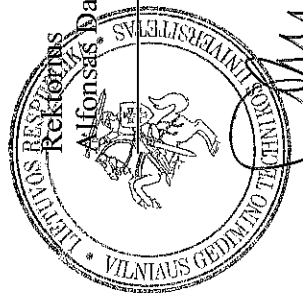

Prenas Baltėnas
Prof., habilit. dr.

PARDAVĖJAS

UAB „ARM GATE“
J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius
Tel. +37052789573
El. paštas: info@armgate.lt
Įmonės kodas 135218757
PVM mokėtojo kodas LT352187515
Sąskaitos Nr. LT 827300010074437059
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000



L.e. direktoriaus pareigas
Viktorija Darčanovienė

**PASIŪLYMAS
DĖL DUJŲ CHROMATOGRAFO SU LIEPSNOS JONIZACINIŲ DETEKTORIUMI
PIRKIMO**

2015-07-10

1 lentelė. Tiekėjo kontaktiniai duomenys.

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arm Gate“
Tiekėjo adresas, telefonas, faksas	J.Kubiliaus 6-21, Vilnius +37052789573
Tiekėjo įmonės kodas	135218757
Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas	Marijus Svetikas +37068687289, mrijus@armgate.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

2 lentelė. Pasiūlymo kaina.

<i>Visa pasiūlymo kaina. Eur</i> (įskaitant PVM ir visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)	<i>Kaina (be PVM)</i>	4000,00
	<i>21 % PVM</i>	840,00
	<i>Kaina (su PVM)</i>	4840,00
<i>Pasiūlymo galiojimo laikas</i>	iki 2015 m. rugpjūčio 13 d.	

3 lentelė. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, subteikėjus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Subteikėjo, subteikėjo pavadinimas</i>	<i>Pirkimo objekto dalies, kurioms pasitelkiami subteikėjai, subteikėjai, aprašymas</i>

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, subteikėjai.

4 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta žemiau nurodyta konfidenciali informacija:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i>

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.



LABORATORINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Padalinio pavadinimas: VGTU Aplinkos apsaugos institutas

Pristatymo adresas: VGTU Aplinkos apsaugos institutas

1 lentelė.

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikšėjamas techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (būtina nurodyti gamintojo pavadinimą bei įrangos modelį, markę ir pan.)	Kaina, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi	1	Kolonų termostato darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450°C. Termostato nustatytos temperatūros tikslumas ne blogesnis nei $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius ne mažesnis kaip 20. Maksimali galima temperatūros programos trukmė ne mažesnė nei 9999 min. Termostato temperatūra nustatoma programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min. Kolonėlių temperatūrinė apsauga dviguba.	GC2010 Shimadzu Corp, Japonija Kolonų termostato darbinės temperatūros intervalas nuo 5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450°C. Termostato nustatytos temperatūros tikslumas $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius 20. Maksimali galima temperatūros programos trukmė 9999 min. Termostato temperatūra nustatoma programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis iki 250°C/min. Kolonėlių temperatūrinė apsauga dviguba.	4000,00

Uždaroji akcinė bendrovė "ARM GATE", įmonės kodas 135218757, PVM kodas LT352187515
J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234, Vilnius, tel. 8-5-278 95 73, fax. 8-5-278 95 72, el. paštas: info@armgate.lt
LR įmonių registras, tvarkytoja VĮ Registrų centras, registro Nr. 037947



		Srauto ir slėgio kontrolė programinei pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas.	
		Dujų taupymo funkcija būtina, programuojama.	
		Grafinis ekranas privalomas, visų chromatografo parametrų ir būsenos (įskaitant chromatogramą) atvaizdavimui.	
		Valdymas personaliniu kompiuteriu ir/arba integruotu mikroprocesoriumi.	
		Darbo apskaitos žurnalas būtinas, su skaitikliais prevencijškai keičiamų susivartojančių dalių (septynų, insertų, ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai.	
		Dujų nešėjų srauto kontrolė turi būti nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonelių termostato programos.	
		„Split/Splitless“ tipo injektorius arba lygiavertis pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms.	„Split/Splitless“ tipo injektorius pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms.
		Maksimali injektoriaus temperatūra ne žemesnė nei 450°C.	Maksimali injektoriaus temperatūra 450°C.
		Srauto nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.	Srauto nustatymo diapazonas nuo 0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.
		Detektorius liepsnos jonizacinis (JLD).	Detektorius liepsnos jonizacinis (JLD).
		Detektoriaus dujų tiekimo ir slėgio kontrolė - elektroninė-pneumatinė.	Detektoriaus dujų tiekimo ir slėgio kontrolė - elektroninė-pneumatinė.
		Maksimali darbinė detektoriaus temperatūra ne mažesnė nei 450 °C.	Maksimali darbinė detektoriaus temperatūra 450 °C.
		Linijinis dinaminis intervalas ne mažiau nei 10 ⁷ .	Linijinis dinaminis intervalas 10 ⁷ .
		Mažiausia aptikimo riba 1,5 pg C/s dodekanui.	Mažiausia aptikimo riba 1,5 pg C/s dodekanui.

Uždaroji akcinė bendrovė "ARM GATE", įmonės kodas 135218757, PVM kodas LT352187515
 J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234, Vilnius, tel. 8-5-278 95 73, fax. 8-5-278 95 72, el. paštas: info@armgate.lt
 LR įmonių registras, tvarkytoja VI Registrų centras, registro Nr. 037947



		Duomenų nuskaitymo dažnis ne mažiau nei 250 Hz.	Duomenų nuskaitymo dažnis 250 Hz.
		Švirkštai automatiniam mėginių įvedimui 10 µl, 2 vnt.	Švirkštai automatiniam mėginių įvedimui 10 µl, 2 vnt.
		Prietaisas gali būti naudotas ne daugiau kaip 2 metus.	Prietaisas naudotas ne daugiau kaip 2 metus.
	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Pristatymo terminai	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.
	Papildomi reikalavimai	1. Techninis prietaiso aptarnavimas. 2. Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos prietaisų registrą. 3. Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas.	1. Techninis prietaiso aptarnavimas. 2. Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos prietaisų registrą. 3. Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas.

Pagarbiai,
Direktorius

Marijus Svetikas