

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

**PASIŪLYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS
LABORATORINIŲ REAGENTŲ PIRKIMAS**

_____2015-01-02_____ Nr. ___1___

(Data)

_____Vilnius_____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "DIAMEDICA"
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Buivydiškių g. 10, LT - 07194 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų vadovė Valentina Sergejeva
Telefono numeris	8-5-2790080; 8-679-50237
Fakso numeris	8-5-2107286
El. pašto adresas	konkursai@diamedica.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas visą CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos, pateikti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Žr. specifikaciją, pasiūlymo 3-7 lapai

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomų prekių specifikacija	5
2.	Prekių pristatymo ir atsiskaitymo už prekes terminai	1
3.	UAB "Diamedica" pažymos, išduotos Valstybės įmonės Registrų centras kopija	2

4.	Deklaracija	1
5.	UAB "Diamedica" įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos	5
6.	Gamintojų įgaliojimų kopijos	16
7.	Įgaliojimo UAB "Diamedica" viešųjų pirkimų vadovei Valentinai Sergejevai kopija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mūsų teikiama informacija konfidenciali


Viešųjų pirkimų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Valentina Sergejeva

(Vardas ir pavardė)

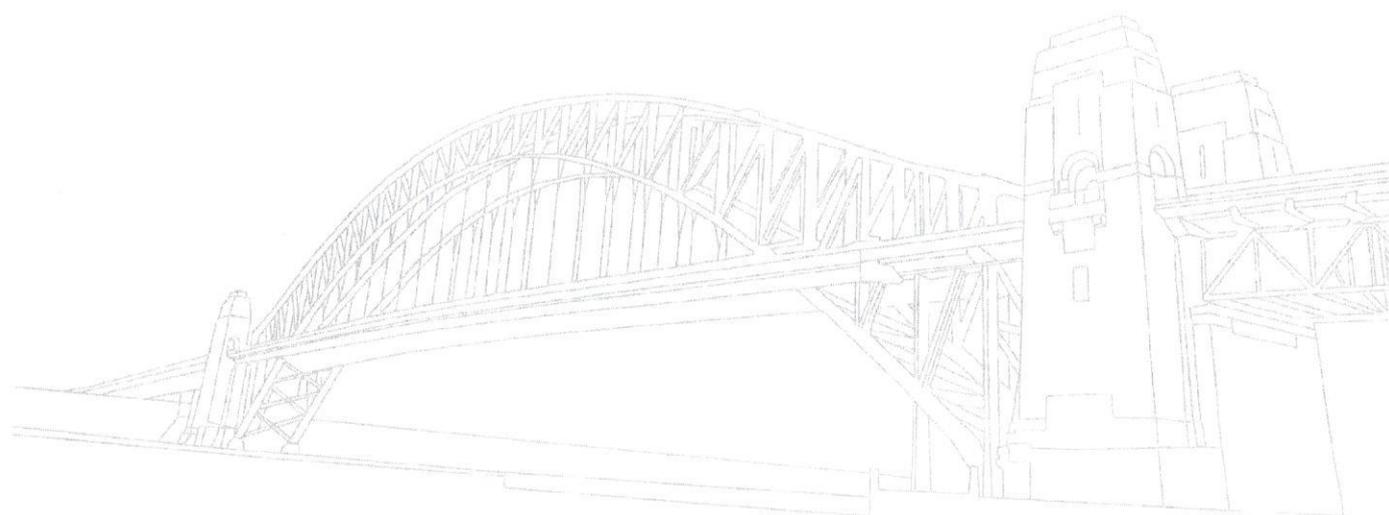

Eil Nr	Cheminis vaisto pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Preliminarus planuojamas kiekis metais / vnt.	Gamintojo pavadinimas	Vieneto kaina EUR be PVM	PVM	Vieneto kaina EUR su PVM	Planuojama metinė suma	Gamtojas, komercinis prekės pavadinimas, pastabas
1	Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės analizatoriui BIOSEN C-line sport	Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo								
1.1	Standartinis gliukozės tirpalas Multi – Standart 12 mmol/l		50x2 ml.	4	EKF-diagnostic		5%	5		EKF-diagnostic, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml); 5211-3015
1.2	Gliukozės kontrolinis tirpalas Ready Con norm		25x1 ml.	2	EKF-diagnostic		5%	5		EKF-diagnostic, Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.); 5130-6152
1.3	Gliukozės kontrolinis tirpalas Ready Con pat		25x1 ml.	2	EKF-diagnostic		5%			EKF-diagnostic, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.); 5130-6162
1.4	Gliukozės sisteminis tirpalas		2,5 l	2	EKF-diagnostic		5%			EKF-diagnostic, Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml; 0201-0002-024; 7020-3111
1.5	Mėgintuvėliai su kapiliarais ir gliukozės hemoliziniu tirpalu		5x200 vnt	2	EKF-diagnostic		5%			EKF-diagnostic, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.); 0209-0100-014
1.6	Gliukozės sensorius			1	EKF-diagnostic		5%			EKF-diagnostic, Gliukozės sensorius Biosen C_line (typeII); 5206-3011
1.7	Periferinės pompos žarnelės su laikikliais			1	EKF-diagnostic		21%			EKF-diagnostic, Pompos žarnelė su fiksiatoriais; 5208-1094
	Bendra grupės suma								1.121,64	
6.	MONOKLONINIAI REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ IR Rh FAKTORIAUS NUSTATYMUJ	Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo								
6.1	Monokloninis Anti-A IgM	Stabilumas 18 mėn ABO sistemos diagnostikai	10 ml	5	Diagast		netaikoma			Diagast, Anti-A, 70501/70540
6.2	Monokloninis Anti-B IgM	Stabilumas 18 mėn ABO sistemos diagnostikai	10 ml	5	Diagast		netaikoma			Diagast, Anti-B, 70502/70541
6.3	Monokloninis Anti-AB IgM	Stabilumas 18 mėn ABO sistemos diagnostikai	10 ml	2	Diagast		netaikoma			Diagast, Anti-AB, 70503
6.4	Monokloninis Anti-D IgM	Skirta Rh diagnostikai, stabilumas 18 mėn.	10 ml	4	Diagast		netaikoma			Diagast, Anti-D IgM, 7000

6.5	Monokloninis Anti-D IgM+IgG	Skirta Rh diagnostikai, stabilumas 18 mėn.	10 ml	4	Diagast				Diagast, Anti-D Totem, 71010/70544
6.6	Temoin (neigiama Rh ir kraujo grupių kontrolė)	Skirta tiriamojo mėginiui patikrinti	10 ml	2	Diagast				Diagast, Neg Control. 79000
	Bendra grupės suma								
21.	REAGENTAI	Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo							87,30
	GREITIESIEMS TYRIMAMS	Kiekvienam testui turi būti atskira pipetė-lašintuvas su reagentu, į kurį dedamas ir maišomas ėminys, kiekvienas testas turi būti su vidine teigiama kontrole.							
21.1	Paslėptam kraujui išmatose iš virškinamojo trakto nustatyti (FOB)		25 testai	2	Ameritek		5%		Ameritek, FOB testas, R40S-112 Pakuotė - 1 testas.
21.2	Žmogaus imuno deficito viruso ŽIV1/2 kokybinė reakcija	Kasetės turi būti su vidine teigiama kontrole	1 x 25 kasetės	1	Biomerieux		5%		Biomerieux, VIKIA HIV 1/2, 31112
	Bendra grupės suma								
23.	Sifilio serologija	Pirkimo dalis iš vieno tiekėjo							60,27
		Turi būti pilna pakuotė, reagentas, teigiama ir neigiama kontrolės su 10 reakcinių žiedų, vienkartinės pipetės ir lopetėlės, lašintuvas reagentui išlašinti. Reakcijos laikas iki 8 mėn. stabilumas reagento ne mažiau 1 metų							
23.1	Sifilio diagnostika RPR		100 tyrimų	1	Cormay		5%		Cormay, RPR Carbon 150, 6-255
		Turi būti pilna pakuotė, eritrocitų reagentas, eritrocitų kontrolė, spalvotas buferis, teigiama ir neigiama kontrolės, reakcijos laikas iki 45 minučių, stabilumas reagento ne mažiau 1 metų. Vienkartinės plokštelės 96 duobučių U formos gali būti atskirai							
23.2	Sifilio diagnostika TPHA Treponema palidum antikūnų nustatymas		100 tyrimų	1	Cormay		5%		Cormay, TPHA 100, 6-259
23.3	Vienkartinės plokštelės U formos		96 duobutės	3	Sarstedt				Sarstedt, Microplate 96 wells
	Bendra grupės suma								
26.	REAGENTAI IR PRIEMONĖS	Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo							47,94
	ANALIZATORIUI Mini Vidas								
26.1	TSH Mini Vidas		1x60 kasetės	13	Biomerieux		5%		Biomerieux, VIDAS TSH, 30400

26.2	TF4 N Mini Vidas				3	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS FT4, 30459
26.3	TF3 Mini Vidas				2	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS FT3, 30402
26.4	PSA Mini Vidas				3	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS TPSA, 30428
26.5	Troponinas I				1	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS Troponin I Ultra, 30448
26.6	Kokybės kontrolė Mini Vidas Pipetavimo mechaniniai ir optiniai sistemos				1	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
26.7	A-TPO Mini Vidas				4	Biomerieux						Biomerieux, VIDAS Anti-TPO, 30461
	Bendra grupės suma											
29.	REAGENTAI IR											
	PRIMONĖS											
	ANALIZATORIUI											
29.1	Cholesterolis											
29.2	HDL cholesterolis				1	Thermo	12x20ml					Thermo, Cholesterol, 981813
	A reagentas											
	B reagentas				2	Thermo	6x18ml 6x6ml					Thermo, HDL-Cholesterol, 981823
29.3	Trigliceridai				1	Thermo	12 x 20ml					Thermo, Triglycerides, 981786
29.4	Šlapalas				4	Thermo	12x20 ml					Thermo, Urea, 981820
29.5	Magnis				12	Thermo	8x10ml					Thermo, Magnesium, 981885
29.6	Kreatininas				2	Thermo						Thermo, Creatinine (Enzymatic), 981845
	A reagentas						4 x40ml					
	B reagentas						4x20ml					
29.7	B.Bilirubinas											
	A reagentas				2	Thermo	20x10ml					Thermo, Total Bilirubin (NBD), 981793
	B reagentas						1x5 ml					
29.8	T.Bilirubinas											
	A reagentas				4	Thermo	4x48ml					Thermo, Direct Bilirubin, 981892
	B reagentas						4x12 ml					
29.9	Gliukozė				2	Thermo	12x23 ml					Thermo, Glucose, 981780
29.10	Kalcis				1	Thermo	8x22 ml					Thermo, Calcium, 981772
29.11	Alfa amilazė				3	Thermo	8x5 ml					Thermo, Amylase, 981770
29.12	GOT/AST				3	Thermo	8x16 ml					Thermo, AST/GOT, 981771
29.13	GPT/ALT				3	Thermo	8x4 ml 8x16ml 8x4ml					Thermo, ALT/GPT, 981769
29.14	CRB				3	Thermo	Ab 2x3ml Buf. 3x60 ml					Thermo, CRP, 981699

29.15	Šarminė fosfatazė		A ir B 10x20 ml	3	Thermo				Thermo, ALP (SCE), 981359
29.16	Geležis		A ir B 10x20ml	1	Thermo			5%	Thermo, Iron, 981236
29.17	Šlapimo rūgštis		A ir B 8x16	1	Thermo			5%	Thermo, Uric Acid (AOX), 981788
29.18	Albuminas		8x20 ml	1	Thermo			5%	Thermo, Albumin (BCG), 981767
29.19	Bendras baltymas		12x20 ml	2	Thermo			5%	Thermo, Total Protein, 981827
29.20	Fosforas		12x20 ml	1	Thermo			5%	Thermo, Phosphorus, 981891
29.21	CK-MB		A4x20 ml B4x5 ml	5	Thermo			5%	Thermo, CK-MB, 981837
29.22	Kontrolinis serumas Nortrol (normalių reikšmių)		10x5 ml	3	Thermo			5%	Thermo, Nortrol, 981043
29.23	Kontrolinis serumas Abtrol (patologinių reikšmių)		10x5 ml	3	Thermo			5%	Thermo, Abtrol, 981044
29.24	Kontrolinis serumas Lipotrol		5x3ml	3	Thermo			5%	Thermo, Lipotrol, 981653
29.25	Kontrolinis serumas CRB		5x1ml	3	Thermo			5%	Thermo, CRP control, 981251
29.26	Kontrolinis serumas CK-MB		5x2 ml.	2	Thermo			5%	Thermo, CK-MB control/control high, 981908/981255
29.27	Kalibratoriai ecal		5x3ml	1	Thermo			5%	Thermo, eCal, 981830
29.28	Kalibratoriai scal		10x3ml	2	Thermo			5%	Thermo, sCal, 981831
29.29	Kalibratoriai HDL/LDL cal		5x1ml	2	Thermo			5%	Thermo, HDL/LDL Chol Calibrator, 981657
29.30	Kalibratoriai CRB calib.set.		5x1ml	2	Thermo			5%	Thermo, CRP calibration set, 981674
29.31	Plovimo skystis		4x20ml	3	Thermo			21%	Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
29.32	Kiuvetės (Multicell)		1000vnt.	4	Thermo			5%	Thermo, Cuvettes, 984000
29.33	Mėginių indėliai (serumui)		0,5ml x1000 vnt.	8	Thermo			21%	Thermo, Sample Cup 0,5ml, 989220
29.34	Mikrovetės seruminės (kapiliariniam kraujui)		200µlx100v nt.	4	Sarstedt			5%	Sarstedt, Microvette 200 Serum, 20.1290
29.35	Gama-GT		A-15x4ml B- 1x16ml	1	Thermo			5%	Thermo, GGT, 981778
29.36	CK-kretinkinazė		A+B-8x3ml	1	Thermo			5%	Thermo, CK, 981829
29.37	LDH (laktatdehidrogenaze)		A-1x15ml B-15x4 ml.	1	Thermo			5%	Thermo, LDH (SCE), 981781
29.38	Baltymas šlapime ir likvoro		8x4ml	1	Thermo			5%	Thermo, U/CSF Protein, 981843
	Bendra grupės suma								7.109,11

33.	Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų analizatoriui EasyLyteNa/K	Reagentai to paties gamintojo, kaip ir analizatorius, tiekėjas turi užtikrinti garantinį analizatoriaus aptarnavimą, pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.									
33.1	Reagentų pakas EasyLyte Na/K	Pakas 800ml	8	Medica			5%	5		Medica. Na/K reagento pakas, 2120	
33.2	Kasdieninis plovimo skystis	Vnt.	2	Medica			5%			Medica, Kasdieninis plovimo tirpalas, 2118	
33.3	Printerio popierius	80mm	10	Medica			21%			Medica, Terminis popierius	
33.4	EasyQC kontrolė (dviejų lygių)	2x10ml	2	Medica		,0	5%			Medica, 2-ju lygių kokybės kontrolė, 2814	
33.5	Savaitinis plovimo skystis	50ml	1	Medica			5%			Medica, Plovimo tirpalas, 2309	
	Bendra grupės suma									1.805,51	

Sitūmos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus .