



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8-41 200590, el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO, VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0003
„KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ GYDYMO IR DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VŠĮ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE”

2019-03-13

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.)</i>	UAB M Prekyba
--	---------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-ų)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subteikėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka *(perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą)*;
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija *(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija)*. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
----------	--------------------------------	--

3. Mes siūlome šias prekes / įrangą:

3 pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Pasiūlymo valiuta:		(Eur)
			Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Funkcinė lova Sezame, MEDI S	57	vnt.	1200.00	68400.00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					68400.00
PVM (tarifas)*** suma:					14364.00
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					82764.00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –68400.00	Kaina žodžiais: šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų ir 00 ct
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 82764.00	Kaina žodžiais: aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 00 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

1. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso sąlygu 1 priede.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinių kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, registravimo išrašas	4
3.	Tiekėjų katalogai, CE deklaracija ir vertimai, įgaliojimai	20

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame BTA darudimo garantą.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Marius Martinaitis
(Vardas ir pavardė)


* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

3 pirkimo dalis. Funkcinės lovos (57 vnt.)

Sezame, Medi S

Eil. Nr.	Įrangos/Prekių techniniai rodikliai	Įrangos/Prekių techninių rodiklių reikšmės	Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamu katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras)
1.	Funkcinė - mechaninė lova	Būtina	Funkcinė - mechaninė lova
2.	Lovos funkcijų reguliavimas hidraulikos arba dujinis spyruoklių	Būtina	Lovos funkcijų reguliavimas hidraulikos ir dujinis spyruoklių
3.	Reguliuojamo aukščio	Būtina ne siauresnis diapazonas kaip: (400-800) ±10mm	400-800 mm
4.	4 (keturių dalių)	Būtina	4 (keturių dalių)
5.	Pakėlimo- nuleidimo kampai	Nugarinės dalis – ne mažiau 70° (± 10°) Kelių dalis – ne mažiau 30° (± 10°) Kojų dalis – ne mažiau 15° (± 10°)	Nugarinės dalis –70° Kelių dalis – 30° Kojų dalis –20°
6.	Ratukai viengubi arba dvigubi	Būtina ne blogiau nei nurodyta Diametras ne mažesnis 125 mm	Viengubi diametras 125 mm
7.	Centrinė stabdžių sistema	Būtina	Centrinė stabdžių sistema
8.	Apsauginiai, nuleidžiami ar nulenkiama šoniniai turėklai iš abiejų pusių	Būtina	Apsauginiai, nulenkiama šoniniai turėklai iš abiejų pusių
9.	Apsauginiai guminiai ar plastikiniai bamperiai visuose kampuose (apvalūs)	Būtina Bamperio diametras ne didesnis kaip 7,5 cm	Bamperio diametras 7,5 cm
10.	Lovos rėmas, plieninė konstrukcija, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu	Būtina	Lovos rėmas, plieninė konstrukcija, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu
11.	Maksimali saugi lovos apkrova	Būtina. Ne mažiau 200 kg	230 kg
12.	Vietos lovos priedų tvirtinimui (infuziniam stovui, pasikėlimo rankenai)	12.1. Būtina ne mažiau 2 tvirtinimo vietos. 12.2. Komplekte pateikiama ne mažiau 1 pasikėlimo rankena ir infuzinis stovas, pritaikyti siūlomos lovos naudojimui. 12.3. Pasikėlimo rankenos tvirtinamos prie lovos rėmo, metalinės, be plastiko detalių, su stabilia rankenos fiksacija. 12.4. Maksimali pasikėlimo apkrova ne mažiau 200 kg	2 tvirtinimo vietos. 12.2. Komplekte pateikiama 1 pasikėlimo rankena ir infuzinis stovas, pritaikyti siūlomos lovos naudojimui. 12.3. Pasikėlimo rankenos tvirtinamos prie lovos rėmo, metalinės, be plastiko detalių, su stabilia rankenos fiksacija. 12.4. Maksimali pasikėlimo apkrova 200 kg
13.	Universalus laikiklis šlapimo	Būtina	Universalus laikiklis šlapimo

	surinkėjui		surinkėjui
14.	Plastikiniai kojūgalio ir galvūgalio bortai, lengvai nuimami, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Plastikiniai kojūgalio ir galvūgalio bortai, lengvai nuimami, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.
15.	Čiužinys, pralaidus orui, nepralaidus skysčiams, atitinkantis lovadugnio išmatavimus	Būtina, ne plonesnis nei 14 cm	Čiužinys, pralaidus orui, nepralaidus skysčiams, atitinkantis lovadugnio išmatavimus , 14 cm
16.	Čiužinio užvalkalas bakteriostatinis, skysčiams nepralaidus, orui pralaidus, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, greitai nuimamas su apsaugotu nuo skysčių užtrauktuku	Būtina	Čiužinio užvalkalas bakteriostatinis, skysčiams nepralaidus, orui pralaidus, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, greitai nuimamas su apsaugotu nuo skysčių užtrauktuku
17.	Lovos išoriniai išmatavimai su šoniniais turėklais (be prailginimo)	Būtina Ilgis ribose 210- 220 cm , plotis ribose 90-100 cm	Ilgis 213 cm , plotis 98 cm
18.	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas - <i>skaitmeninės dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba).</i>	pateikiami
19.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

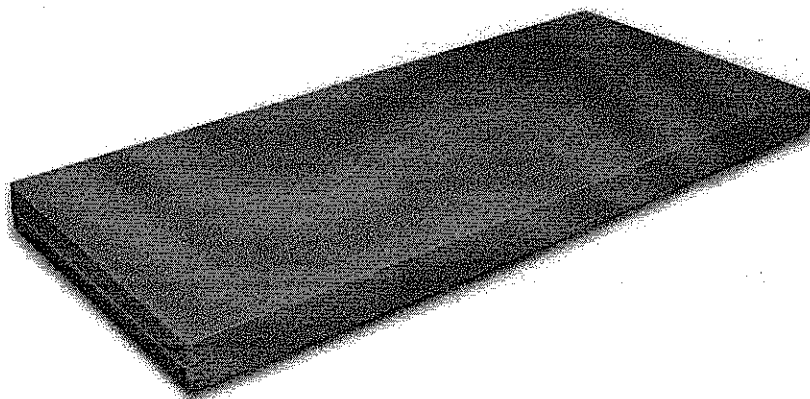

TECHNINIS APRAŠYMAS MEDICININIS ČIUŽINYS

Aukštos kokybės čiužinys pragulų profilaktikai. Čiužinys pagamintas iš padidinto elastingumo putų poliuretano HR su medicininiu, skysčiams nelaidžiu užvalkalu.

Čiužinio branduolys:

Čiužinys pagamintas iš putų poliuretano HR 32 kg/m³, 14 cm aukščio

Čiužinys pagamintas iš pralaidžių orui bei žmogui ir aplinkai nekenksmingų medžiagų.

Leidžiama čiužinio apkrova iki 130 kg

Čiužinio užvalkalas: pagamintas iš poliesterio (PES), laminuotas poliuretano(PU) plėvele nepraleidžia vandens, bet praleidžia orą. Audinio sudėtis :

Audinio viršus - 100 % PU

audinio apačia - 100 % PES

Audinio svoris : 185 g/m²

Audinio plotis : 205 cm

Oro pralaidumas : 110 g/m²/24 val.

Priežiūros rekomendacijos :

- ☐ skalbti 95 OC, sterilizuoti 121 OC
- ☐ nebalinti
- ☐ nelyginti
- ☐ nenaudoti tirpiklių
- ☐ džiovinti max 70 OC

Užvalkalas pagamintas iš poliuretano medžiagos su užtrauktuku, dviejose arba trijose kraštinėse, skalbiamas, nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, nedegus pagal LST EN 597-1:1996, LST EN 597-2:1996 normas. Higienišką užvalkalą, siūlės tankaus dygsnio, užtrauktukas paslėptas, kad ant čiužinio nepatektų skysčiai. Skirtingai nuo kitų neperšlampamų sintetinių paviršių nekelia triukšmo. Galimos užvalkalo spalvos: mėlyna.



