

**REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ,  
METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS IR BILIRUBINO TYRIMAMS ATLIKTI  
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LS- 45**

Alytus

2019 m. birželio mėn. 19d.

Ši sutartis sudaryta tarp VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamos direktoriaus Artūro Vasiliausko ir UAB „Vitrolab“ (toliau - **Tiekėjas**), atstovaujama direktoriaus Vaido Jankauskio.

**1. Sutarties objektas**

1.1. Remiantis 2019 m. balandžio 1 d. skelbto atviro konkurso „Reagentai ir papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimams atlikti su analizatorių panauda“ pirkimo Nr. 428488 (toliau – Konkursas) rezultatais, Tiekėjas įsipareigoja pagal konkurso sąlygas bei pateiktą pasiūlymą, Sutartyje nustatyta kaina, tvarka ir terminais parduoti, Pirkėjui Konkurso reikalavimus atitinkančias prekes, o Pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso preliminarus prekių kiekio.

1.3. Orientacinė sutarties suma 157939,71 Eur. (šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai 71 ct.), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotos ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui (Prekių pristatymo, E. sąskaitos pateikimo ir kt.). Galutinė kaina, kurią Pirkėjas sumokės Pardavėjui, priklausys nuo įsigytų prekių kiekio.

1.4. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir prekės yra tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.5. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento. Parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekybė, techninė specifikacija ir kokybė nurodytos sutarties Priede Nr.1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

**2. Sutarties šalių teisės ir pareigos**

2.1. Tiekėjas įsipareigoja: tiekti prekes, nurodytas šios sutarties priede Nr. 1 (*pridedamas tiekėjo užpildytas 1 konkurso sąlygų priedas*);

2.2. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis per dvi darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos;

2.3. Tiekėjas pateikia Pirkėjui nustatyta tvarka patvirtintas Prekių kokybę liudijančių dokumentų kopijas lietuvių kalba. Prekių galiojimo terminas, nurodytas Prekių aprašyme, privalo būti maksimalus.

2.4. Tiekėjas įsipareigoja teikti Prekes, kurios yra registruotos ir leidžiamos naudoti Lietuvos Respublikoje. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės laboratoriniams tyrimams atlikti turi būti registruoti LR Sveikatos apsaugos ministerijos valstybiniame registre (LR SAM naujų gaminių aprobavimo komisijos sprendimo kopija ir kokybės sertifikatų kopija), būtinas vertimas į lietuvių kalbą.

2.5. Prekių priėmimo metu pastebėjus Prekių įpakavimo, realizacijos terminų ar kitus pažeidimus, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant išsivežti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti kokybiškomis, atlyginant Pirkėjui dėl nekokybiškų Prekių pristatymo padarytą žalą.

2.6. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę jų realizacijos terminų ribose. Tiekėjas prekių realizacijos terminą nurodo kokybės pažymėjime ir ant pakuotės. Teikiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius reikalavimus.

2.7. Prekių, kurių galiojimo terminai trumpesni negu šeši mėnesiai, tiekimą papildomai derinti su Pirkėju;

2.8. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.9. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

2.10. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2.11. Pirkėjas įsipareigoja:

2.11.1. Užsakyti prekes dalimis pagal jų suvartojimą ir poreikius, pateikiant paraiškas telefonu ar faksu Tiekėjui prieš dvi kalendorines dienas, nurodant diagnostikos reagentų ir kontrastinių preparatų rūšį, kiekį ir pateikimo datą.

2.11.2. Pagal gautą Tiekėjo pranešimą apie pristatymo laiką garantuoti Prekių priėmimą ir dokumentų apiforminimą. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytiems reikalavimams, kokybės sertifikato kopijų nepateikimas, o taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu, sugadintos ar netekusios prekinės išvaizdos.

2.11.3. Sumokėti už prekes šioje sutartyje nustatytais terminais;

2.11.4. Prekių priėmimo metu pastebėjus Prekių įpakavimo, realizacijos terminų ar kitus pažeidimus, kuo greičiau iškviešti Tiekėjo atstovą, atsakingą už prekių kokybę ir surašyti aktą.

2.11.5. tinkami vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

2.11.6. Atsiradus nenumatytais aplinkybėms, kai Tiekėjas neturi ir negali pateikti Sutartyje numatytos reikiamos Prekės laiku, Pirkėjas gali tartis su Tiekėju, kad jis pakeistų perkamą Prekę į kito gamintojo, su sąlyga, kad tai bus tokio pat stiprumo, tos pačios veikliosios medžiagos Prekė, kuri atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta už ne didesnę kainą negu numatyta šioje sutartyje.

### **3. Prekių kaina (kainodaros taisyklės).**

3.1. Sutarties kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 3.2 punkte nurodytą atvejį.

3.2. Sutarties kainą Sutarties šalys turi teisę perskaičiuoti tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties kaina perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, kiek procentų pakito mokesčio dydis. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties šalių susitarimu, pasirašomu abiejų sutarties šalių. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo kitos dienos.

3.3. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą turi įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant:

3.4. transportavimo išlaidas;

3.5. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

3.6. aparatų, suteiktų panaudos būdu, integravimo ESIS sistemoje išlaidas;

3.7. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

### **4. Prekių kokybė. Įpakavimas**

4.1. Tiekėjas garantuoja prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Pateikiamų prekių kokybė privalo atitikti prekių gamintojo šalies standartus ir normas.

4.2. Prekės pateikiamos prekių gamintojo įpakavime, atitinkančiame prekių saugojimo ir transportavimo reikalavimus.

4.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos fasuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio ir kokybės, pretenzijos Tiekėjui pateikiamos ne vėliau kaip per 10 d. jas konstatavus. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri Tiekėjo ir Pirkėjo komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis. Tais atvejais, kai randami užslėpti prekių trūkumai, pretenzijos Tiekėjui pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 30 d.

4.4. Komisijai nustatius prekių trūkumą ar radus nekokybiškas prekes, Tiekėjas per 5 dienas įsipareigoja trūkstantį kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti kokybiškomis, o negalint to

padaryti - grąžinti už jas gautas lėšas

#### **5. Prekių priėmimas – perdavimas**

5.1. Tiekėjas perduoda prekes VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje esančiai klinikinei diagnostikos laboratorijai, adresu Ligoninės g 12, LT-62114 Alytus. Kartu su kiekviena siunta Tiekėjas pateikia Pirkėjui kokybės sertifikatus arba jų kopijas, prekių registravimo LR ir kokybės dokumentus arba jų kopijas.

5.2. Sutartyje nustatytais terminais Tiekėjui neperdavus prekių Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą dieną mokėti Pirkėjui delspinigius – po 0,02 % per dieną nuo užsakytos prekių kainos.

5.3. Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo), priėmęs prekes, privalo sąskaitoje-faktūroje (kituose atskaitomybės dokumentuose) nurodyti prekių gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti, patvirtinti antspaudu ir vieną egzempliorių grąžinti Tiekėjui.

#### **6. Atsiskaitymai ir mokėjimai**

6.1. Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6.2. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Tiekėjo.

#### **7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas**

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos, 5% bauda nuo neįvykdytos sutarties vertės.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

7.3. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs sutartį, jeigu tai nebus pasekmė nenumatytų aplinkybių, neginčo tvarka moka Pirkėjui 5% visos orientacinės sutarties sumos dydžio baudą, nurodytos sutarties 1.3. punkte.

7.4. Jeigu Tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pateikti Pirkėjui prekę arba pateikia prekę neatitinkančią sutarties sąlygų (pvz. padidina prekės kainą, prekę neatitinka nustatytų reikalavimų, ir pan.) ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti sutartį dėl prekės pirkimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 5% tos prekės sutarties sumos, kuri nurodyta reagentų ir papildomų priemonių laboratoriniams tyrimams atlikti techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) dydžio baudą.

7.5. Jeigu, įsigaliojus sutarčiai, paaiškėja, kad prekę neatitinka sutarties 4 dalyje keliamų kokybės reikalavimų arba paaiškėja, kad Tiekėjas apie prekės atitikimą Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir sutartį/sutarties dalį dėl prekės pirkimo nutraukti. Tiekėjas privalo atsiimti parduotą prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtą už prekę pinigų sumą ir sumokėti 20 % dydžio baudą nuo tos prekės sutartinės sumos nurodytos sutarties priede.

#### **8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas**

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo 2019 m. birželio mėn. 19 d. ir galioja 36 mėn., t. y. iki 2022 m. birželio mėn. 19 d.

8.2. Sutarties pratęsimas nenumatytas.

8.3. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.4. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 14 dienų.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai,

gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

#### **9. Ginčų sprendimo tvarka Baigiamosios nuostatos**

9.1. Šalys ginčus sprendžia derybų būdu, remiantis protingumo, sąžiningumo ir geros praktikos principais. Šalims nepasiekus susitarimo derybų keliu, ginčas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

#### **10. Baigiamosios nuostatos**

10.1. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyti principai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

10.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui, rekvizitams ar telefono numeriui, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per vieną darbo dieną.

10.3. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

10.4. Tiekėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu konkurso komisijai.

10.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

10.6. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

PRIEDAS Nr.1 (Reagentų ir papildomų priemonių laboratoriniams tyrimams atlikti techninė specifikacija).

**1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KLASIKINĖS TECHNOLOGIJOS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS IR BILIRUBINO TYRIMAMS**

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai                                                                                                                                                                                       | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarūs tyrimų skaičiai per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodyta m tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomo s pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                              | 4                                        | 5                                                                  | 6               | 7                                    | 8                        | 9                        |
|          | Reagentai ir papildomos priemonės klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimams su analizatoriaus panauda                                                                |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1        | Reagentai matuojamiems parametrams : pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , K, Na, Cl, Ca <sup>+</sup> , Glu, Lac, oksimetrijos parametrai (sO <sub>2</sub> , FO <sub>2</sub> Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb ctHb, FHbF), bilirubinas. |                                                | 36000                                    |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.1      | 944-128 Kalibravimo tirpalas 1 S1820                                                                                                                                                                                              |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.2      | 944-129 Kalibravimo tirpalas 2 S1830                                                                                                                                                                                              |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.3      | 944-132 Praplovimo tirpalas S4980                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.4      | 944-021 tHb kalibravimo tirpalas (S7770)                                                                                                                                                                                          |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.5      | 943-906 S5362 baltymų pašalintojas                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.6      | 944-126 Valymo                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |

|      |                                                 |  |  |    |
|------|-------------------------------------------------|--|--|----|
|      | tirpalas<br>(S8375)                             |  |  |    |
| 1.7  | 942-058<br>Referentinės<br>membranos<br>(D711)  |  |  | 9  |
| 1.8  | 942-063 pCO2<br>membranos<br>(D788)             |  |  | 3  |
| 1.9  | 942-064 pO2<br>membranos<br>(D799)              |  |  | 3  |
| 1.10 | 942-059 K<br>membranos<br>(D722)                |  |  | 3  |
| 1.11 | 942-062 Na<br>membranos<br>(D755)               |  |  | 3  |
| 1.12 | 942-061 Cl<br>membranos<br>(D744)               |  |  | 3  |
| 1.13 | 942-060 Ca<br>membranos<br>(D733)               |  |  | 3  |
| 1.14 | 942-065 Glu<br>membranos<br>(D7066)             |  |  | 9  |
| 1.15 | 942-066<br>Laktato<br>membranos<br>(D7077)      |  |  | 9  |
| 1.16 | 944-074<br>S7735<br>AutoCheck<br>TM 5+ 1 lygis  |  |  | 9  |
| 1.17 | 944-075<br>S7745<br>AutoCheck<br>TM 5+ 2 lygis  |  |  | 9  |
| 1.18 | 944-076<br>S7755<br>AutoCheck<br>TM 5+ 3 lygis  |  |  | 9  |
| 1.19 | 944-077<br>S7765<br>AutoCheck<br>TM 5+ 4 lygis  |  |  | 9  |
| 2.   | <b>Priedai<br/>analizatoriui</b>                |  |  |    |
| 2.1  | Termo<br>popierius<br>112/27m                   |  |  | 36 |
| 2.2  | 962-169<br>Kalibravimo<br>dujos GAS1,<br>10 bar |  |  | 16 |
| 2.3  | 962-170<br>Kalibravimo                          |  |  | 9  |

|        |                                                |  |  |    |
|--------|------------------------------------------------|--|--|----|
|        | dujos GAS2,<br>10 bar                          |  |  |    |
| 2.4    | 945-614 pH<br>elektrodas<br>E777               |  |  | 1  |
| 2.5    | 945-612 pCO2<br>elektrodas<br>E788             |  |  | 1  |
| 2.6    | 945-613 pO2<br>elektrodas<br>E799              |  |  | 1  |
| 2.7    | 945-603<br>E1001<br>referentinis<br>elektrodas |  |  | 1  |
| 2.8    | 945-615 Kalio,<br>E722                         |  |  | 1  |
| 2.9    | 945-618<br>Natrio, E755                        |  |  | 1  |
| 2.10   | 945-616<br>Kalcio, E733                        |  |  | 1  |
| 2.11   | 945-617<br>Chloro, E744                        |  |  | 1  |
| 2.12   | 945-619<br>Laktatų ,<br>E7077                  |  |  | 1  |
| 2.13   | 945-620<br>Gliukozės,<br>E7066                 |  |  | 1  |
| 2.14   | 906-020<br>Krešulių<br>gaudytuvas<br>ABL       |  |  | 20 |
| 2.15.1 | Atliekų<br>siurblio<br>žarnelė                 |  |  | 1  |
| 2.15.2 | Tirpalų<br>siurblio<br>žarnelė                 |  |  | 1  |
| 2.15.3 | Elektrodų<br>modulio<br>žarnelė                |  |  | 1  |
| 2.15.4 | Guminė<br>žarnelė<br>0.9x2.7                   |  |  | 1  |
| 2.15.5 | Silikoninė<br>žarnelė<br>0.85x2.6              |  |  | 1  |
| 2.15.6 | Mėginio<br>padavimo<br>tarpinė                 |  |  | 1  |
| 2.15.7 | Žarnelė<br>šildytuvui su<br>spaustukais        |  |  | 1  |
| 2.15.8 | Vožtuvo<br>žarnelė su<br>žiedeliu              |  |  | 1  |

|         |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |               |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 2.15.9  | Atliekų žarnelių konektorius                                                                   |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.10 | Žarnelės antgalis                                                                              |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.11 | Dvigubo vožtuvo korpusas                                                                       |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.12 | Skysčių daviklis                                                                               |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.13 | Atliekų žarnelių konektorius                                                                   |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.14 | Žarnelė pH/BG, El/Met moduliams                                                                |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.15 | Žarnelė įėjimo mod. pH/BG mod.                                                                 |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.16 | Žarnelė skalavimo šildytuvas į kamerą                                                          |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.17 | Įėjimo modulio žarnelė                                                                         |                                                                                                                                                                 |               | 1  |
| 2.15.18 | Analizatoriaus metinės priežiūros rinkinys                                                     |                                                                                                                                                                 |               | 3  |
| 3       | <b>Mėginio paėmimo priemonės</b>                                                               |                                                                                                                                                                 |               |    |
| 3.1     | <i>Heparinizuoti kapiliarai su kamštukais. (942-880 Clinitubes TM 5x50vnt. D957G-70-125x5)</i> | Kapiliarai su kamšteliais, pamaišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitų matavimams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija turi būti optimali. | <b>10 000</b> | 40 |
| 3.2     | <i>912-065 Magnetukas</i>                                                                      | Magnetas ar kita lygiavertė priemonė homogeniška m mėginio išmaišymui                                                                                           | <b>5</b>      | 5  |

|                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|------------------|------------------|
| 3.3.                                                                        | Arterinio kraujo paėmimo sistema, PICO70 (956-522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 22Gx25mm 100 vnt.) | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparinizuoti sausu, elektrolitų matavimams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija turi būti optimali. Komplekte su adata ir oro išstūmimo kamštelio. | 2000 | 20 |  |  |                  |                  |
| <b>1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  | <b>105933,40</b> | <b>111798,61</b> |

**2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CL ir POCT portatyviam pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMAMS**

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai                                                                          | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodyta m tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomo s pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                                              | 4                                        | 5                                                                  | 6               | 7                                    | 8                        | 9                        |
|          | <b>Reagentai ir papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų tyrimams su analizatoriaus panauda</b> |                                                |                                          |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1        | <b>Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Hct.</b>                                 | Ne daugiau kaip 200 tyr. kasetėje              | <b>3600</b>                              |                                                                    |                 |                                      |                          |                          |
| 1.1      | 945-676 SC80 100/30 pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Hct su QC3                                              |                                                |                                          | 36                                                                 |                 |                                      |                          |                          |
| 1.2      | 944-174 ABL80 Flex kalibracinis paketas                                                                              |                                                |                                          | 30                                                                 |                 |                                      |                          |                          |
| 1.3      | Kapiliarų adapteriai, 906-022                                                                                        |                                                |                                          | 8                                                                  |                 |                                      |                          |                          |
| 1.4      | Termo popierius 80*12*40 T                                                                                           |                                                |                                          | 36                                                                 |                 |                                      |                          |                          |
| 1.5      | Rinkinys analizatoriaus metinei priežiūrai                                                                           |                                                |                                          | 3                                                                  |                 |                                      |                          |                          |

|      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |             |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 2.   | <b>Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, K, Na, Cl, Ca, Glu, Hct, 3 lygių kokybės kontrolė.</b> | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje                                                                                                                                                                                            | <b>300</b>  |   |
| 2.1  | 945-665 SC80 50/30 visi parametrai su QC3                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |             | 6 |
| 2.2  | 944-174 ABL80 Flex kalibracinis paketas                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |             | 6 |
| 3    | <b>Mėginio paėmimo priemonės</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |   |
| 3.1  | 942-880 Clinitubes TM 5x50vnt. D957G-70-125x5                                                                                      | Kapiliarai su kamšteliais, pamašymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitų matavimams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija turi būti optimali.                                                              | <b>2000</b> | 8 |
| 3.2  | Magnetukas kapiliarų maišymui                                                                                                      | Magnetas ar kita lygiavertė priemonė homogeniška m mėginio išmaišymui                                                                                                                                                       | <b>2</b>    | 2 |
| 3.3. | 956-522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 22Gx25mm 100 vnt.                                                           | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparinizuoti sausu, elektrolitų matavimams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija turi būti optimali. Komplekte su adata, pamašymo priemone, saugiu adatos nuėmimo | <b>600</b>  | 6 |


|                                                                      |  |                                   |  |  |  |  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
|                                                                      |  | įtaisų ir oro išstūmimo membrana. |  |  |  |  |          |          |
| 2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: |  |                                   |  |  |  |  | 43790,00 | 46141,10 |

**Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:**

**Pirkėjo**

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė  
Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus  
Įmonės kodas 190272175  
a/s LT737300010091752982  
AB Swedbankas, b/k 73000

Direktorius  
Artūras Vasiliauskas

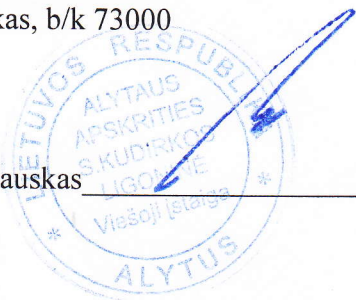

**Tiekėjo**

UAB „Vitrolab“  
Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas  
Įmonės kodas LT352790716  
a/s LT827044060002886700  
AB SEB bankas, b.k. 70440

Direktorius  
Vaidas Jankauskis

