

UAB "Expertus Vilnensis"

Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, Vilnius LT-08412, tel. (8 5) 2729374, faks. (8 5) 2729396, el.paštas: info@exvil.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 121386360, PVM kodas LT213863610

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Kudirkos g. 99
LT-76231 Šiauliai

PASIŪLYMAS DĖL MIKROSKOPO PIRKIMO 2015-05-27 Nr. 1-33611609 Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Expertus Vilnensis"
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A-201, LT-08412 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Mindaugas Dailidė Produktų specialistas
Telefono numeris	5-2729374
Fakso numeris	5-2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dėl dalyvavimo mažos vertės pirkime.

Mes siūlome šias prekes:

Pirk. Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1.	Mikroskopas (kompl.) Olympus BX53	1 vnt.	12.740,00	15.415,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 15.415,40 Eur (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai penkiolika Eur 40 ct).

PVM (pasiūlymo kainos) sudaro: 2.675,40 Eur.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus:

1. Mikroskopas

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs reikalavimai rodikliui	Siūloma parametro reikšmė
1	Optinė sistema	Begalinio tubuso optinė sistema.	Begalinio tubuso optinė sistema.

2	Filtrai šviesiniam mikroskopavimui	Integruoti į mikroskopo rėmą, interferencinis dienos šviesos, neutralūs 6% ir 25% pralaidumo, gradacinis filtras.	Integruoti į mikroskopo rėmą, interferencinis dienos šviesos, neutralūs 6% ir 25% pralaidumo, gradacinis filtras.
3	Fokusavimas	Grubaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 15 mm vienam sraigto apsisukimui. Tikslaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 0,1 mm vienam sraigto apsisukimui. Pilna fokusavimo eiga ne mažiau nei 25 mm.	Grubaus fokusavimo eiga 15 mm vienam sraigto apsisukimui. Tikslaus fokusavimo eiga 0,1 mm vienam sraigto apsisukimui. Pilna fokusavimo eiga 25 mm.
4	Fokusavimo reguliavimas	Privalomas grubaus fokusavimo sraigto įtempimo (pasipriešinimo) reguliavimas. Privalomas reguliuojamas fokusavimo stabdis (stalo aukščio ribotuvas) greitam fokuso nustatymui.	Yra grubaus fokusavimo sraigto įtempimo (pasipriešinimo) reguliavimas. Yra reguliuojamas fokusavimo stabdis (stalo aukščio ribotuvas) greitam fokuso nustatymui.
5	Apšvietimo valdymas	Apšvietimo intensyvumo valdymas. LED apšvietimo intensyvumo indikatorius.	Apšvietimo intensyvumo valdymas. LED apšvietimo intensyvumo indikatorius.
6	Apšvietimo režimas	Taupantis energiją apšvietimo režimas automatiškai išjungiantis apšvietimą, jeigu 30 minučių nedirbama su mikroskopu.	Taupantis energiją apšvietimo režimas automatiškai išjungiantis apšvietimą, jeigu 30 minučių nedirbama su mikroskopu.
7	Tubusas	Ergonominis binokulinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampo reguliavimo intervalas ne siauresnis nei nuo 5 iki 35 laipsnių.	Ergonominis binokulinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampo reguliavimo intervalas nuo 5 iki 35 laipsnių.
8	Okuliarai	Didinimas 10x, regos laukas ne mažiau nei 22 mm, dioptrijų korekcija, 2 vnt.	Didinimas 10x, regos laukas 22 mm, dioptrijų korekcija, 2 vnt.
9	Mikrometras	Okuliario mikrometrinė liniuotė, ilgis 10 mm, 100 padalų.	Okuliario mikrometrinė liniuotė, ilgis 10 mm, 100 padalų.
10	Revolveris	Revolveris ne mažiau nei 7-iems objektyvams, su slankikliu analizatoriui.	Revolveris 7-iems objektyvams, su slankikliu analizatoriui.
11	Objektyvas 2x	Plan Achromatinis objektyvas, didinimas 2x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,06.	Plan Achromatinis objektyvas, didinimas 2x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. 0,06.
12	Objektyvas 4x	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 4x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,13.	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 4x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. 0,13.

13	Objektyvas 10x	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 10x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,30.	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 10x, skirtas darbui su ir be 0,17 mm dengiamojo stikliuko, skiriamoji geba N.A. 0,30.
14	Objektyvas 20x	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 20x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. ne mažiau nei 0,50.	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 20x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. 0,50.
15	Objektyvas 40x	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 40x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. ne mažiau nei 0,75.	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 40x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. 0,75.
16	Objektyvas 60x	Plan Achromatinis objektyvas, didinimas 60x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. ne mažiau nei 0,80.	Plan Achromatinis objektyvas, didinimas 60x, skirtas darbui su 0,17mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. 0,80.
17	Objektyvas 100x	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 100x, skirtas darbui su 0,17 mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 1,30.	Plan Semi Apochromatinis (Fluoritas) objektyvas, didinimas 100x, skirtas darbui su 0,17 mm dengiamuoju stikliuku, skiriamoji geba N.A. 1,30.
18	Objektų žymeklis	Įsukamas į objektyvų revolverį, objektų ant objektinio stiklio pažymėjimui.	Įsukamas į objektyvų revolverį, objektų ant objektinio stiklio pažymėjimui.
19	XY stalas	Mechaninis X-Y slankiojantis stalas, valdomas dešine ranka, su keraminiu paviršiumi, su reguliuojamu sraigčių įtempimu (pasipriešinimu).	Mechaninis X-Y slankiojantis stalas, valdomas dešine ranka, su keraminiu paviršiumi, su reguliuojamu sraigčių įtempimu (pasipriešinimu).
20	Laikiklis	Laikiklis vienam objektiniam stikliui, greitas stiklio įdėjimas ir išėmimas viena ranka.	Laikiklis vienam objektiniam stikliui, greitas stiklio įdėjimas ir išėmimas viena ranka.
21	Kondensorius	Kondensorius užtikrinantis tolygų apšvietimą be papildomo lęšio darbui su 2x-100x objektyvais, skiriamoji geba N.A. ne mažiau nei 0,75.	Kondensorius užtikrinantis tolygų apšvietimą be papildomo lęšio darbui su 2x-100x objektyvais, skiriamoji geba N.A. 0,75.
22	Apšvietimo šaltinis	100W halogeno lempos šviesos šaltinis mikroskopavimui prašviečiama šviesa.	100W halogeno lempos šviesos šaltinis mikroskopavimui prašviečiama šviesa.
23	Išplėtimo galimybė	Turi būti numatyta galimybė sumontuoti fluorescencijos iliuminatorių su vieta ne mažiau nei 8 fluorescencijos kubams.	Yra numatyta galimybė sumontuoti fluorescencijos iliuminatorių su vieta 8 fluorescencijos kubams.

24	Halogeno lempa	Atsarginė 100W halogeno lempa, 2 vnt.	Atsarginė 100W halogeno lempa, 2 vnt.
25	Valymo servetėlės	Vienkartinės valymo servetėlės, skirtos optikos valymui.	Vienkartinės valymo servetėlės, skirtos optikos valymui.
26	Analizatorius	Analizatorius, montuojamas į objektyvų revolverio slankiklį.	Analizatorius, montuojamas į objektyvų revolverio slankiklį.
27	Poliarizatorius	Poliarizatorius darbui prašviečiamoje šviesoje.	Poliarizatorius darbui prašviečiamoje šviesoje.
28	Diskusinis tubusas	Diskusinis tubusas antram stebėtojiui. Integruota, regėjimo lauke šviečianti rodyklė, reguliuojamas rodyklės spalva (raudona/žalia) ir šviesos intensyvumas, valdoma rodyklės padėtis regėjimo lauke. Okuliarų pasvirimo kampo reguliavimo intervalas ne siauresnis nei nuo 5 iki 35 laipsnių. Okuliarai, didinimas 10x, regos laukas ne mažiau nei 22 mm, dioptrijų korekcija, 2 vnt.	Diskusinis tubusas antram stebėtojiui. Integruota, regėjimo lauke šviečianti rodyklė, reguliuojamas rodyklės spalva (raudona/žalia) ir šviesos intensyvumas, valdoma rodyklės padėtis regėjimo lauke. Okuliarų pasvirimo kampo reguliavimo intervalas nuo 5 iki 35 laipsnių. Okuliarai, didinimas 10x, regos laukas 22 mm, dioptrijų korekcija, 2 vnt.
29	Gaubtas	Gaubtas mikroskopo uždengimui nuo dulkių.	Gaubtas mikroskopo uždengimui nuo dulkių.
30	Procesorius	Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis nei 6.500 pagal „3DMark06 CPU score“ testą. Atmintinė ne mažiau negu 8 GB. Kaupiklis ne mažiau negu 120 GB SSD. Kaupiklis ne 2x2 TB RAID1, ne mažiau nei 7200 rpm. Vaizdo plokštė ne mažiau nei 1 GB, su ne mažiau nei 2 DVI jungtimis. Kortelių skaitytuvas. Optinis DVD-RW įrenginys. Garso kolonėlės. Klaviatūra, pelė. Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis ne mažiau nei 1.000 VA. Daugiafunkcinis įrenginys su lazerinio spausdinimo, skenavimo ir kopijavimo funkcijomis.	Procesoriaus Intel Core i5-4570 našumas 6.810 pagal „3DMark06 CPU score“ testą. Atmintinė 8 GB. Kaupiklis 120 GB SSD. Kaupiklis 2x2 TB RAID1, 7200 rpm. Vaizdo plokštė 1 GB, su 2 DVI jungtimis. Kortelių skaitytuvas. Optinis DVD-RW įrenginys. Garso kolonėlės. Klaviatūra, pelė. Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis 1.100 VA. Daugiafunkcinis įrenginys su lazerinio spausdinimo, skenavimo ir kopijavimo funkcijomis.
31	Monitorius	Monitorius, įstrižainė ne mažiau 21" LCD su LED pašvietimu, ne mažiau nei 1920x1080 pikselių, minimalus skaistis 250cd/m2, minimalus kontrastas 1.000:1, skaitmeninė DVI	Monitorius, įstrižainė 21,5" LCD su LED pašvietimu, 1920x1080 pikselių, 250cd/m2, kontrastas 1.000:1, skaitmeninė DVI jungtis. 2 vnt.

		jungtis. 2 vnt.	
32	CE atitiktis	Privaloma atitiktis Europos direktyvai 98/79/EC In Vitro Diagnostikos gaminiams medicinai, pateikti gamintojo atitikties deklaracijos kopiją.	Atitinka Europos direktyvą 98/79/EC In Vitro Diagnostikos gaminiams medicinai, pateikiame gamintojo atitikties deklaracijos kopiją.
33	Garantija	Garantija ne mažiau 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos.	Garantija 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos.

Priedama:

1. Įgaliojimas Mindaugui Dailidei, 1 psl.
2. Siūlomo prietaiso atitikties deklaracija, 1 psl.

Mindaugas Dailidė
Produktų specialistas



A.V.




ĮGALIOJIMAS

2015-03-30, Vilnius

Šiuo įgaliojimu Mindaugas Dailidė, asmens kodas 37902230500, įgaliojamas parengti, pasirašyti ir pateikti UAB „Expertus Vilnensis“ pasiūlymus pirkimams vykstantiems pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, atstovauti UAB „Expertus Vilnensis“ vokų atplėšimo posėdžiuose bei derybose, tvirtinti UAB „Expertus Vilnensis“ dokumentų kopijas bei dokumentų vertimus.


Direktorius



(parašas)

Arvidas Neniškis

Įgaliotas asmuo

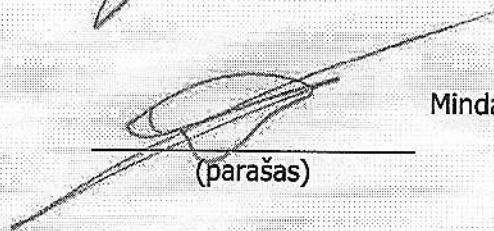

(parašas)

Mindaugas Dailidė

OLYMPUS

DECLARATION OF CONFORMITY

No. : DC1025

1.Manufacturer

OLYMPUS CORPORATION

2.Address

Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi Shinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

3.Model

BX53 System

4.Name of product

Upright System Microscope

5.Serial Number of product

since 0B17199

6.Authorized representatives in EU;

Name

Olympus Europa Holding GmbH

Address

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.

We herewith declare that the above mentioned products comply with the requirements of
in vitro diagnostic medical devices Directive 98/79/EC.

This declaration is based on the following standards;

EN61326-2-6:2006, IEC61326-2-6:2005 (EMC)

EN61010-2-101 : 2002 (Safety for IVD)

EN ISO14971 : 2007 (Risk Management)

IEC62366:2007 (Usability engineering for Medical Devices)

EN ISO13485 : 2003 (Quality Management System)

This declaration is based on test report no.;

42B0045, ID10006 (EMC)

E157168-A2-CB-1 (Safety for IVD)

IR10004 (Risk Management)

IA10002 (Checklist for the Annex of IVD)

IU10002 (Checklist for usability engineering)

This declaration is based on certificate;

US/14892/UL (CB Certificate) issued by UL

MD540624 (Quality Management System) issued by BSI.

Place:

Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

Signature:



Name

Itaru Endo

Title

General Manager,
Quality Assurance Department of Life and Industrial Systems Group

Date:

May 11, 2010