



UAB „KODMEDA“
(Uždaroji akcinė bendrovė, Kareivių g. 11, 09109 Vilnius, Tel.: 8 5 270 08 77, Faks.: 8 5 277 25 29, įm. k. 123854815, VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas, PVM m. k. LT238548113)

Viešojo istaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS**

2019-09-05 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KODMEDA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kareivių g. 11, Vilnius, LT-09109
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Jonas Voluckis
Telefono numeris	(8 5) 270 08 77
Fakso numeris	(8 5) 277 25 29
El. pašto adresas	info@kodmeda.lt
Atsakingas asmuo už sutarties vykdymą (vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr., el. paštas)	Direktorius Jonas Voluckis, (8 5) 270 08 77, info@kodmeda.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us) ar specialistą:

Subtiekęjo (ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (ų) adresas (-ai)	
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekęjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu.	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekęjui	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

2 pirkimo dalis – Mobilus rentgeno aparatas – 1 vnt.

Prekių pavadinimas	Mato vnt.	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM	Kiekis	Bendra kaina, Eur su PVM
Mobilus rentgeno aparatas	vnt.	59.999,06	1	59.999,06
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (suma žodžiais): 49.586,00 € (Keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši Eurai ir 0 centų)				
PVM, Eur. (suma žodžiais): 10.413,06 € (Dešimt tūkstančių keturi šimtai trylika Eurų ir šeši centai)				
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (suma žodžiais): 59.999,06 € (Penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eurai ir šeši centai)				

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojama bendra prekių kaina.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų aprašo 30 punkte):*

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Dokumentai. Konfidencialu

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3
2.	Techninė specifikacija	3
3.	EBVPD	15
4.	Gamintojo įgaliojimas	2
5.	CE sertifikatas	4
6.	Darbuotojo sertifikatas	2
7.	Mobilaus rentgeno aparato techninė dokumentacija	14
8.	Ištrauka iš mobilaus rentgeno aparato vartotojo instrukcijos	8
9.	Skaitmeninio detektoriaus brošiūra	4
10.	Garantinis raštas	1

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Jonas Voluckis

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.


Techninė specifikacija

2 pirkimo dalis – Mobilus rentgeno aparatas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)
1. Mobilus rentgeno aparatas (1 vnt.)			
1.1	Gamintojas, modelis	Nurodyti	Intermedical S.r.l., Compact DR Plus 30, 37, 44, 48 psl.
1.2	Tipas	Mobilus, su ratukais	Mobilus, su ratukais 30, 33, 37, 40 psl.
Generatorius			
1.3	Generatoriaus galia	≥ 30 kW	32 kW 30, 37 psl.
1.4	Aukšto dažnio generatorius	Būtina	Aukšto dažnio generatorius 30, 37 psl.
1.5	Aukštos įtampos diapazonas	$\geq 40-125$ kV	40-125 kV 30, 37 psl.
1.6	mA diapazonas	$\geq 50-400$ mA	50-400 mA 30, 37 psl.
1.7	mAs diapazonas	$\geq 0,1-200$ mAs	0,1-220 mAs 30, 37 psl.
Rentgeno vamzdis			
1.8	Anodas	Besisukantis, ≥ 3000 aps/min	3000 aps/min 30, 37 psl.
1.9	Židinio dėmės dydis (du židiniai)	$\leq 0,8$ mm ir $\leq 1,3$ mm	0,8 mm ir 1,3 mm 30, 37 psl.
1.10	Nominali anodo galia	≥ 15 kW mažam židiniui ir ≥ 30 kW dideliame židiniui	16 kW mažam židiniui ir 32 kW dideliame židiniui 30, 37 psl.
1.11	Maksimalus anodo aušinimas	≥ 300 W	300 W 30, 37 psl.
Rentgeno galva			
1.12	Šiluminė talpa	≥ 600 kJ (800 kHU)	600 kJ (800 kHU) 30, 37 psl.
1.13	Galvos sukimas skersine ašimi	$\geq \pm 180^\circ$	$\pm 180^\circ$ 33, 40 psl.
1.14	Galvos sukimas išilgine ašimi	$\geq -45^\circ/+100^\circ$	$-49^\circ/+102^\circ$ 33, 40 psl.
Kolimatorius			
1.15	Tipas	Rankinis	Rankinis 31, 38 psl.
1.16	Rotacija	$\geq \pm 100^\circ$	$\pm 120^\circ$ 31, 38 psl.

1.17	Kolimatoriaus švietimo įjungimas kolimatoriuje ir generatoriaus valdymo pulte	Būtinai	Kolimatoriaus švietimo įjungimas kolimatoriuje ir generatoriaus valdymo pulte 50-51 psl.
Integruota skaitmeninė sistema			
1.18	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtinai	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas 31,38 psl.
1.19	Lietimui jautrus spalvotas medicininis ekranas	≥ 19" ≥ 1280 x 1024 pikselių	19" 1280 x 1024 pikselių 32,39 psl.
1.20	Bevielis detektorius 35x43 cm	1 vnt.	1 vnt. 56 psl.
1.21	Detektoriaus technologija	≥ GADOX	≥ GADOX (DRZ+) 32,39 psl.
1.22	Detektoriaus pikselio dydis	≤ 140 μm	139 μm 52 psl.
1.23	Detektoriaus svoris su baterija	≤ 3,5 kg	2,9 ± 0,25 kg 52 psl.
1.24	Detektoriaus baterijų kiekis	≥ 3 vnt.	3 vnt. 56 psl.
1.25	Trijų baterijų kroviklis	≥ 1 vnt.	1 vnt. 55,56 psl.
1.26	Programinės įrangos funkcijos po vaizdo gavimo	a) Vaizdo gavimas ir apdorojimas b) Vaizdo apkarpymas c) Šviesumo/kontrasto keitimas d) Zoom ir „didinimo stiklas“ e) V/H inversija f) Balta/Juoda inversija g) Anotacijos	a) Vaizdo gavimas ir apdorojimas b) Vaizdo apkarpymas c) Šviesumo/kontrasto keitimas d) Zoom ir „didinimo stiklas“ e) V/H inversija f) Balta/Juoda inversija g) Anotacijos 31,38 psl.
1.27	Išsaugomų vaizdų skaičius vidinėje atmintyje	≥ 10 000	15 000 31,38 psl.
1.28	DICOM funkcijos: Verify Storage Storage commitment Print Worklist MPPS Query/retrieve	Būtina	DICOM funkcijos: Verify Storage Storage commitment Print Worklist MPPS Query/retrieve 31,38 psl.
Mechaninės charakteristikos			
1.29	Svoris	≤ 180 kg	170 kg 33,40 psl.

1.30	Maksimalus plotis	≤ 620 mm	618 mm 33,40 psl.
1.31	Ilgis transportavimo metu	≤ 1400 mm	1368 mm 33,40 psl.
1.32	Maksimalus aukštis transportavimo metu	≤ 1500 mm	1500 mm 33,40 psl.
1.33	Atstumas tarp rentgeno vamzdžio židinio ir grindų	Min. ≤ 420 mm Maks. ≥ 2000 mm	Min. 417 mm Maks. 2055 mm 33,40 psl.
1.34	Maksimalus horizontalios rankos ilgis	≥ 1000 mm	1094 mm 34,41 psl.
1.35	Kolonos pasukimas kampu aplink vertikalią ašį	$\geq 180^\circ$	$\geq 180^\circ$ 33,40 psl.
1.36	Kasečių dėklas	Būtina	Kasečių dėklas 35,42 psl.
1.37	Judėjimas	Rankinis	Rankinis 30,37 psl.
1.38	Stabdžiai	Kojiniai	Kojiniai 35, 42, 49 psl
Maitinimas			
1.39	Įtampa	Vienfazė 230 V $\pm 10\%$	Vienfazė 230 V $\pm 10\%$ 33,40 psl.
1.40	Maitinimo lizdas	Standartinis (SCHUKO) 16A	Standartinis (SCHUKO) 16A 33,40 psl.
Dozimetas			
1.41	Dozimetas paciento gautai dozei vertinti	Būtinai	Dozimetas paciento gautai dozei vertinti 31,39 psl.
1.42	CE ženklavimas	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją).	CE ženklavimas 24-27, 35,42 psl.
1.43	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1) Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; 2) Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1) Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; 2) Serviso dokumentacija anglų kalba. 56 psl.
1.44	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesių	24 mėnesių 56 psl.

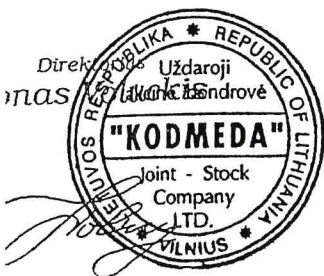

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA
GALUTINIS PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Perkančioji organizacija (Pirkėjas):
Tiekėjas teikėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),</i>
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visos Prekės, nurodytos Tiekiamų prekių sąraše, buvo pristatytos (įrašyti data (datas)).

Visi Sutarties 1.1 papunktyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti (įrašyti data).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas pristatytas Prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

(Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)) (nurodyti, jei tai numatyta Sutartyje).

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad Prekės priimtos (įrašyti data), ir ši data yra laikoma Prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė <i>Tiekėjas</i>	Priėmė <i>Pirkėjas</i>
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)