

Klaipėda,

2020 m. 09

mėn. 07 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas atstovaujama direktoriaus laboratorinei diagnostikai Kęstučio Pauliaus (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Diagnostiniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos etanolio koncentracijos tyrimų atlikimui su įrangos panauda“ (488097) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal užsakovo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos el.paštu renata.bobinaite@siemens-healthineers.com, prekės pristatomos per 10 darbo dienų po užsakovo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu ne mažesnis 6 mėnesiai.

2.2. Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų techninėje specifikacijoje nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

3.4. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Užsakovas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 12 mėnesiams.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.
- 6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.
- 6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 7.1. Pateikti Sutartyje numatytas prekes, nurodytas sutarties priede, sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.
- 7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą.
- 7.3. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
- 7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
- 7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekiejus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].
- 7.7. Subtiekiejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekiejų ar didesnės (mažesnės) prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui galimas tik tų prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekiejus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekiejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekiejų keitimas ir (ar) papildomų subtiekiejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekiejų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
 - 7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekiejas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
 - 7.8.2. subtiekiejas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį;
 - 7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių tiekimo spartą.
- 7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekiejas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.
- 7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekiejas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekiejams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

- 8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 8.2. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.



8.3. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutartyje nurodytas prekes numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekės vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl pateiktų nekokybiškų prekių.

9. Ginčai:

9.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.



13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

„Užsakovas“

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
pavadootoja infrastruktūrai
Jolita Motužienė

„Tiekėjas“

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C,
LT-03163 Vilnius
A/S FI6081439710009285
Danske Bank A/S Finland Branch
Banko kodas DABAFIHH
Įmonės kodas 304060364

Kęstutis Paulius
Direktorius
Laboratorinė Diagnostika

Dalius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

II. PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Atitikimas reikalavimui
1.	Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklininti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC)	Visi reagentai ir priemonės sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklininti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC), pateikiami sertifikatai.
2.	Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos eksploatacinės medžiagos - turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).	Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos eksploatacinės medžiagos - vieno gamintojo.
3.	Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.	Pasiūlyme pateikiamos visos tyrimui atlikti būtinos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4.	Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą nuo atidarymo.	Siūlome tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą nuo atidarymo.
5.	Reagentų kasečių, kokybės kontrolės kasečių galiojimo laikas, įdėjus į analizatorių - turi būti ne mažiau 4 savaitių.	Reagentų , kokybės kontrolės galiojimo laikas, įdėjus į analizatorių - ne mažiau 4 savaitių. 2 psl. Prekių aprašymai.pdf
6.	Tiekėjai privalo pateikti visų eksploatacinių medžiagų (reagentai, plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.	Pateikiame visų eksploatacinių medžiagų (reagentai, plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
7.	Reagentų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibratorių/standartų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).	Reagentų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibratorių/standartų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8.	Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo	Pateikiame lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų

[Signature]

	metodikas bei saugos duomenų lapus. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.	naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus.
9.	Tiekėjai privalo garantuoti lankščią nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistemą (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybę gauti skubų užsakymą).	Lankstus reagentų pristatymas.
10.	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognazuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.	
11.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrąžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrąžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijas.	
12.	Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.	

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.	Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės)	Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM	PVM tarifas %	Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM	Suma, EUR su PVM 24 mėn.	Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Etanolio koncentracijos nustatymo tyrimas	Reikalavimai tyrimui/testui: tyrimo tikslumas (variacijos koeficientas - CV) ne daugiau 2 %; jautrumas - mažiau 0,03 g/l (0,03%), galintis išskirti žemiausias etilo alkoholio koncentracijas nuo 0,00 g/l (0,00%), su pasikliovimo intervalu 95%.	iki 5 500 tyrimų							
1.1	Etanolio reagentas			140 tyr.	45	3,4425	5%	535,50	24 097,50	Ethanol EMIT II Plus - RGT - 28 ml / 12 ml, 10445446
1.2	Kiuvečių rotorius				2	0,0390	5%	136,50	273,00	Cuvette - Reaction Rotor, 3 pcs
1.3	Kiuvečių ploviklis A				3	0,0360	5%	84,00	252,00	Cuvette Clean Solution A 0.1n HCL, 1000 ml
1.4	Kiuvečių ploviklis B				3	0,0225	5%	52,50	157,50	Cuvette Clean Solution B 0.1n NaOH, 1000 ml
1.5	Dichromatinis tirpalas, analizatoriaus patikrinimui				1	0,0090	5%	63,00	63,00	Dichromat Solution 8, 25 ml
1.6	Etanolio kalibratorius 100 mg/dl				20	0,2100	5%	73,50	1 470,00	Ethanol EMIT Calibrator 100, 3 ml
1.7	Etanolio kalibratorius neigiamos koncentracijos				20	0,2100	5%	73,50	1 470,00	Ethanol EMIT Calibrator Neg, 3 ml
1.8	Etanolio kontrolė, aukšta				20	0,2100	5%	73,50	1 470,00	Ethanol EMIT Control High, 3 ml
1.9	Etanolio kontrolė, žema				20	0,2100	5%	73,50	1 470,00	Ethanol EMIT Control Low, 3 ml

Handwritten signature

2020 m. rugpjūtį 7 d., Klaipėda

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (toliau - Panaudos davėjas),
adresas: J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius, tel. 8 5 2391555, įmonės kodas 304060364,
atstovaujama direktoriaus laboratorinei diagnostikai Kęstučio Pauliaus - viena šalis,

ir

VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, (toliau - Panaudos gavėjas),
adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel. (8 46) 39 65 02, Faks. (8 46) 39 66 25,
Įm. kodas 190468035, PVM mokėtojo kodas LT9046803514,
atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio - kita šalis,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau - Sutartis)/ Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai toliau Sutartyje gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu - „Šalimis“.

1. Sutarties objektas

1.1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise jam priklausančią įrangą (toliau - Įranga), o Panaudos gavėjas įsipareigoja priimti ir naudoti Įrangą pagal paskirtį (įrašyti paskirtį ir skyriaus pavadinimą) ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Įrangos vertė 18 150,00 Eur.

2. Panaudos davėjo įsipareigojimai:

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja perduoti įvesti į eksploataciją Įrangą Panaudos gavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įrangą perduoda kartu su jos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

2.2. Panaudos davėjas įsipareigoja supažindinti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama Įranga personalą) su Įrangos naudojimo specifika, apmokyti dirbti personalą per 3 darbo dienas nuo Įrangos instaliavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti konsultacijas visais su Įrangos naudojimu susijusiais klausimais.

2.3. Pasibaigus Sutarties terminui atsiimti Įrangą iš Panaudos gavėjo per 14 darbo dienų.

2.4. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką Įrangą iki bus sutaisyta.

3. Panaudos gavėjo įsipareigojimai

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja perduotą Įrangą naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį (nurodyta 1.1. punkte), remiantis naudojimo instrukcijomis bei visais Panaudos davėjo nurodymais ir apmokymais.

3.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Įrangą.

3.3. Pasibaigus Sutarties terminui grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Panaudos gavėjas priima ir grąžina Įrangą Panaudos davėjui pagal abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. Panaudos gavėjas įsipareigoja neperduoti Įrangos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.

3.5. Informuoti panaudos davėją apie Įrangos gedimą.

4. Sutarties galiojimas

- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 12 mėnesiams, kol galioja reagentų tiekimo sutartis.
- 4.2. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių bendru sutarimu. Visi sutarties pakeitimai ir priedai galios, jeigu jie bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.
- 4.3. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai be priežasties nutraukti šią Sutartį raštu pranešus kitai Šaliai prieš 60 kalendorinių dienų. Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama sutartį, privalo pilnai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus kitai Šaliai.

5. Nenugalima jėga (Force majeure)

- 5.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

6. Ginčų sprendimo tvarka

- 6.1. Visi iš šios sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, jis perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui pagal Panaudos gavėjo buveinės adresą.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Visus klausimus, susijusius su informacijos apie Panaudos gavėją pateikimu, Panaudos davėjas privalo iš anksto suderinti su Panaudos gavėjo atstovu.
- 7.2. Jeigu keičiasi Šalių buveinės ar Sutartyje nurodytų Šalių banko sąskaitų rekvizitai, tai ši Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo duomens pasikeitimo informuoti apie tai kitą Šalį.

8. Baigiamosios nuostatos

- 8.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

9. Priedai:

- 9.1. Įrangos techninė specifikacija

PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Vyriausiojo gydytojo
pavadojoja infrastruktūrai
Nijolė Motužienė
Vyriausiasis gydytojas

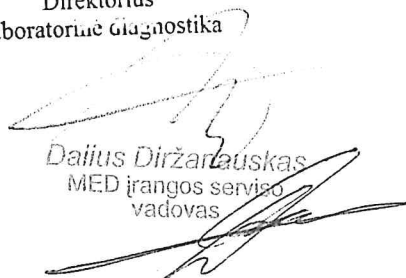


PANAUDOS DAVĖJAS

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas

Direktorius laboratorinei diagnostikai

Kęstutis Paulius
Direktorius
Laboratorinė Diagnostika


Dalius Diržauskas
MED įrangos serviso
vadovas

**PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ETANOLIO KONCENTRACIJOS
TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS PANAUDA**

I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ETANOLIO KONCENTRACIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas (CE ženklintas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC).	Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiame atitikties deklaracijų kopijas (CE ženklintas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC).
2.	Tiekėjai privalo tinkamai pagrįsti atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams parametrams.	
3.	Įrangos pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2017 metai. Įranga turi būti nauja arba techniškai tvarkinga.	2017 metu gamybos.
4.	Tiekėjai turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.	Pateikiame tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, esant pakeitimams - informuojame, bei skubiai atnaujiname: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.
5.	Tiekėjai turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.	Įsipareigojame kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
6.	Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi praveisti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriumi, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas (kur reikia), bei kita), bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.	Įsipareigojame praveisti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriumi, pateikiamas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas (kur reikia), bei kita), ir garantuojame personalo konsultavimą techniniais, metodiniais bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo klausimais visą sutarties laikotarpį.
7.	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Techninė priežiūra (jei yra gamintojo numatyta) turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita).	Siemens Healthcare OY Lietuvos filialas savo sąskaita užtikrina įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Techninė priežiūra vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Pateikiame detalų, gamintojo reglamentuotą atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita).
8.	Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties	Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas pradamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu

	nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.	būdu po pranešimo gavimo apie iškilusias nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga sutaisoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9.	Pageidautina, kad būtų galimybė nuotoliniu būdu nustatyti ir/ar išspręsti iškilusias technines problemas.	Nėra galimybės nuotoliniu būdu spręsti technines problemas.
10.	Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.	Siemens Healthcare OY Lietuvos filialas garantuoja kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
11.	Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.	Pateikiamas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
12.	Analizatorius turi turėti galimybę jungtis į ligoninės turimą laboratorinę informacinę sistemą, palaikant ASTM arba HL7 v2 standartus.	Analizatorius turi turėti galimybę jungtis į ligoninės turimą laboratorinę informacinę sistemą, palaikant ASTM standartą.

**TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**
Modelis Viva Pro E

Gamintojas Siemens

Kilmės šalis Olandija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	Automatinis specializuotas etanolio koncentracijos ir psichotropinių medžiagų nustatymo analizatorius - 1 vnt. (Viva pro E, Siemens)		
1	Analizatoriaus paskirtis	Specializuotas imunofermentinis analizatorius, skirtas etanolio koncentracijos ir psichotropinių medžiagų aptikimui automatizuotu būdu.	Specializuotas imunofermentinis analizatorius, skirtas etanolio koncentracijos ir psichotropinių medžiagų aptikimui automatizuotu būdu. 14 psl. Viva-ProE naudotojo vadovas.pdf
2	Matavimo metodas	Imunofermentinis arba lygiavertis.	Fotometrinis
3	Metodo matavimo linijiskumas	Būtina. nuo 0.00 iki 6.00 g/l ir/arba promilių	0.1 iki 6.00 g/l ir/arba promilių. 2 psl. Prekiu aprasymai.pdf
4	Analizatoriaus našumas	Ne < 60 tyrimų per val.	133 tyr. val. 2 psl. Viva-ProE techninė specifikacija.pdf
5	Tyrimui reikalingas mėginio tūris	Būtina : ne > 250 mikrolitrų kraujo/šlapimo	30 mikrolitrų. 2 psl. Viva-ProE techninė specifikacija.pdf
6	Tyrimo rezultatų pateikimo forma	Būtina. Galimybė pasirinkti rezultatų pateikimą pasirinktinai keliais būdais: g/l ir/arba promilėmis.	Rezultatas g/l arba promilėmis
6	Analizatoriaus išorinio rotoriaus talpa	Būtina. Ne mažiau 40 vietų rotorius mėginiams.	50 vietų. 2 psl. Viva-ProE techninė specifikacija.pdf
7	Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai	Būtina. Galimybė tirti etanolio koncentraciją kelių rūšių mėginiuose: kraujo serume/plazmoje/šlapime	Kraujo serume/plazmoje/šlapime. 1 psl. Prekiu aprasymai.pdf
8	Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų stabilumas	Būtina. Reagentų stabilumas: jei laikoma pagal gamintojo nurodymus- neatidarius- iki galiojimo datos pabaigos, kuri pažymėta ant pakuotės; jei atidaromos pakuotės- ne mažiau 4	Būtina. Reagentų stabilumas: jei laikoma pagal gamintojo nurodymus- neatidarius- iki galiojimo datos pabaigos, kuri pažymėta ant pakuotės; jei atidaromos pakuotės- 4 savaitės. 2 psl. psl. Prekiu aprasymai.pdf

		savaičių.	
9	Kalibravimo sistema	Būtina. Ne mažiau dviejų skirtingų koncentracijų kalibratoriai (vienas iš jų - nulinės koncentracijos - 0,00 g/l, o kitas - 1.00 g/l.	Dviejų skirtingų koncentracijų kalibratoriai (vienas iš jų - nulinės koncentracijos - 0,00 g/l, o kitas - 1.00 g/l. 2 psl. Prekiu aprasymai.pdf
10	Kontrolinės medžiagos	Būtina. Turi būti paruoštos naudojimui, ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos su žinomomis reikšmėmis; pageidautinas kontrolių rezultatų variacijos koeficientas (CV) ne daugiau 5%.	Kontrolės paruoštos naudojimui, dviejų lygių kontrolinės medžiagos su žinomomis reikšmėmis; kontrolių rezultatų variacijos koeficientas (CV) ne daugiau 5%. 3 psl. Prekiu aprasymai.pdf
11.	Kalibracijų ir kontrolių valdymas, saugojimas analizatoriuje	Būtina, Kalibracijų grafinis atvaizdavimas kreivės pavidalu ir automatinis pavykusios kalibracijos įvertinimas. Gautų kontrolinių (tiek žemos koncentracijos, tiek aukštos) reikšmių automatinis įvertinimas su įspėjamaisiais ženklais (jei gauti kontrolės rezultatai nepatenka į +/- 2 SD ribas), kontrolinių grafikų automatinis braižymas (Levy-Jenings grafikai), pritaikant vidurkio, SD reikšmes bei Westgard taisykles. Turi būti galimybė kaupti ir archyvuoti kokybės kontrolės rezultatų ir grafikų duomenis.	Kalibracijų grafinis atvaizdavimas kreivės pavidalu ir automatinis pavykusios kalibracijos įvertinimas. Gautų kontrolinių (tiek žemos koncentracijos, tiek aukštos) reikšmių automatinis įvertinimas su įspėjamaisiais ženklais (jei gauti kontrolės rezultatai nepatenka į +/- 2 SD ribas), kontrolinių grafikų automatinis braižymas (Levy-Jenings grafikai), pritaikant vidurkio, SD reikšmes bei Westgard taisykles. Galimybė kaupti ir archyvuoti kokybės kontrolės rezultatų ir grafikų duomenis. 2 psl. Viva-ProE techninė specifikacija.pdf
12.	Interferencija	Būtina. Neturi būti reikšmingos interferencijos hemolizei, lipemijai ar ikerijai	Nereikšminga interferencija hemolizei, lipemijai ar ikerijai. 3 psl. Prekiu aprasymai.pdf.

PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
A.V.

PANAUDOS DAVĖJAS

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
A.V.



Kęstutis Paulius
Direktorius
Laboratorinė diagnostika

Darius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas